


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start output S1						
O	1	50.1	62.1	48.9	38	50.1	62.1	48.9	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Specification according to ISO/IEC 15775 Annex G and DIN 33866-1 Annex G
	2	50.5	54.3	43.6	39	50.3	55.7	43.6	38	-0.1	1.4	0.0	1.4	1.4	
	3	50.9	46.5	38.4	40	50.8	51.2	38.6	37	-0.1	4.7	0.2	4.7	4.7	
	4	51.3	38.7	33.1	41	51.7	44.9	33.0	36	0.4	6.2	0.0	6.2	6.2	
	5	51.7	30.9	27.8	42	52.4	36.5	28.5	38	0.6	5.7	0.7	5.7	5.7	
	6	52.1	23.0	22.5	44	52.3	27.4	22.6	40	0.2	4.4	0.1	4.4	4.4	
	7	52.5	15.2	17.3	49	52.8	17.2	18.1	46	0.3	2.0	0.9	2.2	2.2	
	8	52.9	7.4	12.0	58	53.5	7.5	12.1	58	0.6	0.1	0.1	0.2	0.6	
Z	9	53.3	-0.3	6.7	93	53.3	-0.3	6.7	93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Regularity $g^* = 43.8$
	10	53.4	-3.8	0.4	174	53.2	-7.6	0.3	178	-0.1	-3.7	0.0	3.8	3.8	
	11	53.4	-7.3	-5.8	218	53.0	-13.4	-4.2	198	-0.3	-6.0	1.6	6.3	6.3	
	12	53.5	-10.8	-12.0	228	53.1	-18.2	-10.2	209	-0.3	-7.3	1.8	7.6	7.6	
	13	53.6	-14.3	-18.3	232	52.0	-22.7	-16.4	216	-1.5	-8.3	1.9	8.6	8.8	
	14	53.6	-17.8	-24.6	234	52.9	-25.7	-22.2	221	-0.6	-7.8	2.4	8.2	8.3	
	15	53.7	-21.3	-30.9	235	52.7	-26.4	-28.8	227	-0.9	-5.0	2.1	5.5	5.6	
	16	53.7	-24.8	-37.1	236	53.1	-27.8	-35.8	232	-0.5	-2.9	1.3	3.3	3.3	
C	17	53.8	-28.3	-43.4	237	53.8	-28.3	-43.4	237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 4.0$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 4.1$
	18	50.1	62.1	48.9	38	50.1	62.1	48.9	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
O	19	51.7	30.9	27.8	42	52.4	36.5	28.5	38	0.6	5.7	0.7	5.7	5.7	Mean CIELAB difference (17 steps)
	20	53.3	-0.3	6.7	93	53.3	-0.3	6.7	93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Z	21	53.6	-14.3	-18.3	232	52.0	-22.7	-16.4	216	-1.5	-8.3	1.9	8.6	8.8	Mean CIELAB difference (5 steps)
	22	53.8	-28.3	-43.4	237	53.8	-28.3	-43.4	237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
C	23	53.8	-28.3	-43.4	237	53.8	-28.3	-43.4	237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 2.9$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 2.9$
	24	53.8	-28.3	-43.4	237	53.8	-28.3	-43.4	237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	


YE320-3N, ; Device: XcmyNP_D50_L; Measurement: L27G00NP.PDF; Date: 20070202

T	i	LAB*a,ref			hab,ref	LAB*a,out			hab,out	LAB*a,out/c-ref				ΔH^*	ΔE^*	Start output S1
O	1	48.3	58.2	45.6	38	48.3	58.2	45.6	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		Specification according to ISO/IEC 15775 Annex G and DIN 33866-1 Annex G
	2	48.9	50.7	40.7	39	48.7	51.8	40.6	38	-0.1	1.1	0.0	1.1	1.1		
	3	49.5	43.2	35.9	40	49.3	47.3	35.8	37	-0.2	4.1	0.0	4.1	4.1		
	4	50.2	35.7	31.0	41	50.4	41.2	30.6	37	0.3	5.5	-0.3	5.5	5.5		
	5	50.8	28.2	26.2	43	51.3	33.0	26.5	39	0.5	4.8	0.4	4.8	4.8		
	6	51.5	20.7	21.3	46	51.5	24.3	21.1	41	0.1	3.6	-0.1	3.6	3.6	Regularity	
	7	52.1	13.2	16.4	51	52.4	14.4	17.2	50	0.3	1.2	0.8	1.4	1.5	$g^* = 17.2$	
	8	52.7	5.7	11.6	64	53.3	5.4	11.7	65	0.6	-0.2	0.1	0.3	0.7		
Z	9	53.4	-1.7	6.7	105	53.4	-1.7	6.7	105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		Orange red – Cyan blue cmy0: O – Z – C
	10	53.6	-4.0	0.8	169	53.5	-8.1	0.8	174	0.0	-4.0	0.0	4.1	4.1		
	11	53.9	-6.3	-5.0	218	53.5	-13.0	-3.3	195	-0.3	-6.6	1.7	6.9	6.9		
	12	54.1	-8.6	-10.9	232	53.8	-16.8	-9.0	208	-0.3	-8.1	1.9	8.4	8.4		
	13	54.4	-11.0	-16.8	237	52.9	-20.0	-14.8	217	-1.4	-9.0	2.0	9.3	9.4		
	14	54.6	-13.3	-22.7	240	53.9	-21.8	-20.3	223	-0.6	-8.4	2.4	8.9	8.9		
	15	54.9	-15.6	-28.6	241	53.9	-21.3	-26.5	231	-0.9	-5.6	2.1	6.1	6.2	Mean CIELAB difference (17 steps)	
	16	55.1	-17.9	-34.5	243	54.5	-21.3	-33.2	237	-0.5	-3.3	1.3	3.7	3.7	$\Delta H^*_{CIELAB} = 4.0$	
C	17	55.4	-20.2	-40.4	243	55.4	-20.2	-40.4	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 4.1$	
	18	48.3	58.2	45.6	38	48.3	58.2	45.6	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	19	50.8	28.2	26.2	43	51.3	33.0	26.5	39	0.5	4.8	0.4	4.8	4.8		
Z	20	53.4	-1.7	6.7	105	53.4	-1.7	6.7	105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mean CIELAB difference (5 steps)	
	21	54.4	-11.0	-16.8	237	52.9	-20.0	-14.8	217	-1.4	-9.0	2.0	9.3	9.4	$\Delta H^*_{CIELAB} = 2.8$	
C	22	55.4	-20.2	-40.4	243	55.4	-20.2	-40.4	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 2.8$	

YE321-3N, ; Device: Xcmy0NP_D65_L; Measurement: L27G00NP.PDF; Date: 20070202

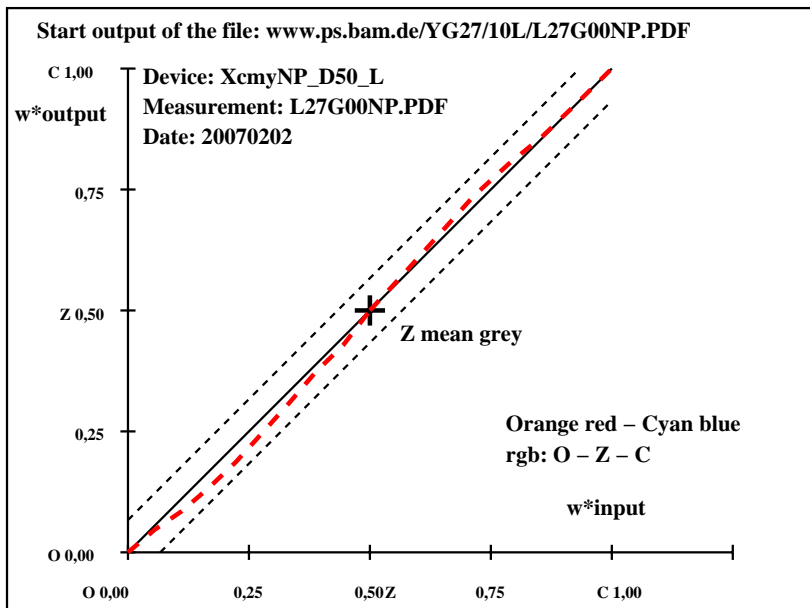

YE320-7N, ; Device: XcmyNP_D50_L; Measurement: L27G00NP.PDF; Date: 20070202

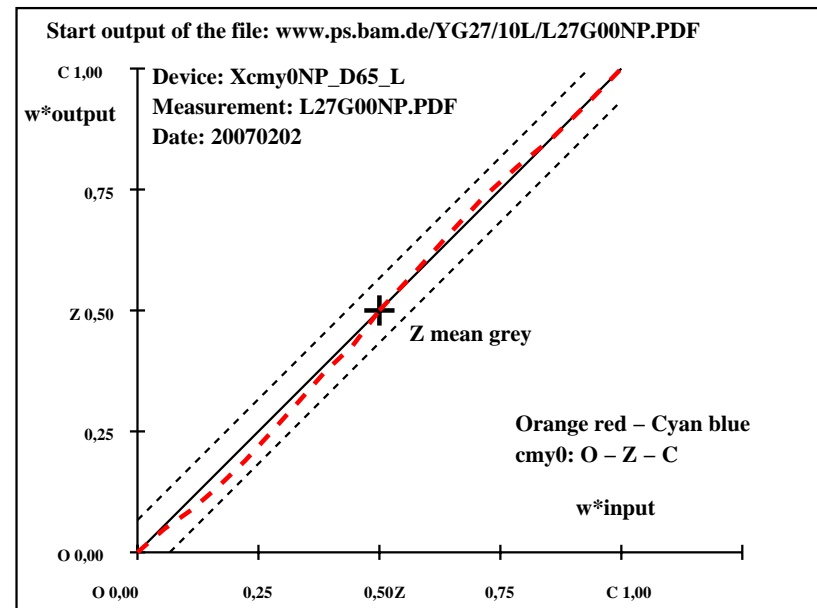

YE321-7N, ; Device: Xcmy0NP_D65_L; Measurement: L27G00NP.PDF; Date: 20070202