


# TUB-Registrierung: 20090701-IG05/IG05L0N1.PS / TXT Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmeftrik/IG05/IG05L0N1.PS / TXT; Start-Ausgabe  
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: http://web.mic.klaus.richter/IG05/IG05L0N1.PS / TXT  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmeftrik

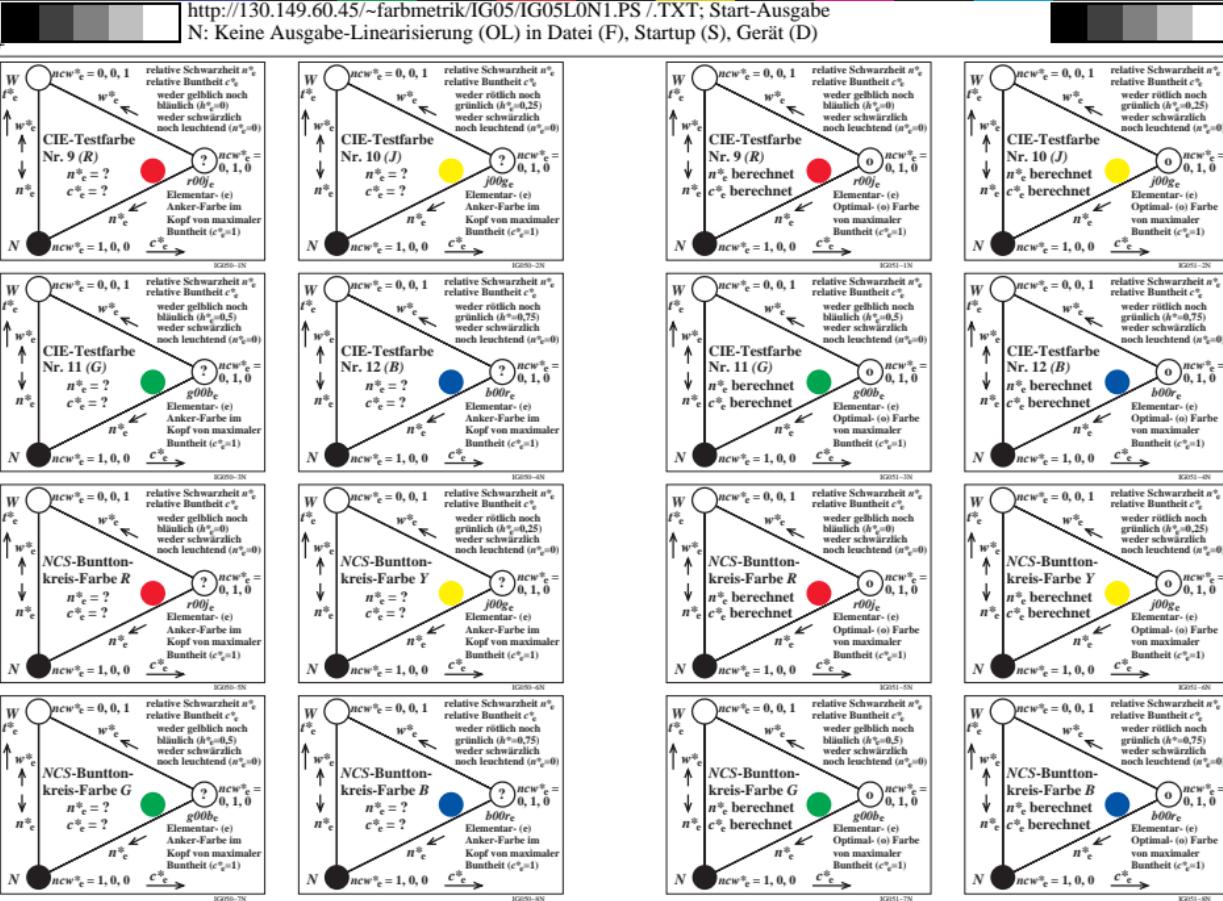

TUB-Prüfvorlage IG05; Farbtransfer und Skalierung  
Farben und relative Schwarheit  $n^*$  und relative Buntheit  $c^*$

input: olv\* setrgbcolor  
output: no change compared to input