


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1							
O	1	35.9	60.7	44.5	36	35.9	60.7	44.5	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	39.5	56.9	41.7	36	40.2	58.0	36.9	32	0.7	1.1	-4.7	4.9	5.0	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	43.0	53.1	39.0	36	45.1	53.5	29.9	29	2.1	0.4	-9.0	9.1	9.3	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	46.6	49.3	36.2	36	49.9	48.2	26.2	29	3.3	-1.0	-9.9	10.0	10.6	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	50.1	45.5	33.4	36	54.4	43.2	21.4	26	4.3	-2.2	-11.9	12.2	12.9	ΔL* = 92.71 – 35.94
	6	53.7	41.7	30.6	36	58.0	38.5	20.0	27	4.3	-3.1	-10.5	11.1	11.9	Gleichmäßigkeit
	7	57.2	37.9	27.9	36	61.6	34.7	16.8	26	4.3	-3.1	-10.9	11.5	12.3	g* = 41.7
	8	60.8	34.1	25.1	36	65.9	29.7	14.8	26	5.1	-4.3	-10.2	11.2	12.3	
	9	64.3	30.3	22.3	36	69.8	25.4	12.6	26	5.4	-4.8	-9.6	10.9	12.2	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	67.9	26.5	19.5	36	73.7	21.2	10.2	26	5.8	-5.2	-9.2	10.7	12.2	f* = 73.3
	11	71.4	22.7	16.8	36	77.6	17.1	7.5	24	6.2	-5.5	-9.2	10.8	12.4	
	12	75.0	18.9	14.0	36	81.3	13.1	5.2	22	6.4	-5.7	-8.7	10.5	12.3	Orangerot – Weiß
	13	78.5	15.1	11.2	37	85.0	8.9	3.2	20	6.5	-6.1	-7.9	10.1	12.0	rgb: O – W
	14	82.1	11.3	8.4	37	88.7	4.5	2.1	25	6.7	-6.7	-6.2	9.3	11.4	
	15	85.6	7.5	5.6	37	92.1	0.0	1.5	90	6.5	-7.4	-4.0	8.6	10.7	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	89.2	3.7	2.9	38	92.6	0.0	0.1	90	3.4	-3.6	-2.7	4.6	5.8	ΔH*CIELAB = 8.6
W	17	92.7	0.0	0.1	135	92.7	0.0	0.1	135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 9.6
O	18	35.9	60.7	44.5	36	35.9	60.7	44.5	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	50.1	45.5	33.4	36	54.4	43.2	21.4	26	4.3	-2.2	-11.9	12.2	12.9	
	20	64.3	30.3	22.3	36	69.8	25.4	12.6	26	5.4	-4.8	-9.6	10.9	12.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	78.5	15.1	11.2	37	85.0	8.9	3.2	20	6.5	-6.1	-7.9	10.1	12.0	ΔH*CIELAB = 6.6
W	22	92.7	0.0	0.1	135	92.7	0.0	0.1	135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 7.4
										Mittlerer Farbwiedergabe-Index:		R*_{ab,m} = 58			


IG470-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out/c-refΔH* ΔE*				Start-Ausgabe S1			
O	1	46.3	60.0	40.4	34	46.3	60.0	40.4	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G relative CIELAB Daten für "aus" ΔL* = 95.41 – 46.31 Gleichmäßigkeit g* = 11.8
	2	49.4	56.3	37.9	34	46.3	60.2	39.3	33	-3.0	4.0	1.4	4.2	5.2	
	3	52.4	52.5	35.4	34	46.2	60.6	37.3	32	-6.2	8.1	1.9	8.3	10.4	
	4	55.5	48.8	32.8	34	47.1	60.0	34.0	30	-8.3	11.3	1.2	11.3	14.1	
	5	58.6	45.0	30.3	34	48.6	58.4	30.4	27	-9.9	13.4	0.1	13.4	16.7	
	6	61.7	41.3	27.8	34	50.7	55.6	26.0	25	-10.8	14.3	-1.7	14.5	18.1	
	7	64.7	37.5	25.3	34	53.3	51.8	22.8	24	-11.3	14.3	-2.4	14.5	18.5	
	8	67.8	33.8	22.7	34	56.9	46.7	20.7	24	-10.8	13.0	-1.9	13.1	17.1	
	9	70.9	30.0	20.2	34	60.7	41.1	18.9	25	-10.1	11.1	-1.2	11.2	15.1	
10	73.9	26.3	17.7	34	64.9	34.8	17.4	27	-8.9	8.5	-0.2	8.6	12.4	Helligkeitsumfang relativ zu Offset f* = 63.4	
11	77.0	22.5	15.2	34	70.6	27.0	14.4	28	-6.3	4.5	-0.7	4.6	7.9		
12	80.1	18.8	12.6	34	75.6	21.2	10.6	27	-4.4	2.5	-1.9	3.2	5.5	Orangerot – Weiß rgb: O – W	
13	83.1	15.0	10.1	34	80.1	15.9	8.3	28	-2.9	0.9	-1.7	2.0	3.6		
14	86.2	11.3	7.6	34	84.1	11.4	6.3	29	-2.0	0.1	-1.2	1.3	2.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) ΔH*CIELAB = 6.6 ΔE*CIELAB = 8.9	
15	89.3	7.5	5.0	34	88.4	6.7	4.0	31	-0.8	-0.7	-0.9	1.3	1.6		
16	92.3	3.8	2.5	34	90.0	3.2	1.9	31	-2.3	-0.4	-0.5	0.8	2.5		
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) ΔH*CIELAB = 5.3 ΔE*CIELAB = 7.1
O	18	46.3	60.0	40.4	34	46.3	60.0	40.4	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	58.6	45.0	30.3	34	48.6	58.4	30.4	27	-9.9	13.4	0.1	13.4	16.7	
	20	70.9	30.0	20.2	34	60.7	41.1	18.9	25	-10.1	11.1	-1.2	11.2	15.1	Mittlerer Farbwiedergabe-Index: R*_{ab,m} = 61
	21	83.1	15.0	10.1	34	80.1	15.9	8.3	28	-2.9	0.9	-1.7	2.0	3.6	
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

IG471-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

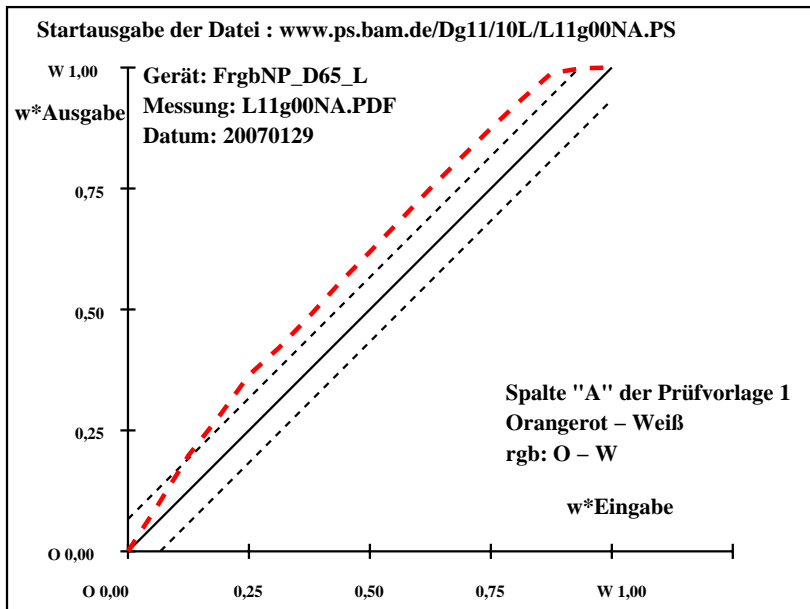

IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

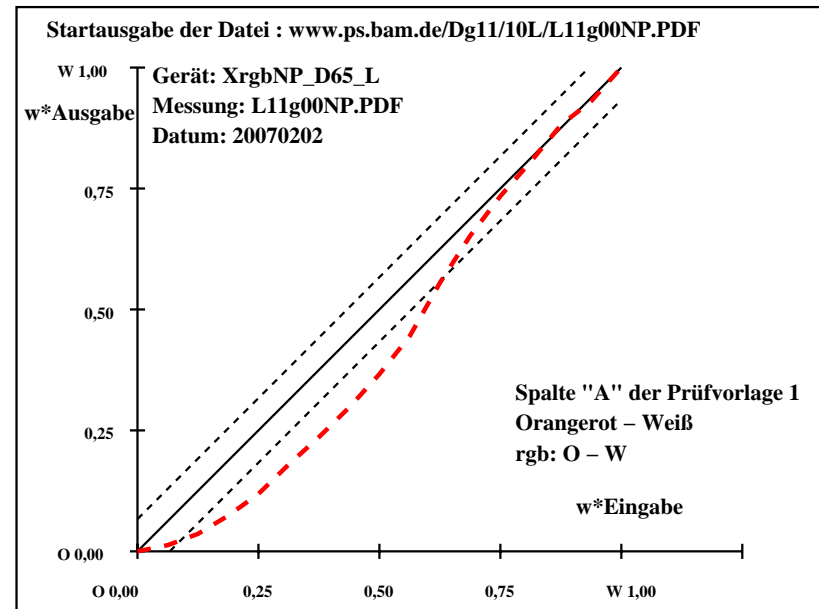


IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a _{ref}	hab.ref	LAB*a _{out}	hab _{out}	LAB*a _{out} /c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1							
Y	1	84.3	-4.1	110.2	92	84.3	-4.1	110.2	92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach	
	2	84.8	-3.8	103.3	92	85.7	-5.9	98.1	93	0.9	-2.0	-5.1	5.6	5.7	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G	
	3	85.3	-3.6	96.4	92	86.8	-7.5	85.9	95	1.5	-3.8	-10.4	11.2	11.3	und DIN 33866-1:2000 Anhang G	
	4	85.8	-3.3	89.5	92	87.5	-8.3	77.2	96	1.7	-4.9	-12.2	13.3	13.4	relative CIELAB Daten für "aus"	
	5	86.3	-3.0	82.6	92	88.2	-8.6	67.4	97	1.8	-5.5	-15.1	16.2	16.3	$\Delta L^* = 92.58 - 84.27$	
	6	86.9	-2.8	75.8	92	88.5	-8.6	61.7	98	1.6	-5.7	-14.0	15.2	15.3	Gleichmäßigkeit	
	7	87.4	-2.5	68.9	92	89.0	-8.5	54.3	99	1.6	-5.9	-14.5	15.8	15.8	$g^* = 18.5$	
	8	87.9	-2.3	62.0	92	89.5	-8.1	46.9	100	1.6	-5.7	-15.0	16.2	16.3	Helligkeitsumfang relativ zu Offset	
	9	88.4	-2.0	55.1	92	90.1	-7.8	40.1	101	1.6	-5.7	-14.9	16.1	16.2	$f^* = 10.7$	
	10	88.9	-1.7	48.2	92	90.5	-6.9	33.3	102	1.5	-5.1	-14.8	15.8	15.9	Gelb – Weiß	
	11	89.5	-1.5	41.3	92	91.0	-6.0	25.6	103	1.5	-4.4	-15.6	16.4	16.4	rgb: Y – W	
	12	90.0	-1.2	34.4	92	91.5	-4.7	18.6	104	1.5	-3.4	-15.7	16.2	16.3	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)	
	13	90.5	-1.0	27.6	92	91.9	-3.2	12.0	105	1.4	-2.2	-15.5	15.7	15.8	$\Delta H^*_{CIELAB} = 12.1$	
	14	91.0	-0.7	20.7	92	92.2	-1.8	6.5	106	1.2	-1.0	-14.1	14.2	14.3	$\Delta E^*_{CIELAB} = 12.2$	
	15	91.5	-0.4	13.8	92	92.5	-0.6	2.0	109	1.0	-0.1	-11.7	11.8	11.8	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)	
	16	92.1	-0.2	6.9	92	92.6	0.0	0.1	90	0.5	0.3	-6.7	6.8	6.8	$\Delta H^*_{CIELAB} = 9.6$	
W	17	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 9.7$	
Y	18	84.3	-4.1	110.2	92	84.3	-4.1	110.2	92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 47$	
	19	86.3	-3.0	82.6	92	88.2	-8.6	67.4	97	1.8	-5.5	-15.1	16.2	16.3		
	20	88.4	-2.0	55.1	92	90.1	-7.8	40.1	101	1.6	-5.7	-14.9	16.1	16.2		
	21	90.5	-1.0	27.6	92	91.9	-3.2	12.0	105	1.4	-2.2	-15.5	15.7	15.8		
W	22	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

IG470-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg11/10L/L11g00NA.PS

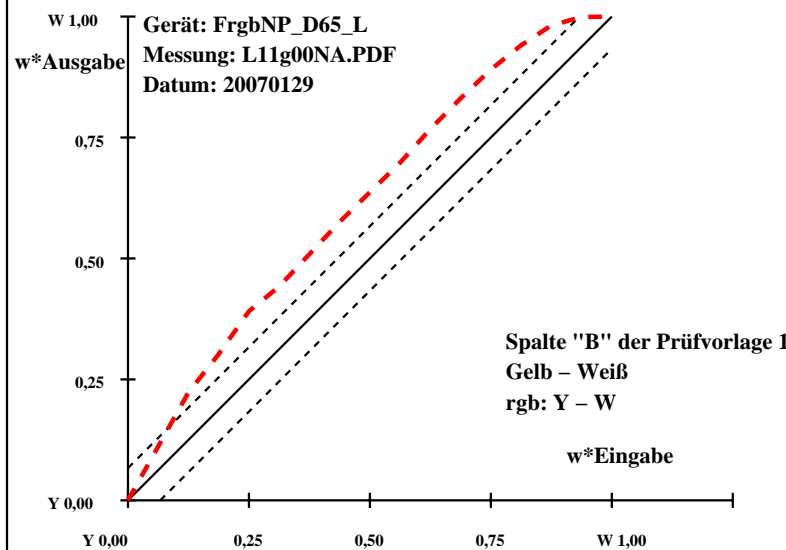


IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1								
Y	1	90.9	-16.9	112.4	99	90.9	-16.9	112.4	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach		
	2	91.2	-15.8	105.4	99	90.8	-16.9	112.7	99	-0.2	-1.0	7.3	7.4	7.4	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G		
	3	91.5	-14.8	98.4	99	90.8	-16.8	112.6	99	-0.6	-1.9	14.3	14.4	14.4	und DIN 33866-1:2000 Anhang G		
	4	91.7	-13.7	91.3	99	90.9	-16.8	111.9	99	-0.8	-3.0	20.6	20.8	20.8	relative CIELAB Daten für "aus"		
	5	92.0	-12.7	84.3	99	91.0	-17.0	108.7	99	-1.0	-4.2	24.4	24.8	24.8	$\Delta L^* = 95.43 - 90.9$		
	6	92.3	-11.6	77.3	99	91.1	-17.1	105.1	99	-1.1	-5.4	27.8	28.4	28.4	Gleichmäßigkeit		
	7	92.6	-10.6	70.3	99	91.1	-17.2	99.2	100	-1.4	-6.5	28.9	29.7	29.7	$g^* = 3.8$		
	8	92.9	-9.5	63.2	99	91.5	-16.9	89.7	101	-1.2	-7.3	26.5	27.5	27.5	Helligkeitsumfang relativ zu Offset		
	9	93.2	-8.5	56.2	99	91.9	-16.0	75.8	102	-1.1	-7.5	19.6	21.0	21.0	$f^* = 5.9$		
	10	93.4	-7.4	49.2	99	92.3	-15.1	66.4	103	-1.0	-7.6	17.2	18.9	18.9	Gelb – Weiß		
	11	93.7	-6.3	42.2	99	92.6	-13.9	57.1	104	-1.0	-7.5	14.9	16.8	16.8	rgb: Y – W		
	12	94.0	-5.3	35.1	99	93.0	-12.7	48.1	105	-0.9	-7.3	13.0	14.9	15.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)		
	13	94.3	-4.2	28.1	99	93.3	-11.5	41.2	106	-0.9	-7.2	13.1	15.0	15.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 15.2$		
	14	94.6	-3.2	21.1	99	93.9	-8.9	29.4	107	-0.6	-5.6	8.3	10.1	10.1	$\Delta E^*_{CIELAB} = 15.3$		
	15	94.9	-2.1	14.1	99	94.4	-6.2	19.0	108	-0.4	-4.0	4.9	6.4	6.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)		
	16	95.1	-1.1	7.0	99	95.0	-3.2	9.0	110	-0.1	-2.0	2.0	2.9	2.9	$\Delta H^*_{CIELAB} = 15.2$		
W	17	95.4	0.0	0.0	180	95.4	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 15.3$		
Y	18	90.9	-16.9	112.4	99	90.9	-16.9	112.4	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)		
	19	92.0	-12.7	84.3	99	91.0	-17.0	108.7	99	-1.0	-4.2	24.4	24.8	24.8	$\Delta H^*_{CIELAB} = 12.2$		
	20	93.2	-8.5	56.2	99	91.9	-16.0	75.8	102	-1.1	-7.5	19.6	21.0	21.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 12.2$		
	21	94.3	-4.2	28.1	99	93.3	-11.5	41.2	106	-0.9	-7.2	13.1	15.0	15.0	Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 33$		
W	22	95.4	0.0	0.0	180	95.4	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

IG471-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg11/10L/L11g00NP.PDF

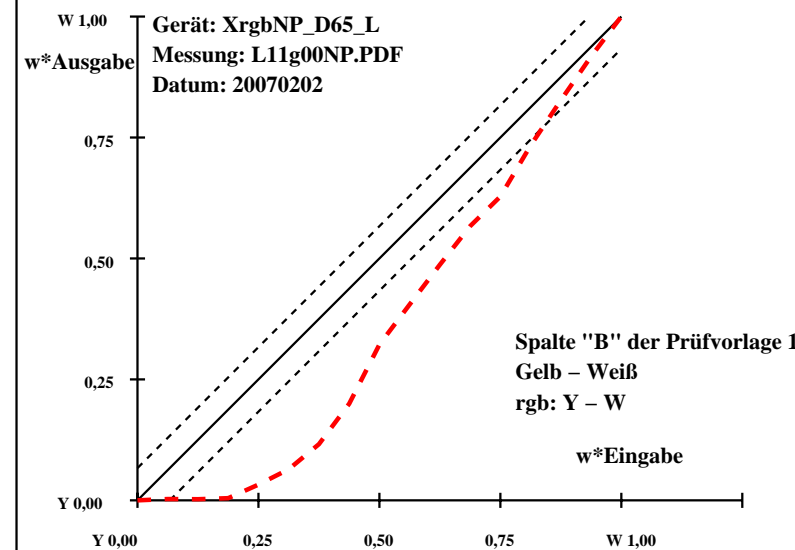

IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

out	hab,out	LAB*a,out/c-re Δ H*	re Δ H*	Δ E*	Start-Ausgabe S1			
7	48,5	142	0,0	0,0	0,0	0,0	Kennzeichnung nach	
2	44	146	1,8	-2,3	-0,8	2,5	3,1	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
4	39,7	145	3,3	-3,3	-2,6	4,4	5,5	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
0	37,0	146	4,4	-3,8	-2,3	4,6	6,4	relative CIELAB Daten für "aus"

0	31.7	145	5.8	-3.5	-1.5	4.0	7.0	Gleichmäßigkeit
2	27.8	147	5.8	-3.6	-2.4	4.5	7.3	$g^* = 27.4$

4	20.7	149	5.7	-3.5	-3.4	5.1	7.6	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
4	16.9	150	6.2	-2.4	-4.2	5.0	7.9	$f^* = 62.8$

2	10.0	151	7.2	1.0	-5.1	5.3	8.9	Laubgrün – Weiß
1	6.8	151	7.3	3.3	-5.2	6.2	9.6	rgb: L – W

3 1.6 131 5.7 6.3 -4.4 7.7 9.6 **Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)**
$$0 \quad 0.0 \quad 0 \quad 3.0 \quad 3.9 \quad -2.9 \quad 4.9 \quad 5.8 \quad \Delta H^*_{\text{CIE LAB}} = 4.4$$
$$0 \quad 0.0 \quad 0 \quad 0.0 \quad 0.0 \quad 0.0 \quad 0.0 \quad 0.0 \quad \Delta E^*_{\text{CIE LAB}} = \quad 6.6$$

7	48.5	142	0.0	0.0	0.0	0.0	0
---	------	-----	-----	-----	-----	-----	---

6	33.0	146	5.6	-3.3	-3.3	4.8	7.4
---	------	-----	-----	------	------	-----	-----

4	20.7	140	5.7	3.5	3.4	5.1	7.6
---	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4	20.7	149	5.7	-3.5	-3.4	5.1	7.0
1	6.0	151	5.3	3.3	5.3	6.3	3.6

1	6.8	131	7.5	3.3	-3.2	6.2	9.6
2	6.8	3	7.3	3.3	3.2	6.2	9.6


0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
---	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 71$

IG470-3N, Gerät: FrgbNP D65 L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg11/10L/L11g00NA.PS

W 1,00	Gerät: FrgbNP_D65_L
w*Ausgabe	Messung: L11g00NA.PDF
	Datum: 20070129

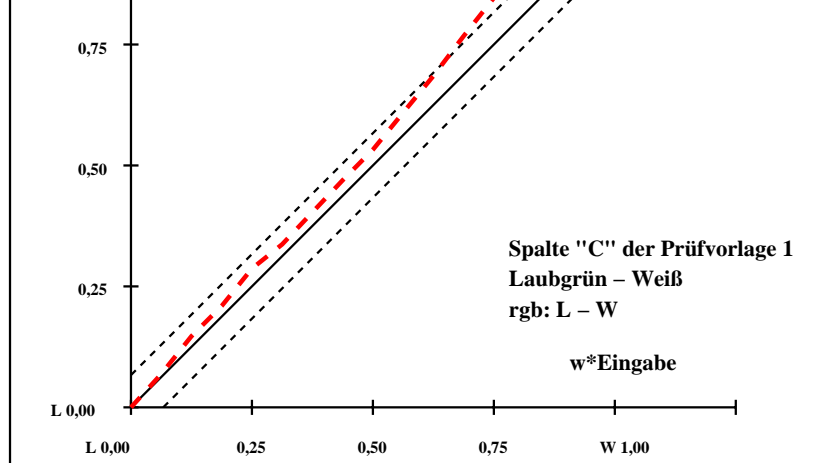

IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

TUB-Prüfvorlage IG47 für Ausgabe-Kennzeichnung
17-stufige Farbreihe "C"; *rgb*-Eingabedaten; 2 Geräte, Seite 3/24

T	i	LAB*a,ref	hab.ref	LAB*a,out	hab.out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1					
L	1	45.7–67.4	36.2	152	45.7–67.4	36.2	152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	48.8–63.2	33.9	152	45.3–66.7	36.0	152	-3.4	-3.4	2.1	4.1	5.4		ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	51.9–59.0	31.7	152	45.5–66.5	36.6	151	-6.3	-7.4	4.9	9.0	11.1		und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	55.0–54.7	29.4	152	45.6–66.1	36.6	151	-9.4	-11.3	7.2	13.4	16.4		relative CIELAB Daten für "aus"

6	61.3	-46.3	24.9	152	45.7	-65.3	37.2	150	-15.4	-18.9	12.3	22.6	27.4	Gleichmäßigkeit
7	64.4	-42.1	22.7	152	47.4	-63.4	38.4	149	-16.9	-21.2	15.7	26.5	31.5	$g^* = 0.6$

9	70.6	-33.7	18.2	152	53.0	-55.8	36.0	147	-17.5	-22.1	17.9	28.4	33.4	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
10	73.7	-29.4	15.9	152	57.2	-49.9	28.9	150	-16.4	-20.4	13.0	24.3	29.4	$f^* = 64.4$

12	80.0–21.0	11.4	152	67.6–35.2	20.9	149	–12.3–14.1	9.5	17.1	21.1	Laubgrün – Weiß
13	83.1–16.8	9.1	152	74.0–27.6	20.2	144	–8.9–10.7	11.1	15.5	17.9	rgb: L – W

15 89.3 -8.3 4.6 151 85.8 -14.1 12.7 138 -3.4 -5.7 8.1 9.9 10.5 **Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)**

16	92.4	-4.1	2.4	151	90.6	-7.1	5.2	144	-1.7	-2.9	2.8	4.1	4.5	$\Delta H^*_{\text{CIELAB}} = 15.0$
----	------	------	-----	-----	------	------	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-------------------------------------

W 17	95.5	0.0	0.1	90	95.5	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{\text{CIE LAB}} =$	17.9
------	------	-----	-----	----	------	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	---------------------------------	-------------

I. 18 45.7-67.4 36.2 152 45.7-

19	58.2	-50.5	27.2	152	45.8
----	------	-------	------	-----	------

19	30.2	30.3	27.2	152	43.0
20	70.6	33.7	18.2	152	53.0

20	70.0	-33.7	18.2	152	53.0
21	62.1	-16.9	8.1	153	54.0

21	85.1-16.8	9.1	152	74.0-
----	-----------	-----	-----	-------


W	22	95.5	0.0	0.1	90	95.5
---	----	------	-----	-----	----	------

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 21$

IG471-3N, Gerät: XrgbNP D65 L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg11/10L/L11g00NP.PDF

W 1,00 | Gerät: XrgbNP_D65_L
w*Ausgabe | Messung: L11g00NP.PDF
| Datum: 20070202

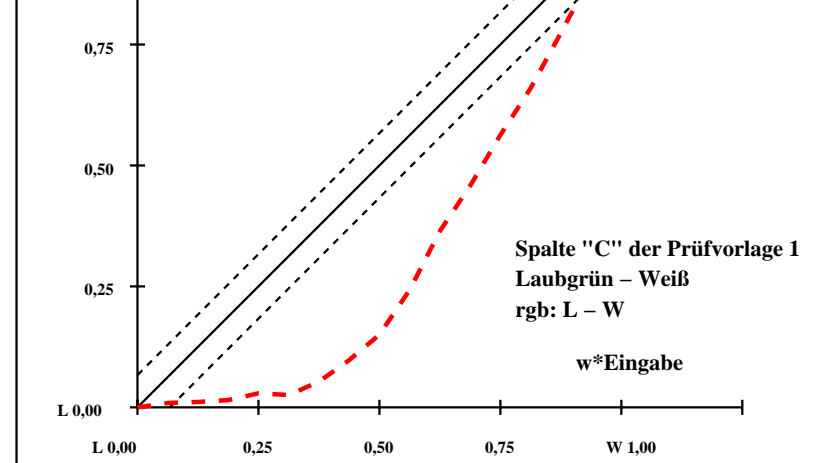


IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L1lg00NP.PDF; Datum: 20070202

Eingabe: *rgb* (->*olv**) *setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
C	1	53.7	-28.9	-31.6	228	53.7	-28.9	-31.6	228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	56.2	-27.1	-29.6	228	57.8	-29.4	-29.9	225	1.6	-2.2	-0.2	2.3	2.8	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	58.6	-25.3	-27.6	228	61.5	-29.2	-28.0	224	2.9	-3.8	-0.3	3.9	4.9	und DIN 33866-1:2000 Anhang C
	4	61.0	-23.5	-25.7	228	64.8	-28.4	-26.0	222	3.7	-4.8	-0.2	4.9	6.2	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	63.5	-21.7	-23.7	228	67.9	-27.1	-23.8	221	4.4	-5.4	0.0	5.5	7.0	$\Delta L^* = 92.62 - 53.73$
	6	65.9	-19.8	-21.7	228	70.7	-25.7	-21.9	220	4.8	-5.8	-0.1	5.9	7.6	Gleichmäßigkeit
	7	68.3	-18.0	-19.7	228	73.0	-24.0	-20.1	220	4.7	-5.9	-0.3	6.0	7.6	$g^* = 27.5$
	8	70.7	-16.2	-17.7	228	75.5	-22.4	-18.0	219	4.7	-6.1	-0.2	6.2	7.8	
	9	73.2	-14.4	-15.8	228	77.9	-20.5	-15.9	218	4.8	-6.0	0.0	6.1	7.7	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	75.6	-12.6	-13.8	228	80.6	-18.0	-13.5	217	5.0	-5.3	0.3	5.4	7.3	$j^* = 50.2$
	11	78.0	-10.8	-11.8	228	83.4	-15.2	-10.7	215	5.4	-4.3	1.1	4.6	7.1	
	12	80.5	-9.0	-9.8	228	86.1	-12.0	-7.9	213	5.7	-2.9	1.9	3.6	6.7	Cyanblau – Weiß
	13	82.9	-7.2	-7.8	228	88.7	-8.0	-4.9	212	5.8	-0.8	2.9	3.0	6.6	rgb: C – W
	14	85.3	-5.3	-5.8	228	90.8	-4.0	-2.3	210	5.5	1.3	3.5	3.8	6.7	
	15	87.8	-3.5	-3.9	228	92.5	-0.6	-0.1	196	4.7	2.9	3.8	4.8	6.7	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	90.2	-1.7	-1.9	228	92.5	0.0	0.0	0	2.3	1.8	2.0	2.7	3.5	$\Delta H^*_{CIELAB} = 4.0$
W	17	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 5.7$
C	18	53.7	-28.9	-31.6	228	53.7	-28.9	-31.6	228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	63.5	-21.7	-23.7	228	67.9	-27.1	-23.8	221	4.4	-5.4	0.0	5.5	7.0	
	20	73.2	-14.4	-15.8	228	77.9	-20.5	-15.9	218	4.8	-6.0	0.0	6.1	7.7	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	82.9	-7.2	-7.8	228	88.7	-8.0	-4.9	212	5.8	-0.8	2.9	3.0	6.6	$\Delta H^*_{CIELAB} = 2.9$
W	22	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 4.3$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 75$					

IG470-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg11/10L/L11g00NA.PS

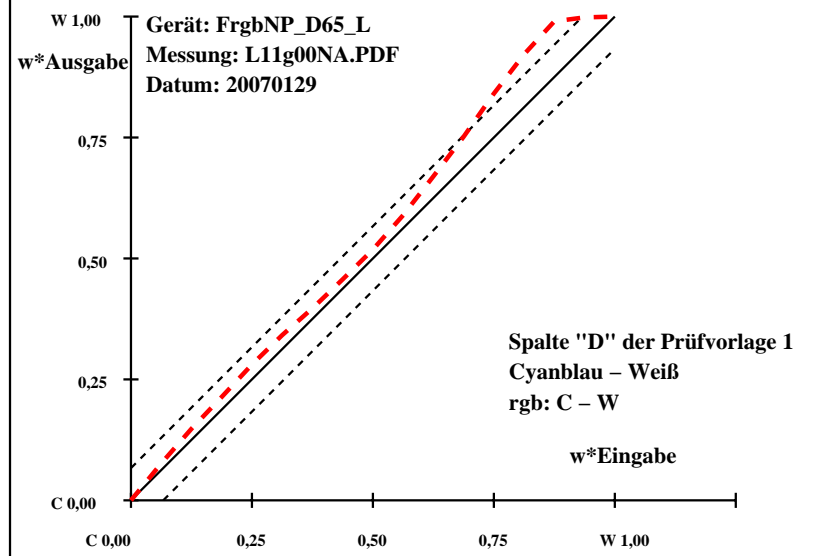


IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

TUB-Prüfvorlage IG47 für Ausgabe-Kennzeichnung
17-stufige Farbreihe "D"; rgb-Eingabedaten; 2 Geräte, Seite 4/24

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*								
C	1	51.2	-15.7	-52.5	253	51.2	-15.7	-52.5	253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Start-Ausgabe S1
	2	53.9	-14.7	-49.2	253	51.0	-15.5	-52.8	254	-2.8	-0.7	-3.5	3.7	4.7		Kennzeichnung nach
	3	56.7	-13.7	-45.9	253	50.8	-15.2	-52.8	254	-5.8	-1.4	-6.8	7.0	9.2		ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	4	59.5	-12.7	-42.7	253	51.1	-15.3	-52.7	254	-8.3	-2.5	-9.9	10.4	13.3		und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	5	62.2	-11.8	-39.4	253	51.7	-15.6	-52.4	253	-10.4	-3.7	-12.9	13.6	17.2		relative CIELAB Daten für "aus"
	6	65.0	-10.8	-36.1	253	52.7	-16.2	-51.3	252	-12.2	-5.3	-15.1	16.1	20.3		$\Delta L^* = 95.39 - 51.16$
	7	67.7	-9.8	-32.8	253	55.1	-16.2	-48.9	252	-12.5	-6.3	-16.0	17.3	21.4		Gleichmäßigkeit
	8	70.5	-8.8	-29.5	253	57.0	-16.3	-45.4	250	-13.4	-7.4	-15.8	17.6	22.1		$g^* = 2.5$
	9	73.3	-7.8	-26.3	253	58.6	-15.8	-40.9	249	-14.6	-7.9	-14.6	16.7	22.2		Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	76.0	-6.8	-23.0	253	60.9	-15.4	-36.7	247	-15.0	-8.5	-13.6	16.2	22.1		$f^* = 57.1$
	11	78.8	-5.8	-19.7	253	64.9	-13.8	-30.9	246	-13.8	-7.9	-11.1	13.8	19.6		
	12	81.6	-4.8	-16.4	253	68.6	-12.1	-26.3	245	-12.9	-7.2	-9.8	12.3	17.9		Cyanblau – Weiß
	13	84.3	-3.9	-13.1	253	74.3	-10.3	-21.2	244	-9.9	-6.4	-8.0	10.3	14.4		rgb: C – W
	14	87.1	-2.9	-9.8	253	81.0	-8.3	-15.4	242	-6.0	-5.3	-5.5	7.8	9.9		
	15	89.9	-1.9	-6.6	253	87.0	-5.8	-9.9	239	-2.7	-3.8	-3.2	5.2	5.9		Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	92.6	-0.9	-3.3	254	91.1	-3.2	-5.5	239	-1.5	-2.2	-2.1	3.2	3.6		$\Delta H^*_{CIELAB} = 10.1$
W	17	95.4	0.0	0.0	270	95.4	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		$\Delta E^*_{CIELAB} = 13.2$
C	18	51.2	-15.7	-52.5	253	51.2	-15.7	-52.5	253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	19	62.2	-11.8	-39.4	253	51.7	-15.6	-52.4	253	-10.4	-3.7	-12.9	13.6	17.2		
	20	73.3	-7.8	-26.3	253	58.6	-15.8	-40.9	249	-14.6	-7.9	-14.6	16.7	22.2		Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	84.3	-3.9	-13.1	253	74.3	-10.3	-21.2	244	-9.9	-6.4	-8.0	10.3	14.4		$\Delta H^*_{CIELAB} = 8.1$
W	22	95.4	0.0	0.0	270	95.4	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		$\Delta E^*_{CIELAB} = 10.8$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 42$						

IG471-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg11/10L/L11g00NP.PDF

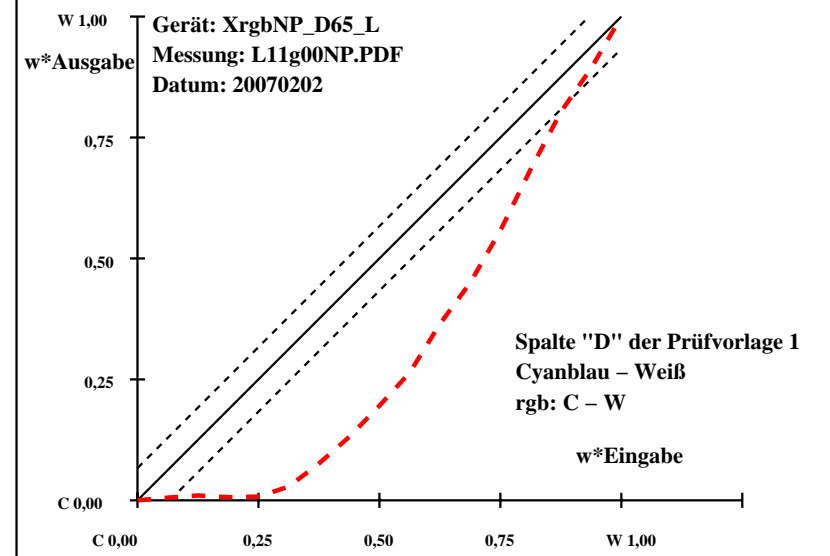

IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

Eingabe: rgb (->olv*) setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	
V	1	14.6	51.7	-60.3	311	14.6	51.7	-60.3	311
	2	19.5	48.5	-56.5	311	20.0	46.6	-59.4	308
	3	24.3	45.2	-52.8	311	26.5	39.6	-56.5	305
	4	29.2	42.0	-49.0	311	32.8	33.1	-52.8	302
	5	34.1	38.8	-45.2	311	38.8	28.0	-49.0	300
	6	39.0	35.5	-41.4	311	44.5	23.9	-45.1	298
	7	43.9	32.3	-37.7	311	49.3	20.5	-41.4	296
	8	48.8	29.1	-33.9	311	55.0	16.2	-37.0	294
	9	53.6	25.9	-30.1	311	60.0	13.0	-33.0	291
	10	58.5	22.6	-26.3	311	65.4	10.5	-28.5	290
	11	63.4	19.4	-22.6	311	70.9	8.1	-23.5	289
	12	68.3	16.2	-18.8	311	76.3	6.2	-18.3	289
	13	73.2	12.9	-15.0	311	82.0	4.4	-12.4	289
	14	78.1	9.7	-11.2	311	87.3	2.3	-6.5	289
	15	82.9	6.5	-7.4	311	91.9	-0.1	-0.5	252
	16	87.8	3.2	-3.7	311	92.7	0.0	0.0	0
W	17	92.7	0.0	0.0	0	92.7	0.0	0.0	0
V	18	14.6	51.7	-60.3	311	14.6	51.7	-60.3	311
	19	34.1	38.8	-45.2	311	38.8	28.0	-49.0	300
	20	53.6	25.9	-30.1	311	60.0	13.0	-33.0	291
	21	73.2	12.9	-15.0	311	82.0	4.4	-12.4	289
W	22	92.7	0.0	0.0	0	92.7	0.0	0.0	0


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 92.7 - 14.57$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 44.2$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 100.9$
Violettblau – Weiß
rgb: V – W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^{*CIELAB} = 8.7$
 $\Delta E^{*CIELAB} = 10.3$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^{*CIELAB} = 6.7$
 $\Delta E^{*CIELAB} = 7.9$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 55$

IG470-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	
V	1	38.2	2.0	-49.0	272	38.2	2.0	-49.0	272
	2	41.8	1.9	-45.9	272	37.0	3.3	-48.9	274
	3	45.4	1.7	-42.8	272	36.9	3.6	-48.9	274
	4	49.0	1.6	-39.8	272	37.2	3.5	-48.7	274
	5	52.5	1.5	-36.7	272	39.0	2.3	-48.4	273
	6	56.1	1.3	-33.6	272	42.9	1.1	-46.3	271
	7	59.7	1.2	-30.5	272	47.4	1.0	-43.1	271
	8	63.3	1.1	-27.4	272	52.3	0.0	-40.0	270
	9	66.9	1.0	-24.3	272	58.2	0.0	-35.4	270
	10	70.5	0.8	-21.3	272	63.9	-0.1	-30.9	270
	11	74.0	0.7	-18.2	272	69.9	0.0	-25.3	270
	12	77.6	0.6	-15.1	272	74.9	-1.0	-21.1	267
	13	81.2	0.4	-12.0	272	79.9	-0.1	-16.6	269
	14	84.8	0.3	-8.9	272	83.2	0.3	-12.9	271
	15	88.4	0.2	-5.9	272	86.5	1.4	-9.4	278
	16	92.0	0.0	-2.8	271	88.4	2.0	-6.9	286
W	17	95.5	0.0	0.2	117	95.5	0.0	0.2	117
V	18	38.2	2.0	-49.0	272	38.2	2.0	-49.0	272
	19	52.5	1.5	-36.7	272	39.0	2.3	-48.4	273
	20	66.9	1.0	-24.3	272	58.2	0.0	-35.4	270
	21	81.2	0.4	-12.0	272	79.9	-0.1	-16.6	269
W	22	95.5	0.0	0.2	117	95.5	0.0	0.2	117

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.54 - 38.21$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 3.5$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 74.1$
Violettblau – Weiß
rgb: V – W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^{*CIELAB} = 7.0$
 $\Delta E^{*CIELAB} = 9.5$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^{*CIELAB} = 5.5$
 $\Delta E^{*CIELAB} = 7.4$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 58$

IG471-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

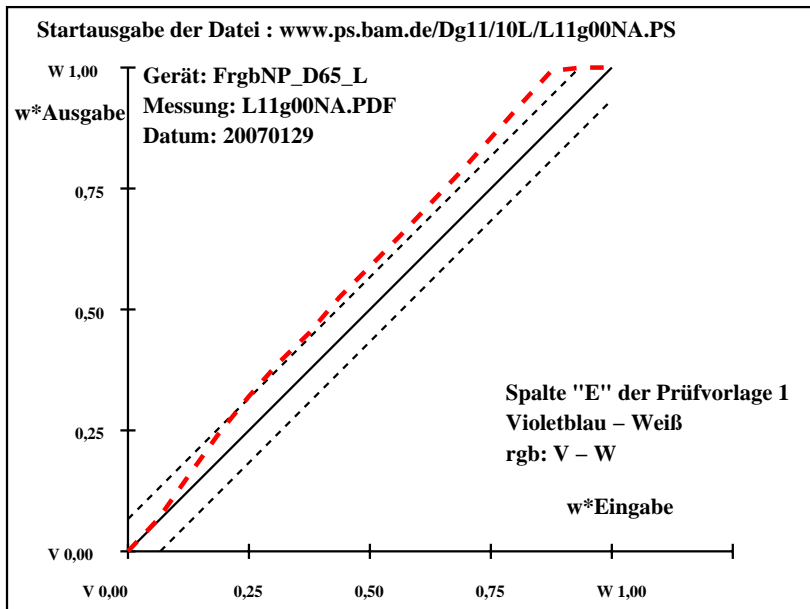

IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

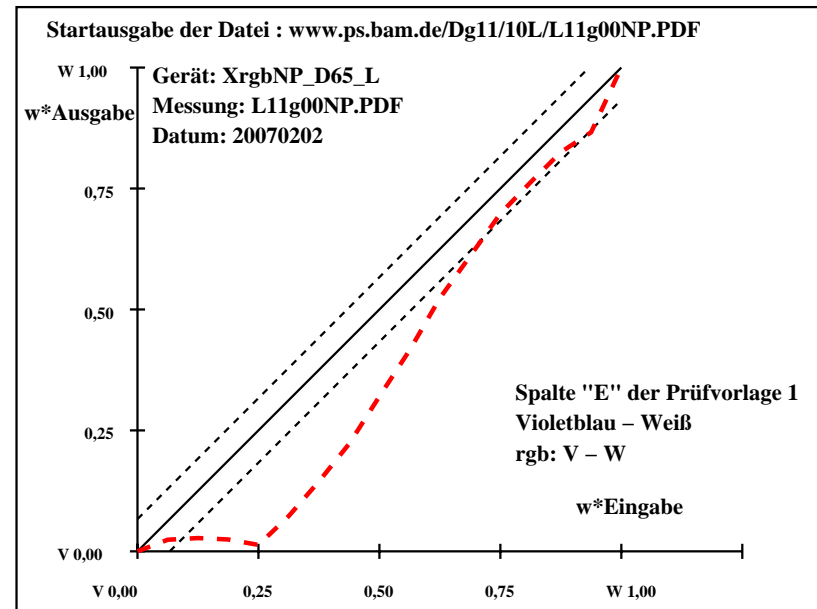


IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	
M	1	38.7	79.2	-34.7	336	38.7	79.2	-34.7	336
	2	42.0	74.3	-32.5	336	43.2	75.8	-35.0	335
	3	45.4	69.3	-30.4	336	48.1	70.5	-34.0	334
	4	48.8	64.4	-28.2	336	52.5	64.8	-32.4	333
	5	52.2	59.4	-26.0	336	56.7	58.8	-30.6	332
	6	55.6	54.5	-23.8	336	60.1	53.8	-28.9	332
	7	58.9	49.5	-21.7	336	63.4	48.7	-26.8	331
	8	62.3	44.6	-19.5	336	67.5	42.5	-23.9	331
	9	65.7	39.6	-17.3	336	71.2	36.7	-21.2	330
	10	69.1	34.6	-15.1	336	75.0	30.7	-18.1	329
	11	72.4	29.7	-13.0	336	78.6	24.7	-14.9	329
	12	75.8	24.8	-10.8	336	82.1	18.7	-11.5	328
	13	79.2	19.8	-8.6	336	85.6	12.7	-8.0	327
	14	82.6	14.8	-6.4	336	89.2	6.5	-4.1	327
	15	85.9	9.9	-4.3	336	92.4	0.5	-0.2	329
	16	89.3	4.9	-2.1	336	92.7	0.0	0.0	0
	17	92.7	0.0	0.0	0	92.7	0.0	0.0	0
M	18	38.7	79.2	-34.7	336	38.7	79.2	-34.7	336
	19	52.2	59.4	-26.0	336	56.7	58.8	-30.6	332
	20	65.7	39.6	-17.3	336	71.2	36.7	-21.2	330
	21	79.2	19.8	-8.6	336	85.6	12.7	-8.0	327
	22	92.7	0.0	0.0	0	92.7	0.0	0.0	0
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 72$									


IG470-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	
M	1	46.1	71.3	-6.3	355	46.1	71.3	-6.3	355
	2	49.2	66.8	-5.9	355	46.3	71.4	-6.5	355
	3	52.3	62.4	-5.5	355	46.7	70.9	-6.7	355
	4	55.4	57.9	-5.1	355	47.0	70.4	-7.1	354
	5	58.5	53.5	-4.7	355	47.4	68.7	-8.6	353
	6	61.5	49.0	-4.3	355	48.8	65.4	-10.6	351
	7	64.6	44.6	-3.9	355	51.1	61.0	-10.8	350
	8	67.7	40.1	-3.5	355	55.2	55.1	-11.6	348
	9	70.8	35.7	-3.1	355	58.8	50.7	-11.1	348
	10	73.9	31.2	-2.7	355	63.9	43.8	-10.6	346
	11	77.0	26.7	-2.3	355	69.2	35.8	-9.3	345
	12	80.0	22.3	-1.9	355	74.3	27.2	-8.7	342
	13	83.1	17.8	-1.5	355	78.1	20.2	-8.4	337
	14	86.2	13.4	-1.1	355	82.0	14.0	-7.8	331
	15	89.3	8.9	-0.7	355	86.4	7.7	-6.5	319
	16	92.4	4.5	-0.3	355	89.9	4.5	-4.3	316
	17	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0
M	18	46.1	71.3	-6.3	355	46.1	71.3	-6.3	355
	19	58.5	53.5	-4.7	355	47.4	68.7	-8.6	353
	20	70.8	35.7	-3.1	355	58.8	50.7	-11.1	348
	21	83.1	17.8	-1.5	355	78.1	20.2	-8.4	337
	22	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 47$									

IG471-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

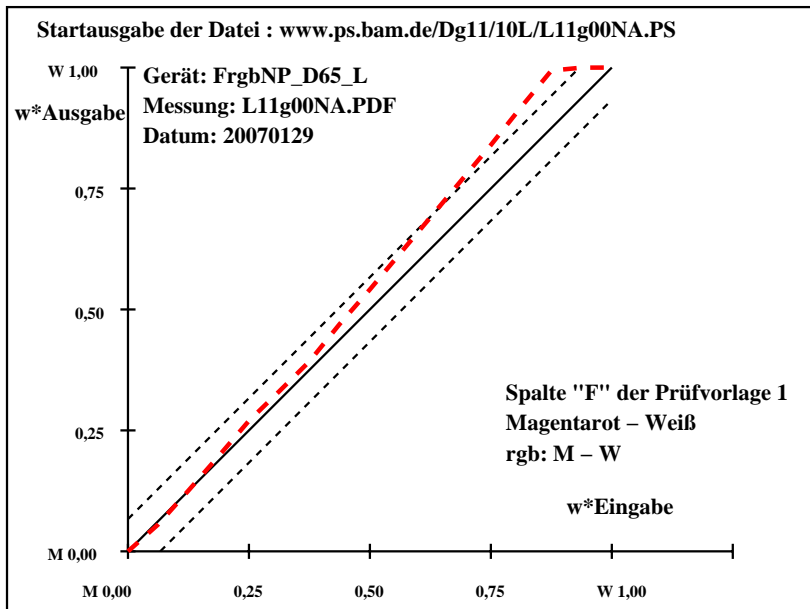

IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

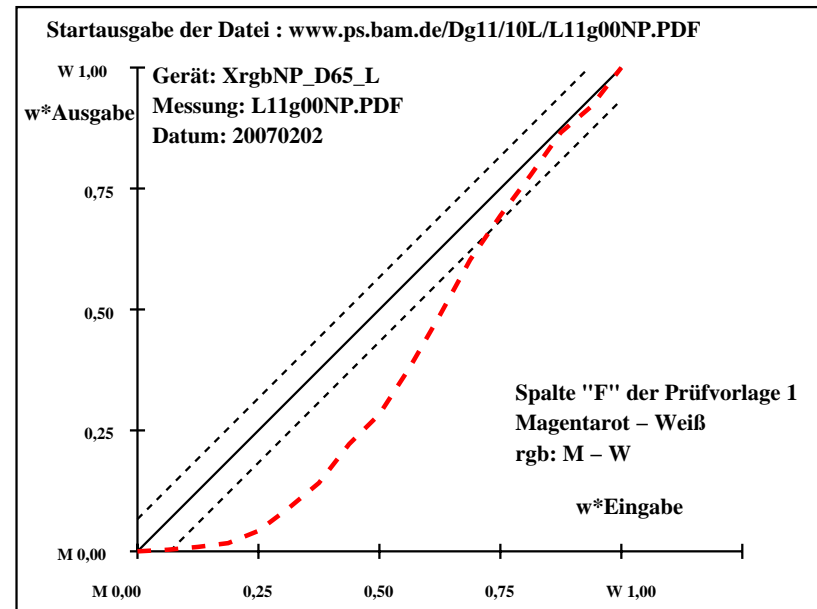


IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1									
N	1	8.7	0.0	0.0	0	8.7	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	13.9	0.0	0.0	0	13.9	0.7	-2.5	285	0.0	0.7	-2.5	2.7	2.7				
	3	19.1	0.0	0.0	0	20.8	-0.2	-3.9	266	1.6	-0.2	-3.9	4.0	4.3				
	4	24.4	0.0	0.0	0	27.4	-1.8	-3.0	238	3.0	-1.8	-3.0	3.6	4.7				
	5	29.6	0.0	0.0	0	34.4	-2.2	-3.4	237	4.7	-2.2	-3.4	4.2	6.3				
	6	34.9	0.0	0.0	0	40.2	-2.7	-1.7	213	5.3	-2.7	-1.7	3.3	6.2				
	7	40.1	0.0	0.0	0	45.9	-3.1	-1.5	207	5.7	-3.1	-1.5	3.6	6.7				
	8	45.4	0.0	0.0	0	52.0	-3.9	-1.1	197	6.6	-3.9	-1.1	4.2	7.8				
Z	9	50.6	0.0	0.0	0	57.5	-3.9	-1.5	202	6.9	-3.9	-1.5	4.3	8.1				
	10	55.9	0.0	0.0	0	63.4	-3.1	-1.9	212	7.5	-3.1	-1.9	3.8	8.4				
	11	61.1	0.0	0.0	0	69.1	-1.8	-2.1	229	8.0	-1.8	-2.1	2.9	8.5				
	12	66.4	0.0	0.0	0	75.2	-0.6	-2.1	252	8.9	-0.6	-2.1	2.3	9.1				
	13	71.6	0.0	0.0	0	81.2	0.1	-1.4	274	9.6	0.1	-1.4	1.5	9.7				
	14	76.9	0.0	0.0	0	86.9	0.0	-0.1	270	10.0	0.0	-0.1	0.2	10.0				
	15	82.1	0.0	0.0	0	92.0	-0.7	1.1	126	9.9	-0.7	1.1	1.4	10.0				
	16	87.4	0.0	0.0	0	92.7	0.0	0.0	0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3				
	17	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
W	18	8.7	0.0	0.0	0	8.7	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	19	29.6	0.0	0.0	0	34.4	-2.2	-3.4	237	4.7	-2.2	-3.4	4.2	6.3				
Z	20	50.6	0.0	0.0	0	57.5	-3.9	-1.5	202	6.9	-3.9	-1.5	4.3	8.1				
	21	71.6	0.0	0.0	0	81.2	0.1	-1.4	274	9.6	0.1	-1.4	1.5	9.7				
W	22	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 72$								


IG470-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1									
N	1	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	26.3	0.0	0.0	0	22.6	0.0	0.0	0	-3.5	0.0	0.0	0.0	3.6				
	3	30.9	0.0	0.0	0	24.8	0.0	0.1	90	-5.9	0.0	0.1	0.1	6.0				
	4	35.5	0.0	0.0	0	29.1	0.0	0.0	0	-6.3	0.0	0.0	0.0	6.4				
	5	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0	0	-5.3	0.0	0.0	0.0	5.4				
	6	44.7	0.0	0.0	0	40.8	0.0	0.0	0	-3.8	0.0	0.0	0.0	3.9				
	7	49.3	0.0	0.0	0	45.6	0.0	0.2	90	-3.6	0.0	0.2	0.2	3.7				
	8	53.9	0.0	0.0	0	52.5	0.0	0.1	90	-1.3	0.0	0.1	0.1	1.4				
Z	9	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.0	0.2	90	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2				
	10	63.2	0.0	0.0	0	64.5	0.0	0.2	90	1.3	0.0	0.2	0.2	1.3				
	11	67.8	0.0	0.0	0	69.4	0.0	0.2	90	1.6	0.0	0.2	0.2	1.6				
	12	72.4	0.0	0.0	0	74.3	0.0	0.2	90	1.9	0.0	0.2	0.2	1.9				
	13	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.0	0.1	90	2.1	0.0	0.1	0.1	2.1				
	14	81.6	0.0	0.0	0	83.0	0.0	0.0	0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4				
	15	86.2	0.0	0.0	0	86.4	0.0	0.1	90	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2				
	16	90.8	0.0	0.0	0	89.7	0.0	0.2	90	-1.1	0.0	0.2	0.2	1.2				
	17	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
W	18	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	19	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0	0	-5.3	0.0	0.0	0.0	5.4				
Z	20	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.0	0.2	90	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2				
	21	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.0	0.1	90	2.1	0.0	0.1	0.1	2.1				
W	22	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 90$								

IG471-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

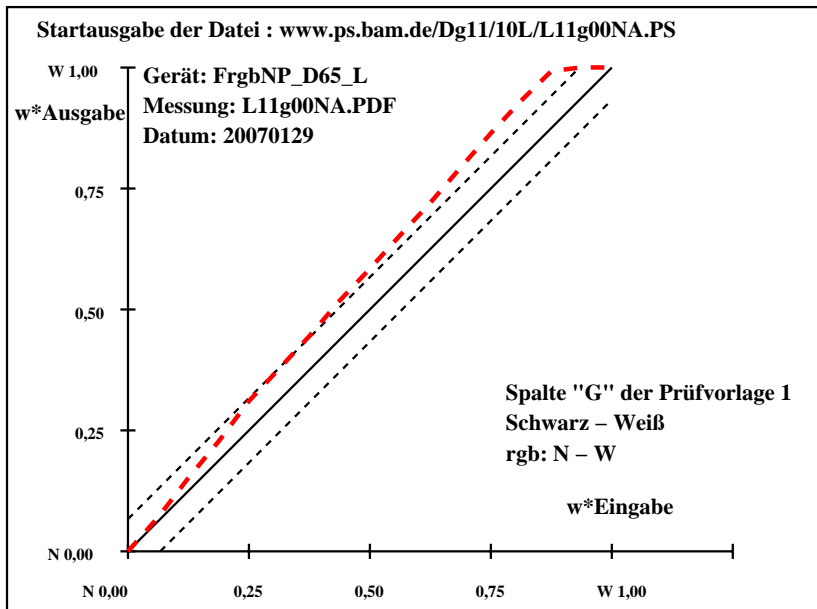

IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

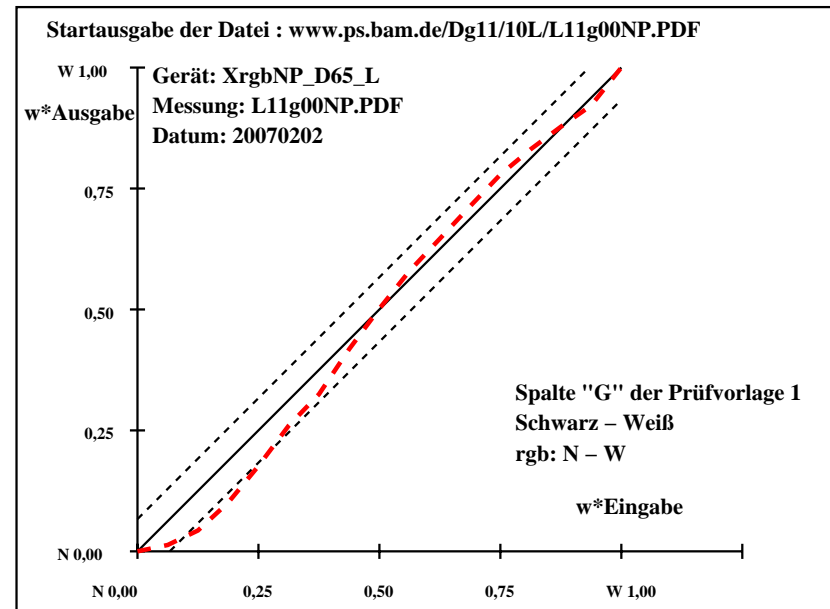


IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out/c-refΔH* ΔE*				Start-Ausgabe S1									
N	1	8.3	0.1	-0.1	297	8.3	0.1	-0.1	297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach						
	2	10.0	3.9	2.6	34	9.7	3.9	1.8	25	-0.3	0.0	-0.7	0.8	0.9	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G						
	3	11.7	7.7	5.4	35	11.3	8.2	4.5	29	-0.3	0.5	-0.8	1.0	1.1	und DIN 33866-1:2000 Anhang C						
	4	13.4	11.5	8.2	35	13.0	12.5	7.3	30	-0.3	1.0	-0.8	1.3	1.4	relative CIELAB Daten für "aus"						
	5	15.0	15.3	11.0	36	14.9	17.1	10.2	31	-0.1	1.8	-0.7	2.0	2.0	ΔL* = 35.11 – 8.34						
	6	16.7	19.1	13.8	36	16.6	21.7	13.2	31	0.0	2.6	-0.5	2.7	2.7	Gleichmäßigkeit						
	7	18.4	22.9	16.6	36	18.4	26.0	16.1	32	0.0	3.1	-0.4	3.1	3.1	g* = 28.8						
	8	20.1	26.7	19.4	36	20.5	30.2	19.4	33	0.4	3.5	0.0	3.5	3.5							
	9	21.7	30.5	22.2	36	22.4	34.9	23.0	33	0.7	4.4	0.8	4.5	4.5	Helligkeitsumfang relativ zu Offset						
	10	23.4	34.3	25.0	36	25.1	39.2	26.1	34	1.7	4.9	1.1	5.0	5.3	J* = 34.6						
	11	25.1	38.1	27.8	36	27.3	44.2	30.5	35	2.2	6.1	2.7	6.7	7.0							
	12	26.7	41.9	30.6	36	29.8	49.1	34.6	35	3.1	7.2	4.0	8.2	8.8	Schwarz – Orangerot						
	13	28.4	45.7	33.4	36	32.3	54.6	39.7	36	3.9	8.9	6.3	10.9	11.6	rgb: N – O						
	14	30.1	49.5	36.2	36	34.0	58.1	42.7	36	3.9	8.6	6.5	10.8	11.5							
	15	31.8	53.3	39.0	36	35.1	60.5	44.7	36	3.4	7.2	5.7	9.2	9.8	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)						
	16	33.4	57.1	41.8	36	35.2	60.7	44.7	36	1.7	3.6	2.9	4.6	4.9	ΔH*CIELAB = 4.4						
	O	17	35.1	60.9	44.6	36	35.1	60.9	44.6	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 4.6					
N	18	8.3	0.1	-0.1	297	8.3	0.1	-0.1	297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	19	15.0	15.3	11.0	36	14.9	17.1	10.2	31	-0.1	1.8	-0.7	2.0	2.0							
	20	21.7	30.5	22.2	36	22.4	34.9	23.0	33	0.7	4.4	0.8	4.5	4.5	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)						
	21	28.4	45.7	33.4	36	32.3	54.6	39.7	36	3.9	8.9	6.3	10.9	11.6	ΔH*CIELAB = 3.5						
O	22	35.1	60.9	44.6	36	35.1	60.9	44.6	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 3.6						
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										R* _{ab,m} = 80											


IG470-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out/c-ref		ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1									
N	1	22.0	0.0	0.0	0	22.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach						
	2	23.5	3.8	2.4	32	21.6	2.1	-0.4	347	-1.9	-1.6	-2.8	3.3	3.9	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G						
	3	25.1	7.6	4.7	32	21.6	4.8	0.7	8	-3.3	-2.7	-3.9	4.9	6.0	und DIN 33866-1:2000 Anhang G						
	4	26.6	11.3	7.1	32	23.6	8.5	4.2	26	-2.9	-2.7	-2.8	4.1	5.1	relative CIELAB Daten für "aus"						
	5	28.1	15.1	9.5	32	26.4	13.3	9.9	37	-1.6	-1.7	0.4	1.9	2.5	$\Delta L^* = 46.32 - 22.02$						
	6	29.6	18.9	11.8	32	30.4	16.7	18.0	47	0.8	-2.1	6.2	6.6	6.6	Gleichmäßigkeit						
	7	31.1	22.7	14.2	32	33.1	22.8	23.4	46	1.9	0.1	9.2	9.2	9.4	$g^* = 44.0$						
	8	32.7	26.5	16.5	32	34.7	28.2	27.1	44	2.0	1.7	10.6	10.7	10.9	Helligkeitsumfang relativ zu Offset						
	9	34.2	30.3	18.9	32	36.4	33.4	29.7	42	2.2	3.2	10.8	11.3	11.5							
	10	35.7	34.0	21.3	32	37.5	37.3	32.0	41	1.8	3.3	10.7	11.2	11.4							
	11	37.2	37.8	23.6	32	38.7	41.6	34.0	39	1.5	3.8	10.4	11.0	11.1	$f^* = 31.4$						
	12	38.7	41.6	26.0	32	39.9	44.7	35.5	38	1.2	3.1	9.5	10.0	10.1	Schwarz – Orangerot						
	13	40.2	45.4	28.4	32	41.4	48.6	36.7	37	1.2	3.2	8.4	9.0	9.0	rgb: N – O						
	14	41.8	49.2	30.7	32	42.9	52.1	38.2	36	1.2	2.9	7.5	8.0	8.1	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)						
	15	43.3	52.9	33.1	32	44.3	54.9	38.0	35	1.0	2.0	4.9	5.3	5.4							
	16	44.8	56.7	35.4	32	45.6	58.3	38.1	33	0.8	1.6	2.7	3.1	3.2							
	O	17	46.3	60.5	37.8	32	46.3	60.5	37.8	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 6.4$					
18		22.0	0.0	0.0	0	22.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 6.7$						
N	19	28.1	15.1	9.5	32	26.4	13.3	9.9	37	-1.6	-1.7	0.4	1.9	2.5	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)						
	20	34.2	30.3	18.9	32	36.4	33.4	29.7	42	2.2	3.2	10.8	11.3	11.5							
	21	40.2	45.4	28.4	32	41.4	48.6	36.7	37	1.2	3.2	8.4	9.0	9.0							
	O	22	46.3	60.5	37.8	32	46.3	60.5	37.8	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 4.4$					
										$\Delta E^*_{CIELAB} = 4.6$											
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 71$											

IG471-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

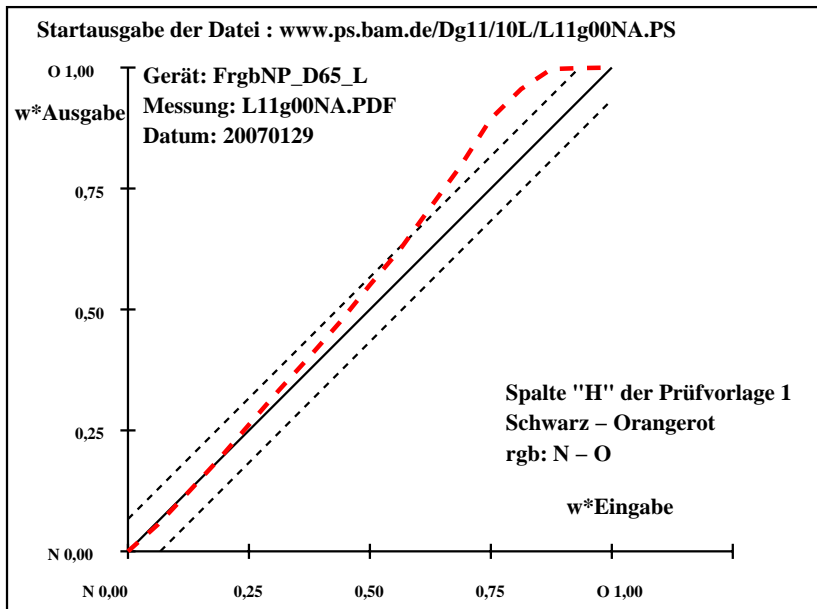

IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

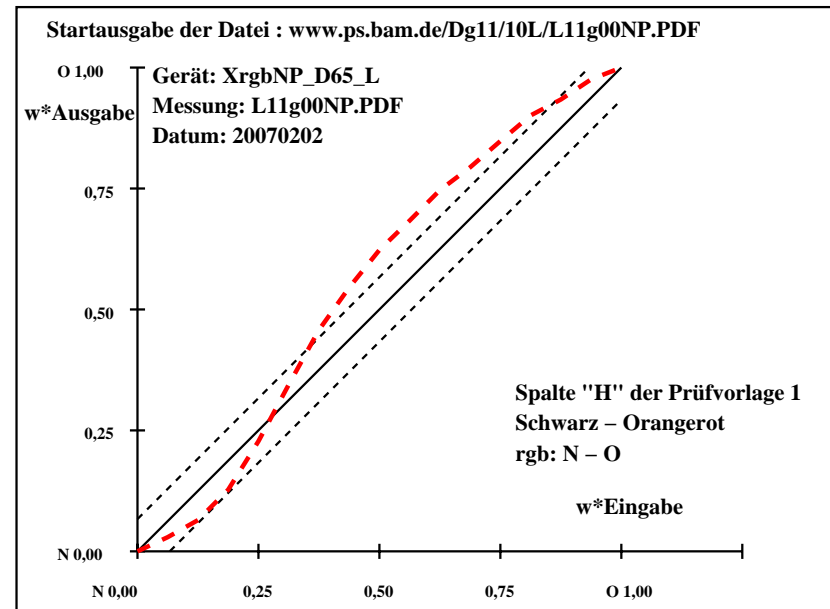


IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1									
N	1	8.5	0.0	0.0	0	8.5	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	13.2	-0.2	6.9	92	13.2	-2.5	6.5	112	0.0	-2.3	-0.3	2.4	2.4				
	3	18.0	-0.4	13.9	92	19.3	-6.1	15.0	112	1.3	-5.6	1.1	5.8	6.0				
	4	22.7	-0.7	20.8	92	25.2	-9.1	23.7	111	2.6	-8.4	2.9	8.9	9.3				
	5	27.4	-0.9	27.7	92	31.5	-11.0	31.9	109	4.1	-10.0	4.2	10.9	11.7				
	6	32.1	-1.2	34.7	92	37.0	-11.8	40.1	107	4.9	-10.6	5.4	12.0	12.9				
	7	36.9	-1.4	41.6	92	42.2	-12.9	47.8	105	5.3	-11.4	6.2	13.1	14.1				
	8	41.6	-1.7	48.5	92	48.4	-14.0	56.5	104	6.9	-12.3	8.0	14.7	16.2				
	9	46.3	-1.9	55.5	92	53.8	-14.5	64.3	103	7.5	-12.5	8.9	15.4	17.1				
	10	51.0	-2.2	62.4	92	59.1	-14.2	72.7	101	8.1	-12.0	10.3	15.9	17.8				
	11	55.7	-2.4	69.3	92	64.6	-12.7	80.6	99	8.9	-10.2	11.3	15.3	17.7				
	12	60.5	-2.7	76.2	92	70.0	-10.3	89.2	97	9.5	-7.6	13.0	15.0	17.8				
	13	65.2	-2.9	83.2	92	75.4	-7.4	97.4	94	10.2	-4.4	14.2	14.9	18.1				
	14	69.9	-3.2	90.1	92	80.0	-5.4	104.5	93	10.1	-2.2	14.4	14.6	17.7				
	15	74.6	-3.4	97.0	92	83.6	-4.4	110.3	92	9.0	-0.9	13.3	13.3	16.1				
	16	79.3	-3.7	104.0	92	83.9	-4.0	110.9	92	4.6	-0.2	6.9	6.9	8.3				
Y	17	84.1	-3.9	110.9	92	84.1	-3.9	110.9	92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
N	18	8.5	0.0	0.0	0	8.5	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	19	27.4	-0.9	27.7	92	31.5	-11.0	31.9	109	4.1	-10.0	4.2	10.9	11.7				
	20	46.3	-1.9	55.5	92	53.8	-14.5	64.3	103	7.5	-12.5	8.9	15.4	17.1				
	21	65.2	-2.9	83.2	92	75.4	-7.4	97.4	94	10.2	-4.4	14.2	14.9	18.1				
Y	22	84.1	-3.9	110.9	92	84.1	-3.9	110.9	92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 48$								


IG470-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1									
N	1	22.0	0.0	0.0	0	22.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	26.3	-1.0	7.0	99	22.2	-0.7	2.4	108	-4.0	0.3	-4.5	4.6	6.1				
	3	30.6	-2.1	14.0	99	26.2	-3.4	11.0	108	-4.3	-1.2	-2.9	3.3	5.5				
	4	34.9	-3.1	20.9	99	32.4	-5.1	22.2	103	-2.4	-1.9	1.3	2.3	3.4				
	5	39.2	-4.2	27.9	99	38.0	-6.9	31.3	103	-1.1	-2.6	3.4	4.3	4.5				
	6	43.5	-5.3	34.9	99	43.4	-8.6	40.5	102	0.0	-3.2	5.6	6.5	6.5				
	7	47.8	-6.4	41.9	99	48.4	-9.6	48.8	101	0.6	-3.1	6.9	7.6	7.7				
	8	52.1	-7.4	48.9	99	53.3	-10.5	55.6	101	1.2	-3.0	6.7	7.4	7.5				
	9	56.4	-8.5	55.9	99	58.7	-11.6	63.9	100	2.3	-3.0	8.1	8.6	8.9				
	10	60.7	-9.6	62.8	99	62.6	-12.3	69.9	100	1.8	-2.6	7.1	7.6	7.8				
	11	65.0	-10.7	69.8	99	66.5	-12.9	75.7	100	1.4	-2.2	5.9	6.3	6.5				
	12	69.3	-11.7	76.8	99	69.6	-14.0	80.1	100	0.2	-2.2	3.3	4.0	4.0				
	13	73.6	-12.8	83.8	99	73.2	-14.2	85.4	100	-0.4	-1.3	1.6	2.1	2.2				
	14	77.9	-13.9	90.8	99	76.2	-14.7	89.6	99	-1.6	-0.7	-1.1	1.4	2.2				
	15	82.3	-15.0	97.7	99	79.0	-15.4	93.5	99	-3.1	-0.3	-4.1	4.3	5.4				
	16	86.6	-16.0	104.7	99	82.7	-15.7	99.2	99	-3.8	0.3	-5.4	5.5	6.8				
Y	17	90.9	-17.1	111.7	99	90.9	-17.1	111.7	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
N	18	22.0	0.0	0.0	0	22.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	19	39.2	-4.2	27.9	99	38.0	-6.9	31.3	103	-1.1	-2.6	3.4	4.3	4.5				
	20	56.4	-8.5	55.9	99	58.7	-11.6	63.9	100	2.3	-3.0	8.1	8.6	8.9				
	21	73.6	-12.8	83.8	99	73.2	-14.2	85.4	100	-0.4	-1.3	1.6	2.1	2.2				
Y	22	90.9	-17.1	111.7	99	90.9	-17.1	111.7	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 79$								

IG471-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

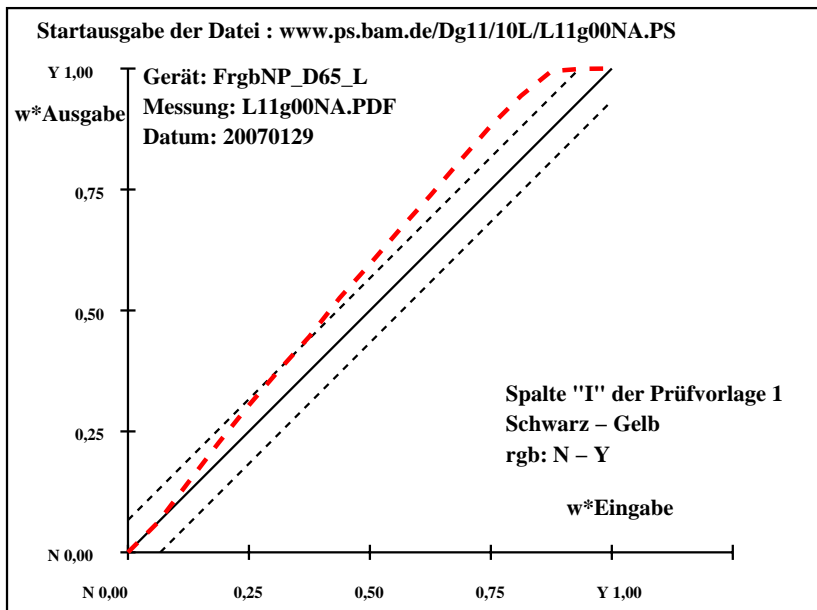

IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

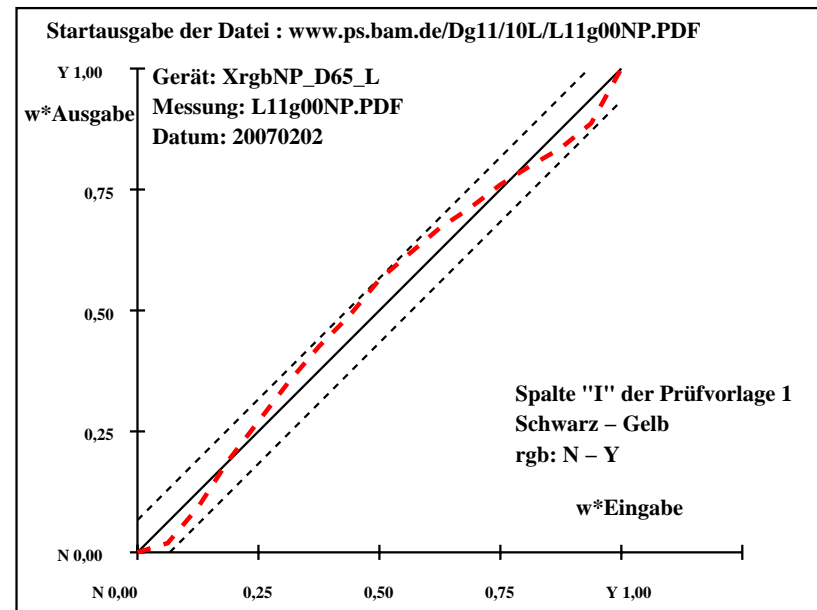


IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1					
N	1	8.5	0.1	0.0	315	8.5	0.1	0.0	315	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	10.7	-3.7	2.9	142	11.7	-6.3	4.0	148	1.0	-2.5	1.1	2.8	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	12.9	-7.5	6.0	142	15.6	-14.5	9.6	147	2.7	-6.9	3.6	7.8	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	15.1	-11.4	9.0	142	19.8	-22.2	15.1	146	4.7	-10.7	6.1	12.4	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	17.3	-15.3	12.1	142	23.5	-29.2	20.1	146	6.2	-13.8	8.0	16.1	$\Delta L^* = 43.7 - 8.49$
	6	19.5	-19.1	15.1	142	26.7	-34.8	24.6	145	7.2	-15.6	9.5	18.3	Gleichmäßigkeit
	7	21.7	-23.0	18.2	142	29.7	-39.9	28.7	144	8.0	-16.8	10.5	19.9	$g^* = 10.4$
	8	23.9	-26.9	21.2	142	33.0	-45.0	33.4	143	9.1	-18.0	12.2	21.8	
	9	26.1	-30.8	24.2	142	35.5	-49.3	37.1	143	9.4	-18.5	12.9	22.6	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	28.3	-34.6	27.3	142	37.7	-52.7	40.1	143	9.4	-18.0	12.8	22.2	$f^* = 45.5$
	11	30.5	-38.5	30.3	142	39.6	-55.6	42.9	142	9.1	-17.0	12.6	21.2	
	12	32.7	-42.4	33.4	142	41.0	-57.7	44.8	142	8.3	-15.2	11.4	19.1	Schwarz – Laubgrün
	13	34.9	-46.2	36.4	142	42.1	-59.5	46.4	142	7.2	-13.2	10.0	16.6	rgb: N – L
	14	37.1	-50.1	39.5	142	43.0	-60.8	47.5	142	5.9	-10.6	8.0	13.4	
	15	39.3	-54.0	42.5	142	43.7	-61.7	48.7	142	4.4	-7.6	6.2	9.9	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	41.5	-57.8	45.6	142	43.7	-61.6	48.8	142	2.2	-3.7	3.2	5.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 13.5$
L	17	43.7	-61.7	48.6	142	43.7	-61.7	48.6	142	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 14.6$
N	18	8.5	0.1	0.0	315	8.5	0.1	0.0	315	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	17.3	-15.3	12.1	142	23.5	-29.2	20.1	146	6.2	-13.8	8.0	16.1	
	20	26.1	-30.8	24.2	142	35.5	-49.3	37.1	143	9.4	-18.5	12.9	22.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	34.9	-46.2	36.4	142	42.1	-59.5	46.4	142	7.2	-13.2	10.0	16.6	$\Delta H^*_{CIELAB} = 11.0$
L	22	43.7	-61.7	48.6	142	43.7	-61.7	48.6	142	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 12.0$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 36$				


IG470-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1					
N	1	21.9	0.0	0.0	0	21.9	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	23.4	-4.1	2.3	152	21.3	-0.8	-0.2	198	-2.0	3.3	-2.5	4.2	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	24.9	-8.3	4.5	152	22.1	-3.4	0.6	170	-2.7	4.9	-3.8	6.3	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	26.4	-12.5	6.8	152	24.8	-8.5	5.3	148	-1.5	4.0	-1.3	4.3	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	27.9	-16.7	9.0	152	28.7	-17.2	12.3	145	0.8	-0.4	3.3	3.3	$\Delta L^* = 46.01 - 21.91$
	6	29.4	-20.9	11.3	152	31.5	-28.3	18.1	147	2.0	-7.3	6.9	10.1	Gleichmäßigkeit
	7	30.9	-25.1	13.5	152	34.6	-37.9	22.3	150	3.6	-12.7	8.8	15.5	$g^* = 27.7$
	8	32.5	-29.3	15.8	152	36.1	-45.1	24.2	152	3.7	-15.7	8.5	17.9	
	9	34.0	-33.5	18.0	152	38.2	-49.8	26.2	152	4.3	-16.2	8.2	18.2	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	35.5	-37.7	20.3	152	40.1	-54.6	28.5	152	4.6	-16.8	8.3	18.8	$f^* = 31.1$
L	11	37.0	-41.9	22.5	152	41.8	-59.0	30.7	153	4.8	-17.0	8.2	19.0	19.6
	12	38.5	-46.1	24.8	152	42.6	-62.8	31.8	153	4.1	-16.6	7.0	18.1	18.6
	13	40.0	-50.3	27.0	152	43.4	-64.9	32.9	153	3.4	-14.5	5.9	15.7	16.1
	14	41.5	-54.5	29.3	152	44.0	-66.5	33.1	154	2.5	-11.9	3.8	12.6	12.8
	15	43.0	-58.7	31.5	152	44.3	-67.0	33.8	153	1.3	-8.2	2.3	8.6	8.7
	16	44.5	-62.9	33.8	152	45.1	-67.1	34.4	153	0.6	-4.1	0.7	4.3	4.3
	17	46.0	-67.1	36.0	152	46.0	-67.1	36.0	152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	21.9	0.0	0.0	0	21.9	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	27.9	-16.7	9.0	152	28.7	-17.2	12.3	145	0.8	-0.4	3.3	3.3	3.4
	20	34.0	-33.5	18.0	152	38.2	-49.8	26.2	152	4.3	-16.2	8.2	18.2	18.7
L	21	40.0	-50.3	27.0	152	43.4	-64.9	32.9	153	3.4	-14.5	5.9	15.7	16.1
	22	46.0	-67.1	36.0	152	46.0	-67.1	36.0	152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:									$R^*_{ab,m} = 54$					

IG471-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

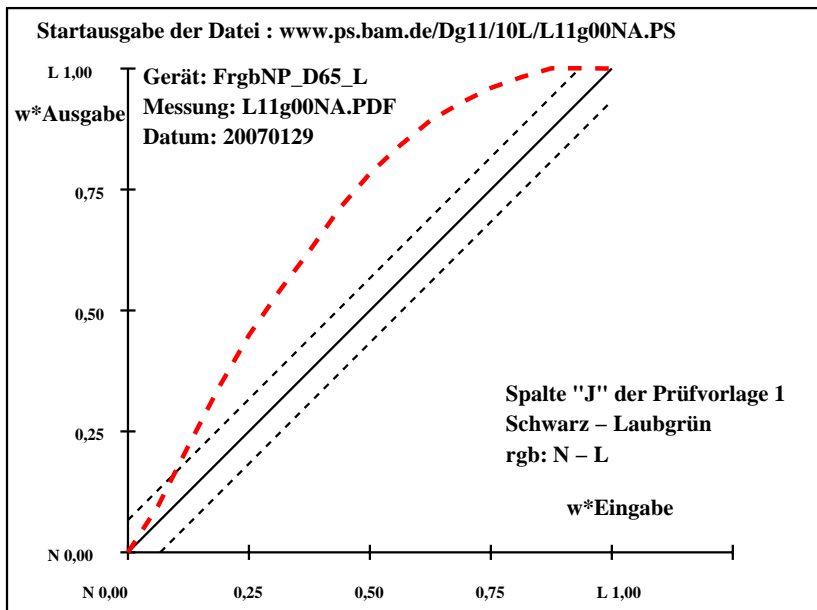

IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

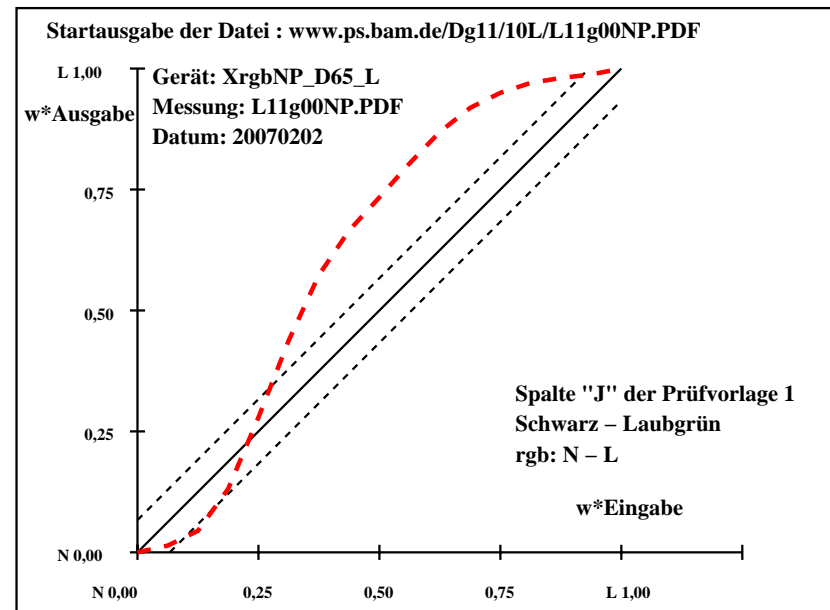

IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1	
N	1	8.8	0.1	0.0	315	8.8	0.1	0.0	315	0.0
	2	11.6	-1.6	-2.0	230	12.3	-2.8	-4.2	236	0.7
	3	14.4	-3.4	-4.0	229	17.2	-7.3	-7.4	225	2.8
	4	17.2	-5.3	-5.9	228	21.8	-12.4	-8.6	215	4.6
	5	20.0	-7.1	-7.9	228	26.6	-15.9	-10.8	214	6.5
	6	22.8	-8.9	-9.9	228	30.0	-20.0	-11.4	210	7.2
	7	25.6	-10.7	-11.9	228	33.5	-22.9	-12.8	209	7.9
	8	28.4	-12.5	-13.9	228	37.3	-26.2	-14.1	208	8.9
	9	31.2	-14.4	-15.9	228	40.5	-28.1	-16.2	210	9.3
	10	34.0	-16.2	-17.8	228	43.4	-29.2	-18.7	213	9.4
	11	36.8	-18.0	-19.8	228	46.1	-29.5	-21.7	216	9.3
	12	39.6	-19.8	-21.8	228	48.4	-29.5	-24.5	220	8.8
	13	42.4	-21.6	-23.8	228	50.4	-29.4	-27.3	223	8.0
	14	45.2	-23.4	-25.8	228	52.1	-29.6	-29.1	225	6.9
	15	48.0	-25.3	-27.7	228	53.4	-29.8	-30.6	226	5.5
	16	50.8	-27.1	-29.7	228	53.7	-29.0	-31.6	227	3.0
C	17	53.6	-28.9	-31.7	228	53.6	-28.9	-31.7	228	0.0
N	18	8.8	0.1	0.0	315	8.8	0.1	0.0	315	0.0
	19	20.0	-7.1	-7.9	228	26.6	-15.9	-10.8	214	6.5
	20	31.2	-14.4	-15.9	228	40.5	-28.1	-16.2	210	9.3
	21	42.4	-21.6	-23.8	228	50.4	-29.4	-27.3	223	8.0
C	22	53.6	-28.9	-31.7	228	53.6	-28.9	-31.7	228	0.0


Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 53.56 - 8.82$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 18.1$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 57.8$
Schwarz – Cyanblau
rgb: N – C
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 7.9$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 9.8$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 6.3$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 7.9$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 57$

IG470-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1	
N	1	20.7	0.0	-0.2	252	20.7	0.0	-0.2	252	0.0
	2	22.5	-0.9	-3.5	254	20.3	-1.1	-4.3	255	-2.2
	3	24.4	-1.9	-6.8	254	20.6	-1.8	-7.7	256	-3.8
	4	26.3	-2.8	-10.1	254	22.7	-3.8	-12.9	253	-3.5
	5	28.2	-3.8	-13.4	254	26.0	-6.8	-16.3	247	-2.1
	6	30.1	-4.7	-16.7	254	27.8	-10.9	-18.1	239	-2.2
	7	32.0	-5.6	-20.0	254	30.1	-15.0	-19.1	232	-1.8
	8	33.9	-6.6	-23.3	254	32.7	-17.1	-22.4	233	-1.1
	9	35.8	-7.5	-26.6	254	36.5	-19.8	-26.1	233	0.7
	10	37.6	-8.4	-29.8	254	39.6	-21.8	-29.3	233	2.0
	11	39.5	-9.4	-33.1	254	42.6	-22.9	-33.0	235	3.1
	12	41.4	-10.3	-36.4	254	45.4	-24.4	-35.7	236	4.0
	13	43.3	-11.3	-39.7	254	46.9	-24.6	-38.5	237	3.5
	14	45.2	-12.2	-43.0	254	48.3	-24.7	-40.3	238	3.1
	15	47.1	-13.1	-46.3	254	48.3	-23.6	-41.4	240	1.2
	16	49.0	-14.1	-49.6	254	49.3	-22.8	-43.3	242	0.4
C	17	50.9	-15.0	-52.9	254	50.9	-15.0	-52.9	254	0.0
N	18	20.7	0.0	-0.2	252	20.7	0.0	-0.2	252	0.0
	19	28.2	-3.8	-13.4	254	26.0	-6.8	-16.3	247	-2.1
	20	35.8	-7.5	-26.6	254	36.5	-19.8	-26.1	233	0.7
	21	43.3	-11.3	-39.7	254	46.9	-24.6	-38.5	237	3.5
C	22	50.9	-15.0	-52.9	254	50.9	-15.0	-52.9	254	0.0

Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 50.86 - 20.66$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 38.2$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 39.0$
Schwarz – Cyanblau
rgb: N – C
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 8.1$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 8.6$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 6.0$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.2$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 63$

IG471-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

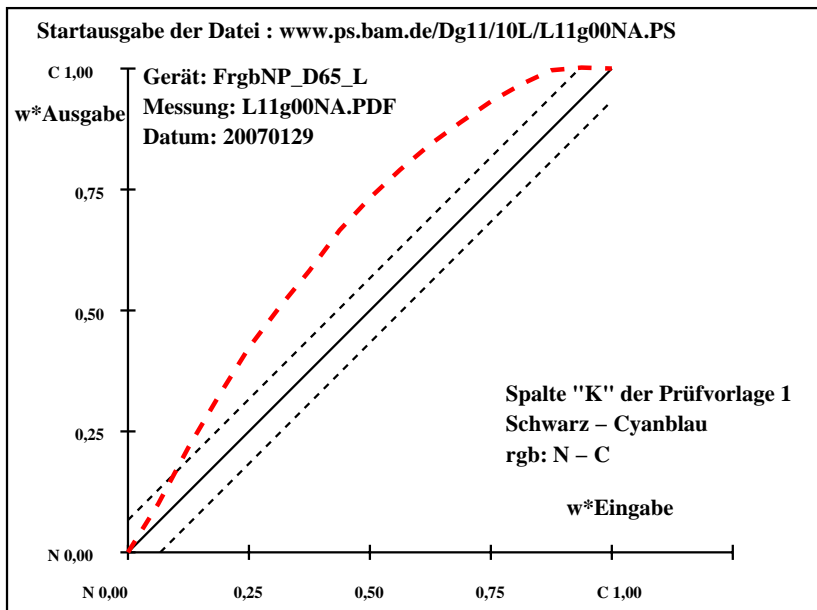

IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

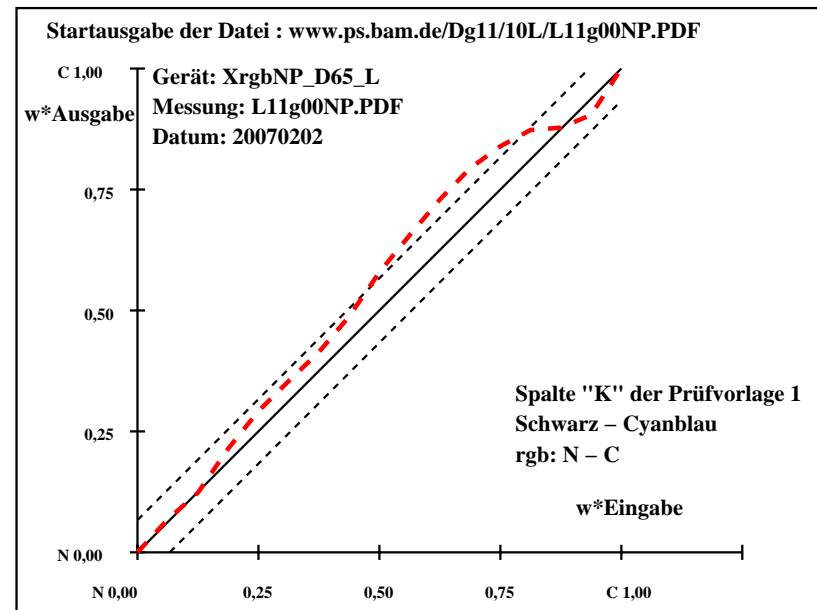


IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1					
N	1	8.7	0.1	0.0	0	8.7	0.1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	9.1	3.4	-3.7	312	8.9	4.7	-8.5	299	-0.1	1.3	-4.7	5.0	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	9.4	6.7	-7.5	311	9.4	10.2	-16.7	301	0.0	3.5	-9.1	9.9	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	9.7	10.0	-11.3	311	9.7	14.6	-22.3	303	0.0	4.6	-10.9	11.9	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	10.0	13.3	-15.1	311	10.9	19.0	-27.6	304	0.9	5.7	-12.4	13.8	$\Delta L^* = 13.88 - 8.73$
	6	10.3	16.6	-18.9	311	10.5	23.1	-32.2	306	0.2	6.5	-13.2	14.8	Gleichmäßigkeit
	7	10.7	19.9	-22.7	311	11.0	27.0	-36.3	307	0.3	7.1	-13.5	15.4	$g^* = 4.6$
	8	11.0	23.2	-26.5	311	11.4	31.2	-40.5	308	0.4	8.0	-13.9	16.2	
	9	11.3	26.5	-30.3	311	12.0	34.9	-44.1	308	0.7	8.4	-13.8	16.2	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	11.6	29.8	-34.0	311	12.3	39.2	-48.1	309	0.6	9.4	-14.0	16.9	$f^* = 6.7$
	11	11.9	33.1	-37.8	311	12.8	43.0	-51.8	310	0.9	9.9	-13.9	17.1	
	12	12.3	36.4	-41.6	311	13.3	46.1	-54.7	310	1.0	9.7	-13.0	16.3	Schwarz – Violetblau
V	13	12.6	39.7	-45.4	311	13.8	48.1	-56.5	310	1.2	8.4	-11.0	13.9	rgb: N – V
	14	12.9	43.0	-49.2	311	14.0	50.1	-58.3	311	1.1	7.1	-9.0	11.5	
	15	13.2	46.3	-53.0	311	13.9	51.9	-59.9	311	0.7	5.6	-6.8	8.9	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	13.6	49.6	-56.8	311	13.9	52.7	-60.5	311	0.4	3.1	-3.6	4.8	$\Delta H^*_{CIELAB} = 11.3$
	17	13.9	52.9	-60.6	311	13.9	52.9	-60.6	311	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 11.3$
	18	8.7	0.1	0.0	0	8.7	0.1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	10.0	13.3	-15.1	311	10.9	19.0	-27.6	304	0.9	5.7	-12.4	13.8	
	20	11.3	26.5	-30.3	311	12.0	34.9	-44.1	308	0.7	8.4	-13.8	16.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	12.6	39.7	-45.4	311	13.8	48.1	-56.5	310	1.2	8.4	-11.0	13.9	$\Delta H^*_{CIELAB} = 8.8$
	22	13.9	52.9	-60.6	311	13.9	52.9	-60.6	311	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 8.8$
	Mittlerer Farbwiedergabe-Index:									$R^*_{ab,m} = 50$				

IG470-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg11/10L/L11g00NA.PS

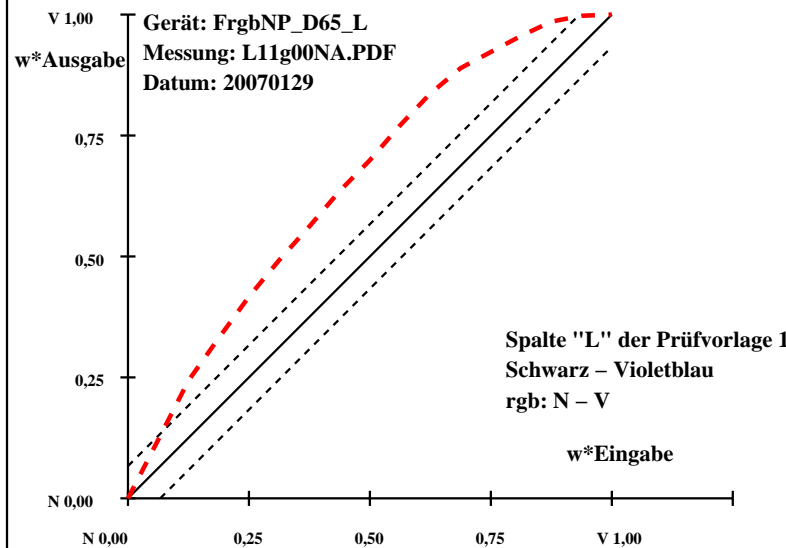


IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

TUB-Prüfvorlage IG47 für Ausgabe-Kennzeichnung
17-stufige Farbreihe "L"; rgb-Eingabedaten; 2 Geräte, Seite 12/24

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1							
N	1	20.4	0.0	-0.2	252	20.4	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	21.5	0.0	-3.3	270	19.5	-0.4	-4.6	264	-1.9	-0.4	-1.2	1.4	2.5	2.5	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	22.7	0.1	-6.3	271	19.3	-0.4	-7.8	266	-3.3	-0.5	-1.4	1.6	3.8	3.8	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	23.8	0.1	-9.4	271	20.1	-0.8	-11.7	266	-3.6	-0.9	-2.2	2.5	4.5	4.5	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	25.0	0.2	-12.5	271	22.1	-1.1	-17.3	266	-2.8	-1.3	-4.7	5.1	5.8	5.8	$\Delta L^* = 38.83 - 20.35$
	6	26.1	0.3	-15.5	271	24.3	-0.7	-22.8	268	-1.7	-1.0	-7.2	7.4	7.6	7.6	Gleichmäßigkeit
	7	27.3	0.4	-18.6	271	25.7	0.2	-26.8	270	-1.5	-0.1	-8.1	8.2	8.4	8.4	$g^* = 28.9$
	8	28.4	0.5	-21.6	271	27.0	0.9	-29.9	272	-1.4	0.4	-8.2	8.3	8.4	8.4	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	9	29.6	0.6	-24.7	271	27.9	1.8	-33.0	273	-1.5	1.3	-8.2	8.4	8.6	8.6	$f^* = 23.9$
	10	30.7	0.6	-27.8	271	29.2	2.7	-35.9	274	-1.5	2.1	-8.0	8.4	8.5	8.5	Schwarz – Violetblau
	11	31.9	0.7	-30.8	271	31.0	3.8	-39.7	275	-0.8	3.1	-8.8	9.4	9.4	9.4	rgb: N – V
	12	33.1	0.8	-33.9	271	32.7	4.4	-42.9	276	-0.3	3.6	-8.9	9.7	9.7	9.7	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	13	34.2	0.9	-37.0	271	33.8	5.2	-45.4	277	-0.3	4.3	-8.4	9.5	9.5	9.5	$\Delta H^*_{CIELAB} = 5.8$
	14	35.4	1.0	-40.0	271	35.0	5.3	-47.3	276	-0.3	4.3	-7.2	8.5	8.5	8.5	$\Delta E^*_{CIELAB} = 6.2$
	15	36.5	1.0	-43.1	271	36.6	4.2	-48.9	275	0.1	3.2	-5.7	6.6	6.6	6.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	16	37.7	1.1	-46.1	271	37.2	3.3	-49.1	274	-0.4	2.2	-2.9	3.7	3.7	3.7	$\Delta H^*_{CIELAB} = 4.6$
V	17	38.8	1.2	-49.2	271	38.8	1.2	-49.2	271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 4.8$
N	18	20.4	0.0	-0.2	252	20.4	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	19	25.0	0.2	-12.5	271	22.1	-1.1	-17.3	266	-2.8	-1.3	-4.7	5.1	5.8	5.8	
	20	29.6	0.6	-24.7	271	27.9	1.8	-33.0	273	-1.5	1.3	-8.2	8.4	8.6	8.6	
	21	34.2	0.9	-37.0	271	33.8	5.2	-45.4	277	-0.3	4.3	-8.4	9.5	9.5	9.5	
V	22	38.8	1.2	-49.2	271	38.8	1.2	-49.2	271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:									$R^*_{ab,m} = 73$							

IG471-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg11/10L/L11g00NP.PDF

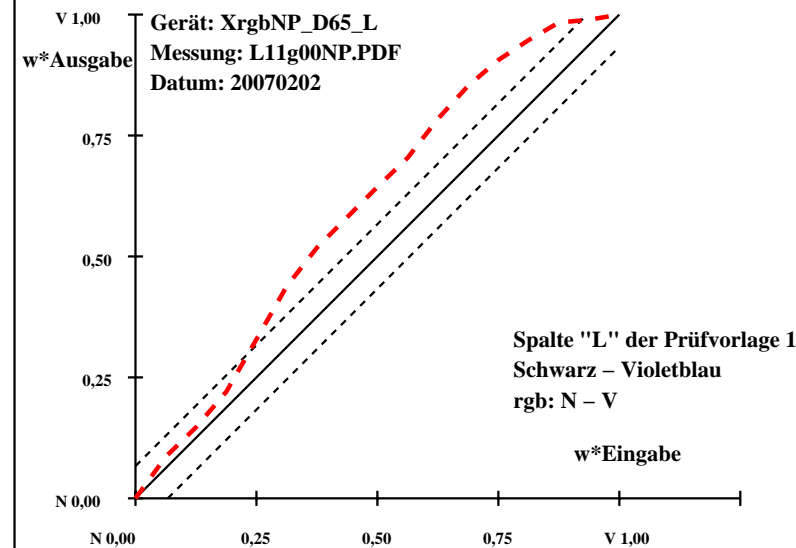

IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202


Eingabe: rgb (->ol*) setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
N	1	8.9	0.0	0.2	90	8.9	0.0	0.2	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	10.7	5.0	-1.9	338	10.6	8.1	-6.4	321	0.0	3.1	-4.4	5.5	5.5	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	12.6	10.0	-4.1	337	12.8	16.4	-12.6	322	0.2	6.4	-8.4	10.7	10.7	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	14.4	14.9	-6.2	337	15.1	23.4	-16.7	324	0.7	8.5	-10.4	13.5	13.5	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	16.2	19.9	-8.4	337	17.6	30.4	-20.9	325	1.4	10.5	-12.4	16.3	16.4	$\Delta L^* = 38.24 - 8.91$
	6	18.1	24.9	-10.6	337	19.6	36.3	-23.0	328	1.5	11.4	-12.3	16.9	16.9	Gleichmäßigkeit
	7	19.9	29.9	-12.8	337	21.6	41.9	-25.9	328	1.6	12.0	-13.1	17.8	17.9	$g^* = 29.3$
	8	21.7	34.9	-14.9	337	23.8	47.6	-28.4	329	2.1	12.7	-13.4	18.5	18.7	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	9	23.6	39.9	-17.1	337	25.9	52.8	-30.6	330	2.4	13.0	-13.4	18.7	18.9	$f^* = 37.9$
	10	25.4	44.8	-19.3	337	28.2	58.5	-33.0	330	2.8	13.7	-13.6	19.4	19.6	Schwarz – Magentarot
	11	27.2	49.8	-21.5	337	30.5	63.6	-34.3	332	3.3	13.8	-12.8	18.8	19.1	rgb: N – M
	12	29.1	54.8	-23.6	337	33.0	68.5	-35.1	333	3.9	13.7	-11.4	17.9	18.3	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	13	30.9	59.8	-25.8	337	35.5	72.8	-34.8	334	4.5	13.0	-8.9	15.8	16.5	$\Delta H^*_{CIELAB} = 12.8$
	14	32.7	64.8	-28.0	337	37.0	76.4	-34.6	336	4.2	11.6	-6.5	13.4	14.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 13.1$
	15	34.6	69.7	-30.1	337	38.2	78.7	-34.3	336	3.6	9.0	-4.1	9.9	10.5	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	36.4	74.7	-32.3	337	38.3	79.5	-34.6	336	1.9	4.8	-2.2	5.3	5.6	$\Delta H^*_{CIELAB} = 12.8$
M	17	38.2	79.7	-34.5	337	38.2	79.7	-34.5	337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 13.1$
N	18	8.9	0.0	0.2	90	8.9	0.0	0.2	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	16.2	19.9	-8.4	337	17.6	30.4	-20.9	325	1.4	10.5	-12.4	16.3	16.4	
	20	23.6	39.9	-17.1	337	25.9	52.8	-30.6	330	2.4	13.0	-13.4	18.7	18.9	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	30.9	59.8	-25.8	337	35.5	72.8	-34.8	334	4.5	13.0	-8.9	15.8	16.5	$\Delta H^*_{CIELAB} = 10.2$
M	22	38.2	79.7	-34.5	337	38.2	79.7	-34.5	337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 10.3$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 43$					


IG470–3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out/c-ref		ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1			
N	1	20.8	0.0	-0.2	252	20.8	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	22.3	4.4	-0.6	351	19.5	2.0	-4.1	295	-2.8	-2.3	-3.4	4.2	5.1	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	23.9	8.8	-1.0	353	19.9	6.6	-5.9	318	-3.9	-2.1	-4.9	5.4	6.8	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	25.5	13.3	-1.3	354	21.8	15.4	-10.0	327	-3.6	2.1	-8.6	8.9	9.7	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	27.1	17.8	-1.7	354	23.7	22.3	-13.6	328	-3.3	4.5	-11.8	12.7	13.2	$\Delta L^* = 46.19 - 20.76$
	6	28.7	22.2	-2.1	354	25.2	28.4	-16.7	329	-3.4	6.2	-14.5	15.9	16.3	Gleichmäßigkeit
	7	30.3	26.7	-2.5	355	27.0	32.9	-18.2	331	-3.2	6.2	-15.6	16.9	17.3	$g^* = 34.3$
	8	31.9	31.1	-2.8	355	29.2	37.5	-19.3	333	-2.6	6.4	-16.4	17.7	17.9	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	9	33.5	35.6	-3.2	355	30.7	41.7	-19.2	335	-2.6	6.1	-15.9	17.1	17.3	
	10	35.1	40.1	-3.6	355	32.6	45.5	-18.5	338	-2.3	5.4	-14.8	15.9	16.1	
	11	36.7	44.5	-4.0	355	34.8	49.9	-16.7	341	-1.7	5.4	-12.6	13.8	14.0	Schwarz – Magentarot rgb: N – M
	12	38.2	49.0	-4.3	355	37.1	54.5	-15.7	344	-1.1	5.5	-11.3	12.6	12.7	
	13	39.8	53.5	-4.7	355	39.3	58.9	-12.8	348	-0.4	5.4	-8.0	9.8	9.8	
	14	41.4	57.9	-5.1	355	41.7	63.0	-11.6	349	0.3	5.1	-6.4	8.3	8.3	
	15	43.0	62.4	-5.5	355	43.6	66.7	-10.1	351	0.6	4.3	-4.5	6.4	6.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	44.6	66.8	-5.8	355	44.4	68.1	-9.1	352	-0.1	1.3	-3.2	3.5	3.5	$\Delta H^*_{CIELAB} = 10.0$
M	17	46.2	71.3	-6.2	355	46.2	71.3	-6.2	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 10.2$
N	18	20.8	0.0	-0.2	252	20.8	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	19	27.1	17.8	-1.7	354	23.7	22.3	-13.6	328	-3.3	4.5	-11.8	12.7	13.2	
	20	33.5	35.6	-3.2	355	30.7	41.7	-19.2	335	-2.6	6.1	-15.9	17.1	17.3	
M	21	39.8	53.5	-4.7	355	39.3	58.9	-12.8	348	-0.4	5.4	-8.0	9.8	9.8	$\Delta H^*_{CIELAB} = 7.9$
	22	46.2	71.3	-6.2	355	46.2	71.3	-6.2	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 8.1$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:												$R^*_{ab,m} = 55$			

IG471–3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

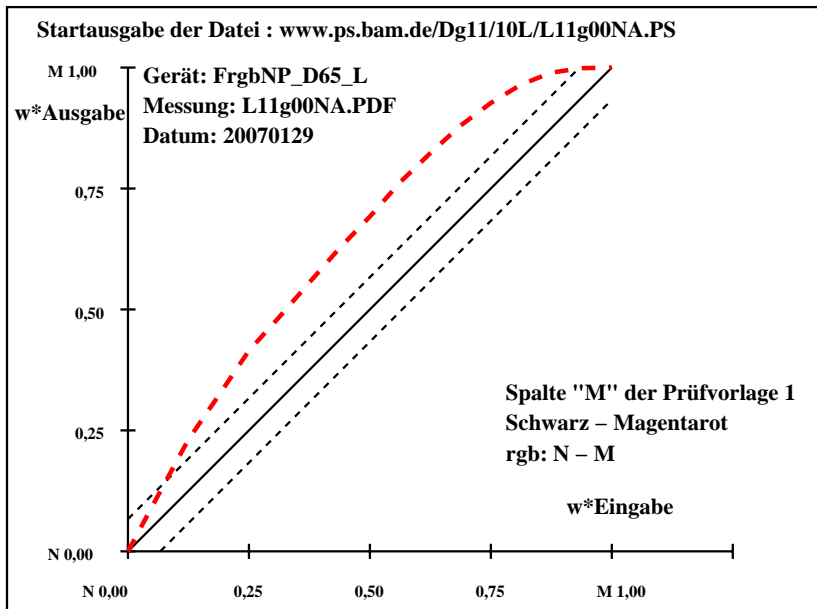


IG470–7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

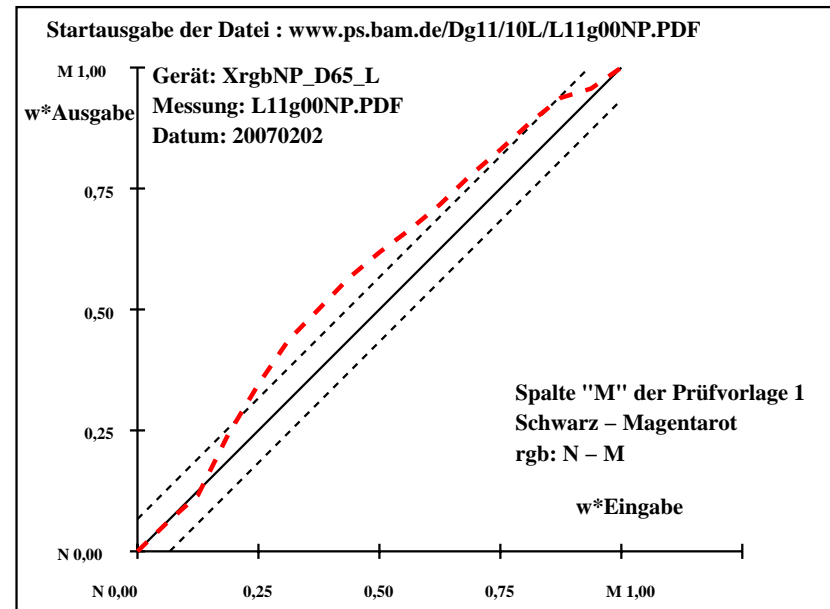

IG471–7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a _{ref}		hab.ref	LAB*a _{out}		hab.out	LAB*a _{out} /c-refΔH* ΔE*				Start-Ausgabe S1			
N	1	9.1	0.0	0.2	90	9.1	0.0	0.2	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	14.4	0.0	0.2	90	14.6	0.3	-1.7	279	0.2	0.3	-1.9	2.0	2.0	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	19.6	0.0	0.2	90	21.7	-0.4	-2.7	260	2.1	-0.4	-2.9	3.0	3.7	und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	24.8	0.0	0.2	90	28.4	-1.8	-1.9	226	3.6	-1.8	-2.1	2.9	4.6	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	30.0	0.0	0.2	90	35.5	-2.1	-2.3	227	5.5	-2.1	-2.5	3.4	6.4	ΔL* = 92.81 – 9.12
	6	35.3	0.0	0.1	90	41.3	-2.6	-0.4	190	6.1	-2.6	-0.5	2.8	6.7	Gleichmäßigkeit
	7	40.5	0.0	0.1	90	46.8	-2.6	-0.7	197	6.3	-2.6	-0.8	2.9	6.9	g* = 42.5
	8	45.7	0.0	0.1	90	52.9	-3.7	-0.2	185	7.2	-3.7	-0.3	3.8	8.1	
Z	9	51.0	0.0	0.1	90	58.3	-3.7	-0.8	193	7.3	-3.7	-0.9	3.9	8.3	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	56.2	0.0	0.1	90	63.8	-3.2	-1.2	202	7.6	-3.2	-1.3	3.6	8.4	J* = 108.1
	11	61.4	0.0	0.1	90	69.8	-1.8	-1.5	220	8.4	-1.8	-1.6	2.5	8.7	
	12	66.7	0.0	0.1	90	75.6	-0.8	-1.6	242	9.0	-0.8	-1.7	2.0	9.2	Schwarz – Weiß
	13	71.9	0.0	0.1	90	81.6	0.0	-1.1	270	9.7	0.0	-1.2	1.3	9.8	w: N – W
	14	77.1	0.0	0.0	90	87.1	0.0	0.0	270	10.0	0.0	0.0	0.1	10.0	
	15	82.3	0.0	0.0	90	92.1	-0.6	1.1	122	9.8	-0.6	1.1	1.3	9.8	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	87.6	0.0	0.0	90	92.9	0.0	0.0	0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	ΔH* _{CIELAB} = 2.1
W	17	92.8	0.0	0.0	0	92.8	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE* _{CIELAB} = 6.3
	18	9.1	0.0	0.2	90	9.1	0.0	0.2	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
N	19	30.0	0.0	0.2	90	35.5	-2.1	-2.3	227	5.5	-2.1	-2.5	3.4	6.4	
	20	51.0	0.0	0.1	90	58.3	-3.7	-0.8	193	7.3	-3.7	-0.9	3.9	8.3	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
Z	21	71.9	0.0	0.1	90	81.6	0.0	-1.1	270	9.7	0.0	-1.2	1.3	9.8	ΔH* _{CIELAB} = 1.7
	22	92.8	0.0	0.0	0	92.8	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE* _{CIELAB} = 4.9
W	22	92.8	0.0	0.0	0	92.8	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: R* _{ab,m} = 72															

IG470-3N, Gerät: FröbNP D65 L: Messung: L1lg00NA.PDF: Datum: 20070129

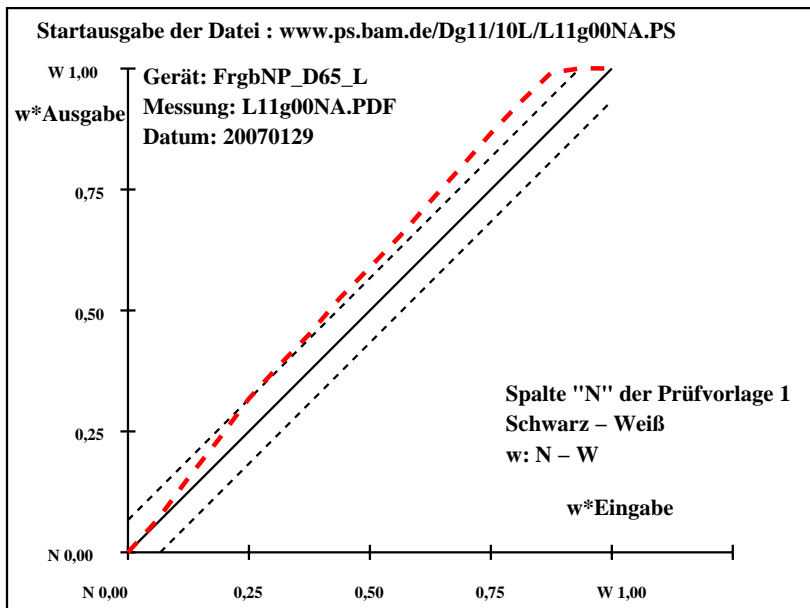


IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

TUB-Prüfvorlage IG47 für Ausgabe-Kennzeichnung
17-stufige Farbreihe "N"; *rgb*-Eingabedaten; 2 Gerät

T	i	LAB*a,ref		hab,ref		LAB*a,out		hab,out		LAB*a,out/c-ref				ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1
N	1	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0	-0.1	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	25.9	0.0	-0.1	242	24.0	0.0	0.0	270	-1.8	0.1	0.1	0.1	1.9		ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
	3	30.6	0.0	-0.1	240	26.6	0.0	0.0	0	-3.9	0.1	0.2	0.2	4.0		und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	4	35.2	0.0	-0.1	238	32.1	0.0	0.0	0	-3.0	0.1	0.2	0.2	3.1		relative CIELAB Daten für "aus"
	5	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0	0.1	90	-3.0	0.1	0.3	0.3	3.1		$\Delta L^* = 95.51 - 21.27$
	6	44.5	0.0	0.0	234	42.6	0.0	0.0	270	-1.8	0.1	0.0	0.1	1.9		Gleichmäßigkeit
	7	49.1	0.0	0.0	231	47.2	0.0	0.0	0	-1.8	0.1	0.1	0.2	1.9		$g^* = 77.3$
	8	53.8	0.0	0.0	228	51.9	0.0	0.1	90	-1.8	0.1	0.2	0.2	1.9		
Z	9	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0	0.3	108	-1.5	0.0	0.4	0.4	1.6		Helligkeitssumfang relativ zu Offset
	10	63.0	0.0	0.0	221	63.2	0.0	0.0	180	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2		$f^* = 95.9$
	11	67.7	0.0	0.0	217	67.4	0.0	0.0	0	-0.2	0.1	0.1	0.1	0.3		
	12	72.3	0.0	0.0	212	71.7	0.0	0.3	90	-0.5	0.1	0.4	0.4	0.7		Schwarz – Weiß
	13	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0	0.1	90	-0.9	0.1	0.2	0.2	1.0		w: N – W
	14	81.6	0.0	0.0	201	81.1	0.0	0.1	90	-0.4	0.1	0.1	0.2	0.5		
	15	86.2	0.0	0.0	194	85.1	0.0	0.1	90	-1.0	0.1	0.1	0.2	1.2		Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	90.9	0.0	0.0	187	89.1	0.0	0.0	0	-1.7	0.1	0.0	0.1	1.8		$\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
W	17	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		$\Delta E^*_{CIELAB} = 1.5$
N	18	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0	-0.1	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	19	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0	0.1	90	-3.0	0.1	0.3	0.3	3.1		
Z	20	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0	0.3	108	-1.5	0.0	0.4	0.4	1.6		Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0	0.1	90	-0.9	0.1	0.2	0.2	1.0		$\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
W	22	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		$\Delta E^*_{CIELAB} = 1.1$
																Mittlerer Farbwiedergabe-Index:
																$R^*_{ab,m} = 94$

IG471-3N, Gerät: XrgbNP D65 L: Messung: L11g00NP.PDF: Datum: 20070202

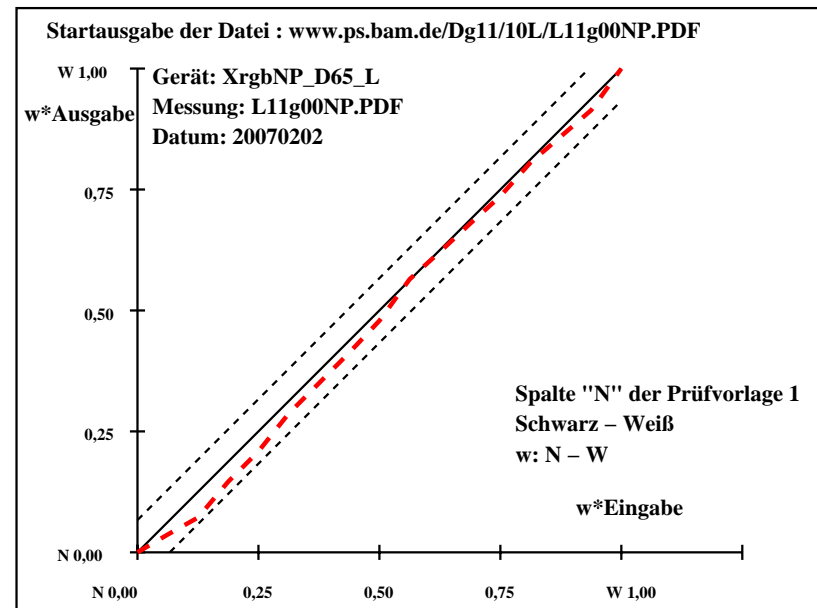

IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65 L; Messung: L1lg00NP.PDF; Datum: 20070202


Eingabe: *rgb* (->*olv**) *setrgbcolor*
4 Ausgabe: keine Eingabeänderung

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1							
O	1	36.2	60.8	44.5	36	36.2	60.8	44.5	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach	
	2	39.0	52.7	38.9	36	40.5	57.8	37.0	33	1.6	5.1	-1.8	5.5	5.7	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G	
	3	41.7	44.6	33.3	37	45.2	52.5	29.8	30	3.5	7.9	-3.4	8.7	9.3	und DIN 33866-1:2000 Anhang G	
	4	44.4	36.5	27.7	37	48.6	44.3	24.8	29	4.2	7.8	-2.8	8.4	9.3		
	5	47.2	28.4	22.1	38	51.3	34.4	17.9	27	4.1	6.1	-4.1	7.4	8.4		
	6	49.9	20.2	16.5	39	52.7	24.0	13.8	30	2.7	3.8	-2.6	4.6	5.4	Gleichmäßigkeit	
	7	52.7	12.1	10.9	42	54.1	14.1	8.2	30	1.4	2.0	-2.6	3.3	3.6	$g^* = 36.1$	
	8	55.4	4.0	5.3	53	56.4	4.0	4.0	45	1.0	0.0	-1.2	1.3	1.6		
Z	9	58.2	-4.0	-0.2	184	58.2	-4.0	-0.2	184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	10	57.6	-7.1	-4.1	210	60.1	-10.4	-5.2	207	2.5	-3.2	-1.0	3.4	4.3		
	11	57.1	-10.3	-8.1	218	61.7	-15.9	-10.1	213	4.6	-5.5	-1.9	6.0	7.6		
	12	56.6	-13.4	-12.0	222	63.1	-20.3	-14.9	216	6.5	-6.8	-2.8	7.5	10.0	Orangerot – Cyanblau	
	13	56.0	-16.5	-15.9	224	63.6	-24.4	-19.3	218	7.6	-7.8	-3.3	8.6	11.4	rgb: O – Z – C	
	14	55.5	-19.6	-19.8	225	63.1	-27.7	-23.3	220	7.6	-8.0	-3.4	8.8	11.6		
	15	55.0	-22.8	-23.8	226	61.6	-29.8	-26.8	222	6.6	-6.9	-2.9	7.7	10.1	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)	
	16	54.5	-25.9	-27.7	227	58.1	-29.5	-29.7	225	3.6	-3.5	-1.9	4.2	5.5	$\Delta H^*_{CIELAB} = 5.0$	
C	17	53.9	-29.0	-31.6	227	53.9	-29.0	-31.6	227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 6.1$	
O	18	36.2	60.8	44.5	36	36.2	60.8	44.5	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	19	47.2	28.4	22.1	38	51.3	34.4	17.9	27	4.1	6.1	-4.1	7.4	8.4		
Z	20	58.2	-4.0	-0.2	184	58.2	-4.0	-0.2	184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)	
	21	56.0	-16.5	-15.9	224	63.6	-24.4	-19.3	218	7.6	-7.8	-3.3	8.6	11.4	$\Delta H^*_{CIELAB} = 3.2$	
C	22	53.9	-29.0	-31.6	227	53.9	-29.0	-31.6	227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 4.0$	


IG470-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out/c-ref				ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1		
O	1	46.3	60.2	39.9	34	46.3	60.2	39.9	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach	
	2	47.8	52.7	34.9	34	45.8	58.4	36.2	32	-1.9	5.7	1.3	5.9	6.2	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G	
	3	49.3	45.2	30.0	34	44.3	55.0	31.1	29	-5.0	9.8	1.1	9.9	11.1	und DIN 33866-1:2000 Anhang G	
	4	50.8	37.6	25.0	34	43.6	50.4	23.8	25	-7.2	12.8	-1.1	12.8	14.7		
	5	52.3	30.1	20.0	34	44.6	43.7	18.6	23	-7.6	13.6	-1.3	13.7	15.7		
	6	53.8	22.6	15.0	34	46.1	32.9	13.8	23	-7.6	10.3	-1.1	10.4	13.0	Gleichmäßigkeit	
	7	55.3	15.1	10.0	34	49.6	19.9	9.5	26	-5.6	4.9	-0.4	4.9	7.5	$g^* = 12.5$	
	8	56.8	7.5	5.1	34	55.4	7.8	2.8	20	-1.3	0.3	-2.2	2.3	2.7		
Z	9	58.4	0.0	0.1	90	58.4	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	10	57.3	-1.7	-6.5	255	57.3	-8.2	-8.0	224	0.1	-6.4	-1.4	6.7	6.7		
	11	56.2	-3.4	-13.2	255	50.7	-15.3	-17.9	229	-5.4	-11.8	-4.6	12.8	13.9		
	12	55.1	-5.2	-19.9	255	47.3	-19.9	-26.5	233	-7.7	-14.6	-6.5	16.1	17.9	Orangerot – Cyanblau	
	13	54.0	-7.0	-26.6	255	46.5	-22.0	-35.0	238	-7.4	-15.0	-8.3	17.2	18.8	rgb: O – Z – C	
	14	52.9	-8.7	-33.3	255	48.0	-23.4	-40.1	240	-4.8	-14.6	-6.7	16.2	16.9		
	15	51.8	-10.5	-40.0	255	47.4	-20.5	-43.4	245	-4.4	-9.9	-3.3	10.6	11.5	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)	
	16	50.7	-12.2	-46.7	255	47.9	-20.1	-45.0	246	-2.7	-7.8	1.7	8.0	8.5	$\Delta H^*_{CIELAB} = 8.7$	
C	17	49.6	-14.0	-53.4	255	49.6	-14.0	-53.4	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 9.7$	
O	18	46.3	60.2	39.9	34	46.3	60.2	39.9	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	19	52.3	30.1	20.0	34	44.6	43.7	18.6	23	-7.6	13.6	-1.3	13.7	15.7		
Z	20	58.4	0.0	0.1	90	58.4	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)	
C	21	54.0	-7.0	-26.6	255	46.5	-22.0	-35.0	238	-7.4	-15.0	-8.3	17.2	18.8	$\Delta H^*_{CIELAB} = 6.2$	
	22	49.6	-14.0	-53.4	255	49.6	-14.0	-53.4	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 6.9$	

IG471-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

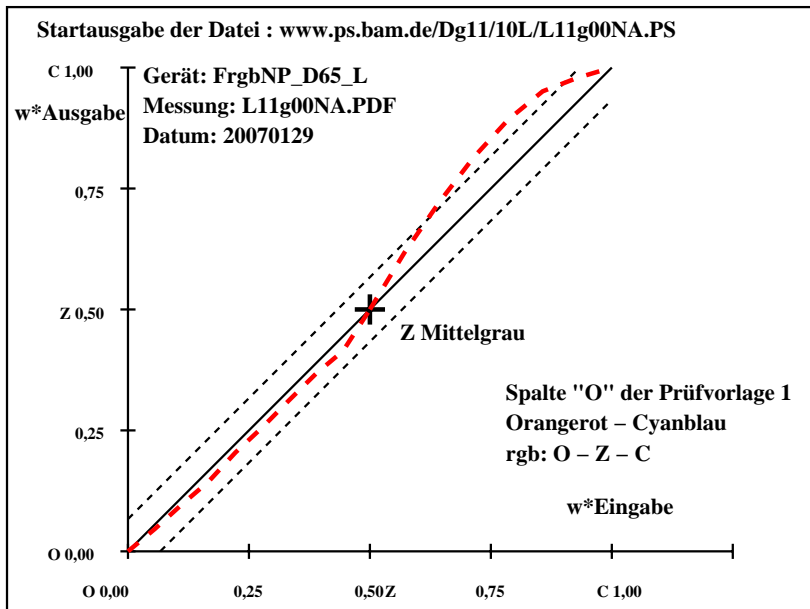

IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

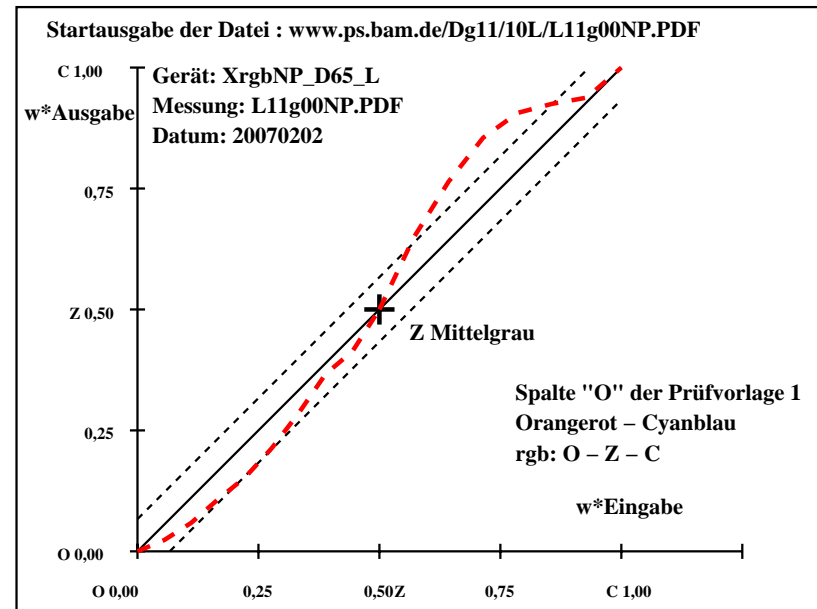


IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1									
Y	1	84.6	-3.8	110.3	92	84.6	-3.8	110.3	92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach	
	2	81.3	-3.8	96.5	92	85.8	-5.7	98.3	93	4.5	-1.8	1.8	2.7	5.2	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G	
	3	78.1	-3.8	82.6	93	86.5	-7.6	85.7	95	8.4	-3.7	3.1	4.9	9.7	und DIN 33866-1:2000 Anhang G	
	4	74.8	-3.8	68.8	93	83.1	-8.8	71.0	97	8.3	-4.9	2.3	5.5	10.0		
	5	71.5	-3.8	54.9	94	78.6	-9.8	54.5	100	7.1	-5.9	-0.3	6.1	9.3		
	6	68.2	-3.7	41.1	95	73.4	-10.4	41.2	104	5.2	-6.6	0.1	6.7	8.5	Gleichmäßigkeit	
	7	65.0	-3.7	27.2	98	68.5	-10.0	26.6	111	3.5	-6.2	-0.5	6.3	7.2	g* = 24.8	
	8	61.7	-3.7	13.3	106	63.3	-7.9	12.7	122	1.6	-4.1	-0.5	4.2	4.5		
Z	9	58.4	-3.7	-0.4	187	58.4	-3.7	-0.4	187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	10	52.9	3.2	-7.9	292	53.3	1.9	-13.0	278	0.3	-1.2	-5.0	5.3	5.3		
	11	47.4	10.2	-15.4	303	48.4	9.6	-25.1	291	1.0	-0.5	-9.7	9.8	9.8		
	12	41.9	17.2	-22.8	307	43.6	16.9	-35.1	296	1.7	-0.2	-12.2	12.3	12.4	Gelb – Violettblau	
	13	36.4	24.2	-30.3	309	38.5	24.2	-43.6	299	2.2	0.0	-13.2	13.3	13.5	rgb: Y – Z – V	
	14	30.9	31.2	-37.8	309	32.5	31.8	-50.7	302	1.6	0.6	-12.8	12.9	13.0		
	15	25.3	38.2	-45.3	310	26.2	39.7	-56.1	305	0.9	1.5	-10.8	11.0	11.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)	
	16	19.8	45.2	-52.7	311	19.8	47.1	-59.4	308	0.0	1.9	-6.6	6.9	6.9	ΔH* _{CIELAB} = 6.3	
V	17	14.3	52.2	-60.2	311	14.3	52.2	-60.2	311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE* _{CIELAB} = 7.4	
Y	18	84.6	-3.8	110.3	92	84.6	-3.8	110.3	92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	19	71.5	-3.8	54.9	94	78.6	-9.8	54.5	100	7.1	-5.9	-0.3	6.1	9.3		
Z	20	58.4	-3.7	-0.4	187	58.4	-3.7	-0.4	187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)	
	21	36.4	24.2	-30.3	309	38.5	24.2	-43.6	299	2.2	0.0	-13.2	13.3	13.5	ΔH* _{CIELAB} = 3.9	
V	22	14.3	52.2	-60.2	311	14.3	52.2	-60.2	311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE* _{CIELAB} = 4.6	


IG470-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1						
Y	1	90.8	-16.9	112.2	99	90.8	-16.9	112.2	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	2	86.7	-14.8	98.2	99	84.3	-15.2	101.7	99	-2.2	-0.3	3.5	3.6	4.3	
	3	82.5	-12.7	84.1	99	81.2	-15.2	94.4	99	-1.2	-2.5	10.3	10.6	10.6	
	4	78.3	-10.5	70.1	99	78.4	-14.6	84.6	100	0.0	-4.0	14.5	15.0	15.0	
	5	74.2	-8.4	56.1	99	75.0	-13.7	70.5	101	0.8	-5.2	14.4	15.3	15.4	
	6	70.0	-6.3	42.1	99	72.2	-11.7	52.0	103	2.2	-5.3	9.9	11.3	11.5	
	7	65.9	-4.2	28.1	99	68.1	-9.2	34.7	105	2.2	-5.0	6.6	8.4	8.6	
	8	61.7	-2.0	14.0	99	65.1	-5.6	18.7	107	3.4	-3.5	4.7	5.9	6.8	
Z	9	57.6	0.0	0.0	0	57.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Gleichmäßigkeit g* = 6.9
	10	55.1	0.2	-6.1	272	53.9	-0.1	-13.2	269	-1.1	-0.3	-7.0	7.1	7.2	
	11	52.7	0.4	-12.3	272	49.2	-1.6	-23.5	266	-3.4	-2.0	-11.1	11.4	11.9	
	12	50.3	0.6	-18.5	272	42.6	-0.2	-33.5	269	-7.6	-0.8	-14.9	15.0	16.9	
	13	47.9	0.8	-24.7	272	36.8	2.9	-41.4	274	-11.0	2.1	-16.6	16.8	20.2	
	14	45.5	1.0	-30.9	272	34.5	5.3	-45.8	277	-10.9	4.3	-14.8	15.5	19.0	
	15	43.1	1.2	-37.1	272	35.2	5.7	-48.2	277	-7.8	4.5	-11.0	12.0	14.3	
	16	40.6	1.4	-43.3	272	36.5	4.2	-48.7	275	-4.1	2.8	-5.3	6.1	7.4	
V	17	38.2	1.6	-49.5	272	38.2	1.6	-49.5	272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔH*_{CIELAB} = 9.1 ΔE*_{CIELAB} = 10.0
Y	18	90.8	-16.9	112.2	99	90.8	-16.9	112.2	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	74.2	-8.4	56.1	99	75.0	-13.7	70.5	101	0.8	-5.2	14.4	15.3	15.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
Z	20	57.6	0.0	0.0	0	57.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21	47.9	0.8	-24.7	272	36.8	2.9	-41.4	274	-11.0	2.1	-16.6	16.8	20.2	
	22	38.2	1.6	-49.5	272	38.2	1.6	-49.5	272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	38.2	1.6	-49.5	272	38.2	1.6	-49.5	272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	24	38.2	1.6	-49.5	272	38.2	1.6	-49.5	272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	25	38.2	1.6	-49.5	272	38.2	1.6	-49.5	272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	26	38.2	1.6	-49.5	272	38.2	1.6	-49.5	272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	27	38.2	1.6	-49.5	272	38.2	1.6	-49.5	272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔH*_{CIELAB} = 6.4 ΔE*_{CIELAB} = 7.1
	28	38.2	1.6	-49.5	272	38.2	1.6	-49.5	272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

IG471-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

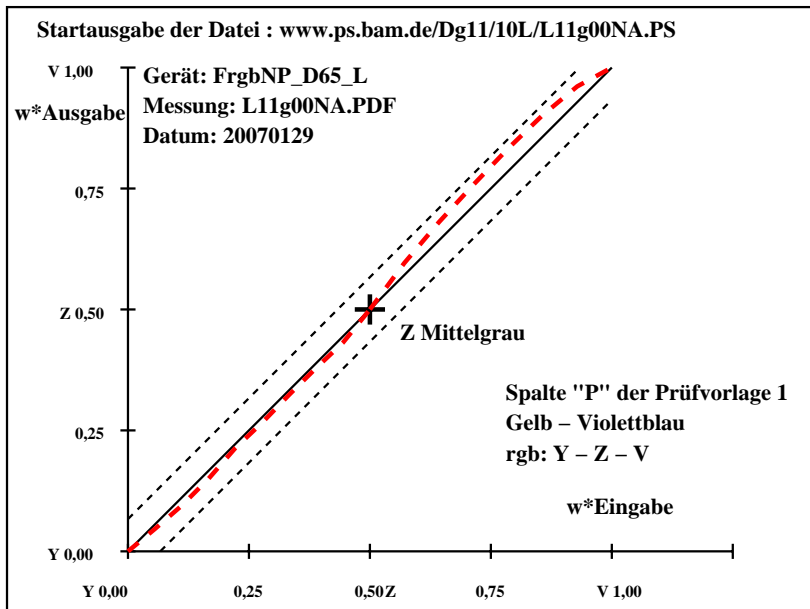

IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

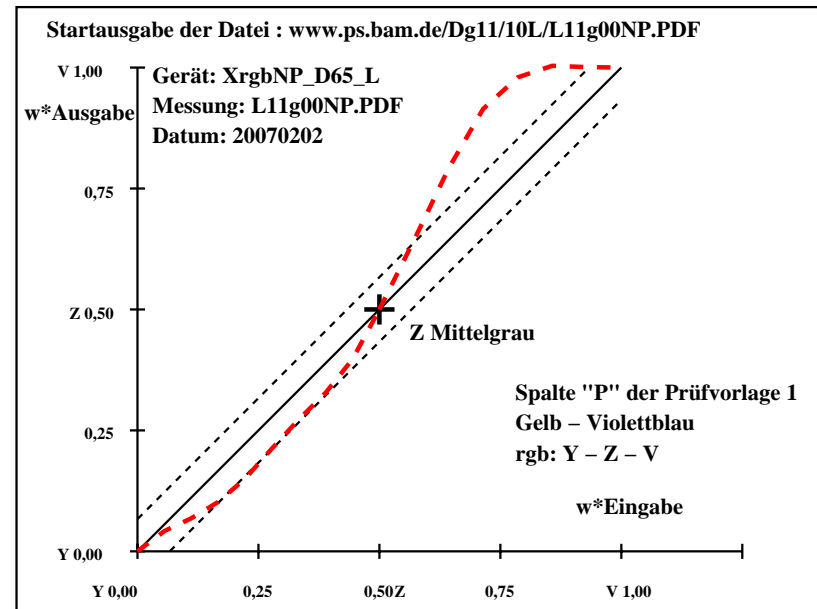

IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1	
L	1	44.9	-61.5	49.0	141	44.9	-61.5	49.0	141
	2	46.6	-54.3	42.8	142	49.7	-59.8	45.3	143
	3	48.3	-47.1	36.6	142	54.3	-56.7	40.4	145
	4	50.0	-39.9	30.4	143	57.3	-51.4	35.8	145
	5	51.8	-32.7	24.3	144	59.6	-43.8	29.2	146
	6	53.5	-25.5	18.1	145	60.3	-35.8	24.2	146
	7	55.2	-18.3	11.9	147	60.3	-26.4	16.3	148
	8	56.9	-11.1	5.7	153	59.7	-15.7	8.1	153
Z	9	58.6	-3.9	-0.4	187	58.6	-3.9	-0.4	187
	10	56.1	6.5	-4.7	324	57.3	9.3	-9.2	315
	11	53.5	16.9	-8.9	332	55.7	23.8	-17.3	324
	12	51.0	27.4	-13.2	334	54.5	37.0	-23.7	327
	13	48.5	37.9	-17.4	335	53.1	49.6	-28.3	330
	14	46.0	48.3	-21.7	336	50.9	60.9	-31.6	333
	15	43.5	58.8	-25.9	336	47.7	70.0	-33.8	334
	16	41.0	69.2	-30.2	336	43.0	76.2	-35.0	335
M	17	38.5	79.7	-34.4	337	38.5	79.7	-34.4	337
L	18	44.9	-61.5	49.0	141	44.9	-61.5	49.0	141
	19	51.8	-32.7	24.3	144	59.6	-43.8	29.2	146
Z	20	58.6	-3.9	-0.4	187	58.6	-3.9	-0.4	187
	21	48.5	37.9	-17.4	335	53.1	49.6	-28.3	330
M	22	38.5	79.7	-34.4	337	38.5	79.7	-34.4	337

Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G

Gleichmäßigkeit
 $g^* = 6.8$

Laubgrün – Magantarot
rgb: L – Z – M

Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 9.0$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 9.8$

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 5.6$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.2$

IG470-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1	
L	1	47.5	-66.6	39.0	150	47.5	-66.6	39.0	150
	2	48.8	-58.3	34.1	150	47.8	-65.5	38.7	149
	3	50.1	-49.9	29.3	150	47.5	-66.1	38.0	150
	4	51.4	-41.6	24.4	150	48.0	-65.8	38.5	150
	5	52.7	-33.3	19.6	150	48.9	-58.8	35.8	149
	6	54.0	-24.9	14.7	150	50.7	-47.1	27.3	150
	7	55.3	-16.6	9.8	149	53.9	-31.5	18.3	150
	8	56.6	-8.2	5.0	149	58.0	-15.1	13.8	138
Z	9	57.9	0.0	0.1	90	57.9	0.0	0.1	90
	10	56.4	8.9	-0.5	356	51.9	9.7	-10.6	312
	11	54.9	17.9	-1.3	356	45.7	24.8	-17.1	325
	12	53.4	26.8	-2.0	355	42.7	37.7	-19.1	333
	13	51.9	35.8	-2.8	355	41.0	50.6	-17.3	341
	14	50.4	44.7	-3.5	355	41.4	59.2	-14.0	347
	15	48.9	53.6	-4.2	355	43.7	66.0	-11.3	350
	16	47.4	62.6	-5.0	355	44.0	68.3	-8.5	353
M	17	45.9	71.5	-5.7	355	45.9	71.5	-5.7	355
L	18	47.5	-66.6	39.0	150	47.5	-66.6	39.0	150
	19	52.7	-33.3	19.6	150	48.9	-58.8	35.8	149
Z	20	57.9	0.0	0.1	90	57.9	0.0	0.1	90
	21	51.9	35.8	-2.8	355	41.0	50.6	-17.3	341
M	22	45.9	71.5	-5.7	355	45.9	71.5	-5.7	355

Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G


Gleichmäßigkeit
 $g^* = 8.5$

Laubgrün – Magantarot
rgb: L – Z – M


Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 14.5$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 15.3$

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 10.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 10.8$

IG471-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

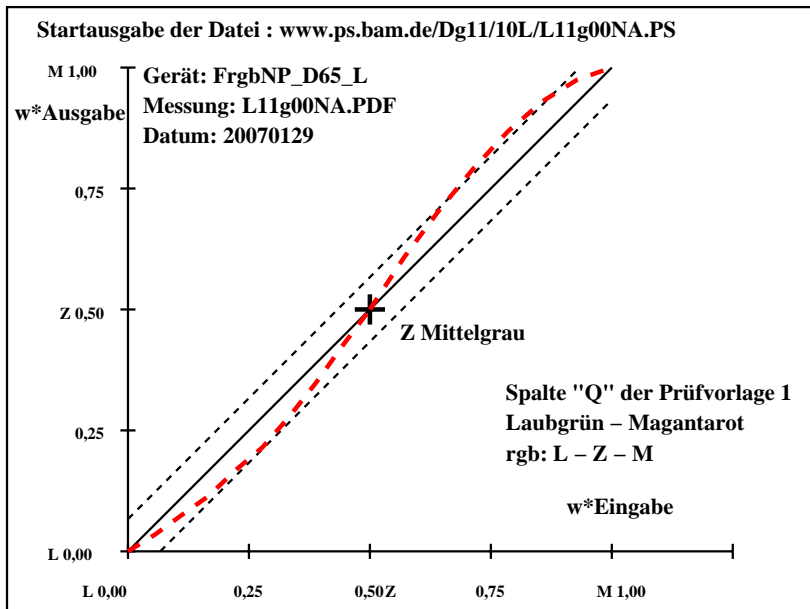

IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

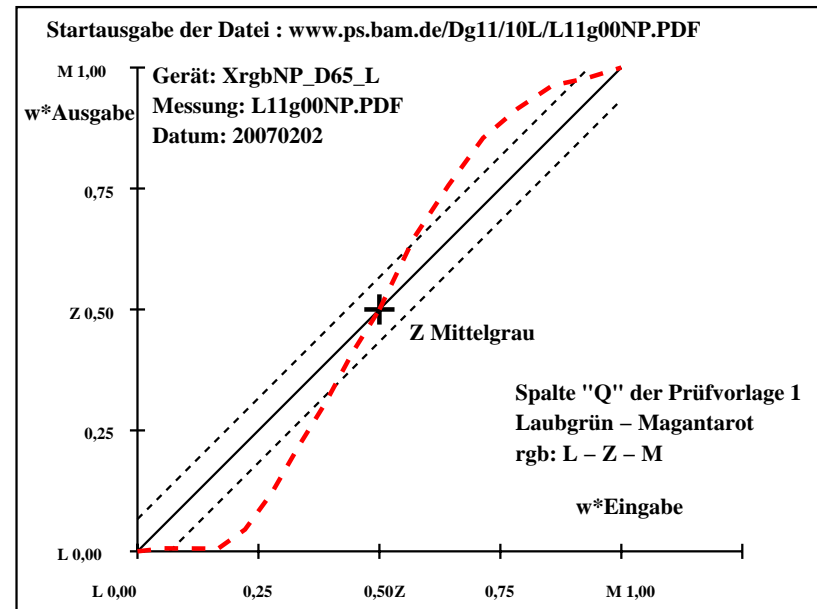


IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH*	ΔE*	
Start-Ausgabe S1									
Kennzeichnung nach									
ISO/IEC 15775:1999 Anhang G									
und DIN 33866-1:2000 Anhang G									
R	1	36.4	64.1	29.9	25	36.6	60.6	43.8	36
	2	39.7	55.6	49.6	42	80.1	2.0	103.6	89
	3	51.3	40.1	65.4	59	68.2	18.3	86.4	78
	4	64.7	22.0	83.7	75	53.2	39.5	66.1	59
J	5	84.0	-3.7	109.8	92	84.4	-3.9	110.0	92
	6	66.6	-29.3	83.2	109	80.3	-12.7	104.2	97
	7	53.8	-47.7	63.5	127	68.5	-33.4	85.6	111
	8	44.8	-59.1	42.3	145	57.9	-48.4	69.3	125
G	9	48.0	-48.3	15.7	162	44.2	-61.5	48.9	142
	10	50.7	-39.2	-6.5	190	50.6	-48.4	-3.7	184
C	11	52.8	-32.0	-24.1	217	53.9	-29.1	-31.5	227
	12	48.0	-17.0	-35.8	245	43.5	-6.9	-41.4	260
B	13	38.9	1.5	-42.4	272	14.2	52.2	-60.3	311
	14	24.7	30.9	-52.9	300	27.8	65.1	-48.7	323
M	15	30.9	70.3	-43.0	329	38.7	79.5	-34.4	337
	16	37.6	72.0	-4.0	357	37.6	71.9	-15.5	348
R	17	36.4	64.1	29.9	25	35.8	61.1	45.0	36
	18	36.4	64.1	29.9	25	36.6	60.6	43.8	36
J	19	84.0	-3.7	109.8	92	84.4	-3.9	110.0	92
	20	48.0	-48.3	15.7	162	44.2	-61.5	48.9	142
G	21	38.9	1.5	-42.4	272	14.2	52.2	-60.3	311
B	22	36.4	64.1	29.9	25	35.8	61.1	45.0	36
Rot-Gelb-Grün-Blau-Rot									
rgb: R-J-G-B-R									
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)									
$\Delta H^*_{CIELAB} = 23.8$									
$\Delta E^*_{CIELAB} = 26.9$									
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)									
$\Delta H^*_{CIELAB} = 20.8$									
$\Delta E^*_{CIELAB} = 25.1$									


IG470-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH*	ΔE*	
Start-Ausgabe S1									
Kennzeichnung nach									
ISO/IEC 15775:1999 Anhang G									
und DIN 33866-1:2000 Anhang G									
R	1	46.3	62.7	29.2	25	46.2	60.2	39.2	33
	2	50.5	52.8	47.1	42	47.0	58.3	45.9	38
	3	59.3	37.6	61.3	58	56.4	41.7	62.8	56
	4	69.2	20.4	77.4	75	75.9	7.2	90.6	85
J	5	83.1	-3.4	99.8	92	90.8	-16.8	112.4	99
	6	77.6	-31.8	90.0	110	76.6	-31.4	88.0	110
	7	62.6	-48.6	64.6	127	55.6	-54.4	52.3	136
	8	50.5	-62.0	44.3	145	48.6	-63.3	41.1	147
G	9	46.8	-57.2	18.6	162	47.3	-65.0	38.4	149
	10	48.4	-42.2	-7.0	190	48.2	-64.4	35.9	151
C	11	49.4	-32.2	-24.2	217	52.1	-16.3	-52.3	253
	12	50.6	-20.8	-43.7	245	46.0	-7.1	-50.1	262
B	13	38.4	1.7	-49.1	272	39.2	1.1	-49.2	271
	14	40.5	21.6	-36.9	300	33.5	19.1	-43.3	294
M	15	42.7	41.0	-25.0	329	46.2	71.5	-6.1	355
	16	46.1	70.7	-3.9	357	46.0	67.5	7.0	6
R	17	46.3	62.7	29.2	25	46.2	60.8	36.4	31
	18	46.3	62.7	29.2	25	46.2	60.2	39.2	33
J	19	83.1	-3.4	99.8	92	90.8	-16.8	112.4	99
	20	46.8	-57.2	18.6	162	47.3	-65.0	38.4	149
G	21	38.4	1.7	-49.1	272	39.2	1.1	-49.2	271
B	22	46.3	62.7	29.2	25	46.2	60.8	36.4	31
Rot-Gelb-Grün-Blau-Rot									
rgb: R-J-G-B-R									
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)									
$\Delta H^*_{CIELAB} = 14.6$									
$\Delta E^*_{CIELAB} = 15.7$									
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)									
$\Delta H^*_{CIELAB} = 10.1$									
$\Delta E^*_{CIELAB} = 12.0$									

IG471-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

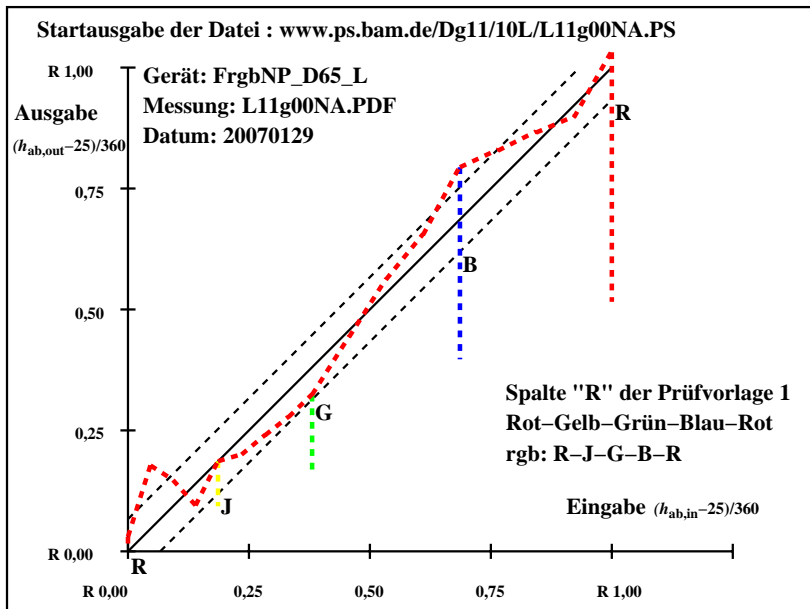

IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

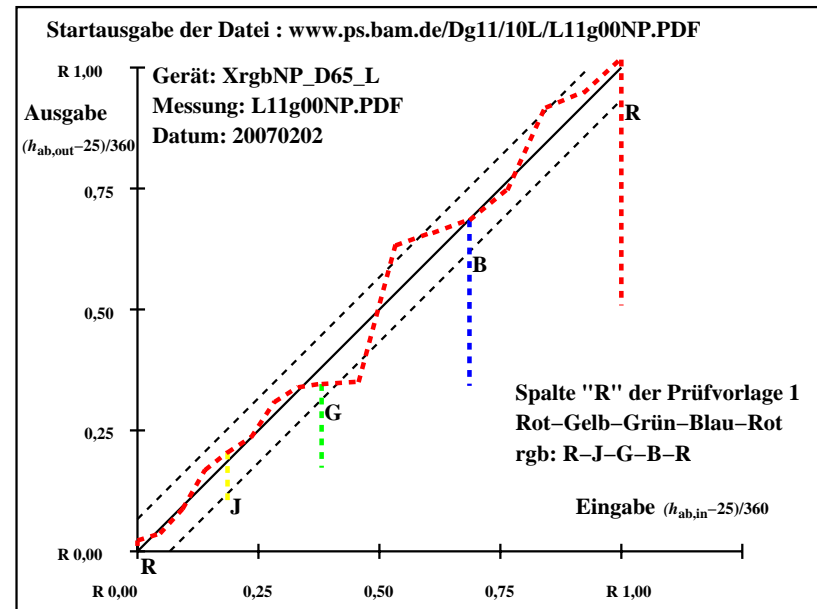


IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1							
R	1	22.5	32.1	14.9	25	24.2	35.8	24.5	34	1.7	3.7	9.6	10.3	10.4	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	2	24.2	27.8	24.8	42	47.6	-2.3	55.8	92	23.4	-30.1	31.0	43.3	49.2	
	3	30.0	20.0	32.7	59	40.4	9.2	45.9	79	10.4	-10.7	13.2	17.1	20.0	
	4	36.7	11.0	41.8	75	31.9	23.1	34.8	56	-4.7	12.1	-6.9	14.0	14.8	
J	5	46.3	-1.8	54.9	92	54.9	-14.0	66.1	102	8.6	-12.1	11.2	16.5	18.6	(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)n rgb: (R-J-G-B-R)n
	6	37.6	-14.6	41.6	109	50.9	-23.6	59.8	112	13.3	-8.9	18.2	20.3	24.3	
	7	31.2	-23.8	31.7	127	46.5	-32.8	53.0	122	15.3	-8.9	21.3	23.1	27.7	
	8	26.7	-29.5	21.1	145	41.8	-42.0	45.4	133	15.1	-12.4	24.3	27.3	31.2	
G	9	28.3	-24.1	7.9	162	36.2	-49.6	37.9	143	7.9	-25.4	30.0	39.4	40.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) ΔH* _{CIELAB} = 21.3 ΔE* _{CIELAB} = 23.8
	10	29.7	-19.5	-3.2	190	38.9	-41.3	5.4	173	9.2	-21.7	8.7	23.4	25.2	
C	11	30.7	-15.9	-12.0	217	40.8	-28.6	-15.6	209	10.1	-12.6	-3.5	13.2	16.6	
	12	28.3	-8.5	-17.9	245	28.3	-1.5	-29.7	267	0.0	7.0	-11.7	13.7	13.7	
B	13	23.8	0.7	-21.2	272	11.9	34.7	-43.9	308	-11.8	34.0	-22.6	40.9	42.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) ΔH* _{CIELAB} = 21.4 ΔE* _{CIELAB} = 24.2
	14	16.7	15.5	-26.4	300	18.8	42.6	-38.8	318	2.1	27.1	-12.3	29.8	29.9	
M	15	19.8	35.2	-21.4	329	26.0	52.6	-29.9	330	6.3	17.4	-8.4	19.4	20.4	
	16	23.1	36.0	-1.9	357	24.5	43.6	-10.0	347	1.3	7.6	-8.0	11.1	11.1	
R	17	22.5	32.1	14.9	25	23.0	35.3	23.8	34	0.4	3.2	8.9	9.4	9.4	
R	18	22.5	32.1	14.9	25	24.2	35.8	24.5	34	1.7	3.7	9.6	10.3	10.4	
J	19	46.3	-1.8	54.9	92	54.9	-14.0	66.1	102	8.6	-12.1	11.2	16.5	18.6	
G	20	28.3	-24.1	7.9	162	36.2	-49.6	37.9	143	7.9	-25.4	30.0	39.4	40.2	
B	21	23.8	0.7	-21.2	272	11.9	34.7	-43.9	308	-11.8	34.0	-22.6	40.9	42.6	
R	22	22.5	32.1	14.9	25	23.0	35.3	23.8	34	0.4	3.2	8.9	9.4	9.4	


IG470-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1
R	1	34.0	31.3	14.6	25	35.8 34.4 29.4 41	1.9 3.1 14.8 15.1 15.2	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G und DIN 33866-1:2000 Anhang G
	2	36.1	26.4	23.6	42	36.9 30.7 31.1 45	0.8 4.3 7.5 8.7 8.7	
	3	40.5	18.8	30.7	58	41.3 20.1 38.2 62	0.8 1.3 7.5 7.6 7.7	
	4	45.5	10.2	38.7	75	51.7 0.1 54.2 90	6.2-10.0 15.5 18.5 19.5	
J	5	52.4	-1.6	49.9	92	59.6-11.9 66.0 100	7.3-10.2 16.1 19.1 20.4	
	6	49.6	-15.8	45.0	110	55.0-21.3 57.0 111	5.4 -5.4 12.0 13.2 14.2	
	7	42.1	-24.2	32.3	127	45.6-37.7 39.7 134	3.5-13.4 7.4 15.4 15.7	
	8	36.1	-31.0	22.2	145	40.7-47.2 30.7 147	4.6-16.1 8.5 18.3 18.9	
G	9	34.2	-28.5	9.3	162	38.5-49.9 26.9 152	4.2-21.3 17.6 27.7 28.0	
	10	35.0	-21.1	-3.4	190	33.8-38.0 16.0 157	-1.1-16.8 19.5 25.9 25.9	
C	11	35.5	-16.0	-12.1	217	37.0-19.8-26.7 233	1.4 -3.7-14.5 15.1 15.2	(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)n rgb: (R-J-G-B-R)n
B	12	36.1	-10.4	-21.8	245	32.2 -4.0-35.3 263	-3.9 6.4-13.4 14.9 15.4	
	13	30.0	0.9	-24.5	272	28.4 1.4-34.1 272	-1.5 0.5 -9.5 9.6 9.8	
	14	31.1	10.8	-18.4	300	26.0 15.0-40.0 291	-4.9 4.2-21.5 22.0 22.6	
M	15	32.2	20.5	-12.4	329	30.4 41.8-20.6 334	-1.7 21.3 -8.1 22.8 22.9	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	33.9	35.4	-1.9	357	31.8 40.2 1.2 2	-2.0 4.8 3.2 5.8 6.2	ΔH*CIELAB = 15.3
R	17	34.0	31.3	14.6	25	36.1 34.0 29.6 41	2.2 2.7 15.0 15.2 15.4	ΔE*CIELAB = 16.6
R	18	34.0	31.3	14.6	25	35.8 34.4 29.4 41	1.9 3.1 14.8 15.1 15.2	
J	19	52.4	-1.6	49.9	92	59.6-11.9 66.0 100	7.3-10.2 16.1 19.1 20.4	
G	20	34.2	-28.5	9.3	162	38.5-49.9 26.9 152	4.2-21.3 17.6 27.7 28.0	
B	21	30.0	0.9	-24.5	272	28.4 1.4-34.1 272	-1.5 0.5 -9.5 9.6 9.8	
R	22	34.0	31.3	14.6	25	36.1 34.0 29.6 41	2.2 2.7 15.0 15.2 15.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
								ΔH*CIELAB = 14.3
								ΔE*CIELAB = 17.6

IG471-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

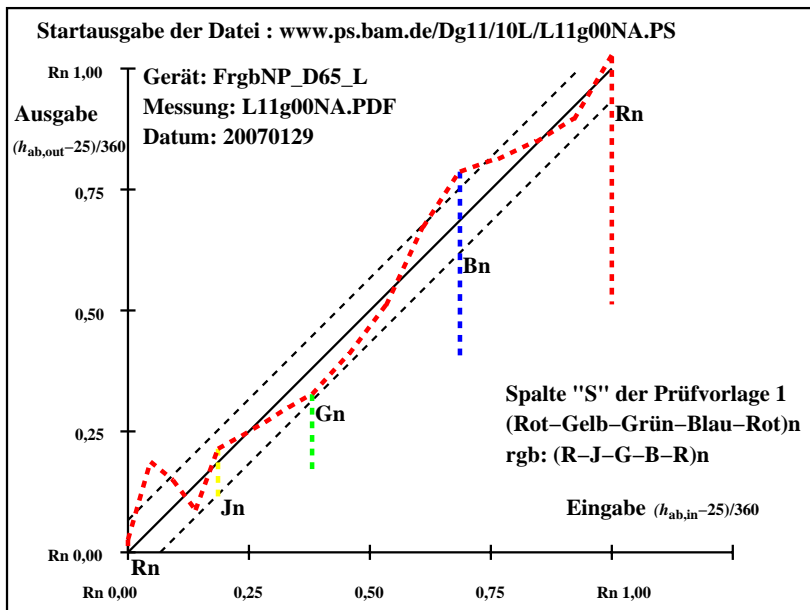

IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

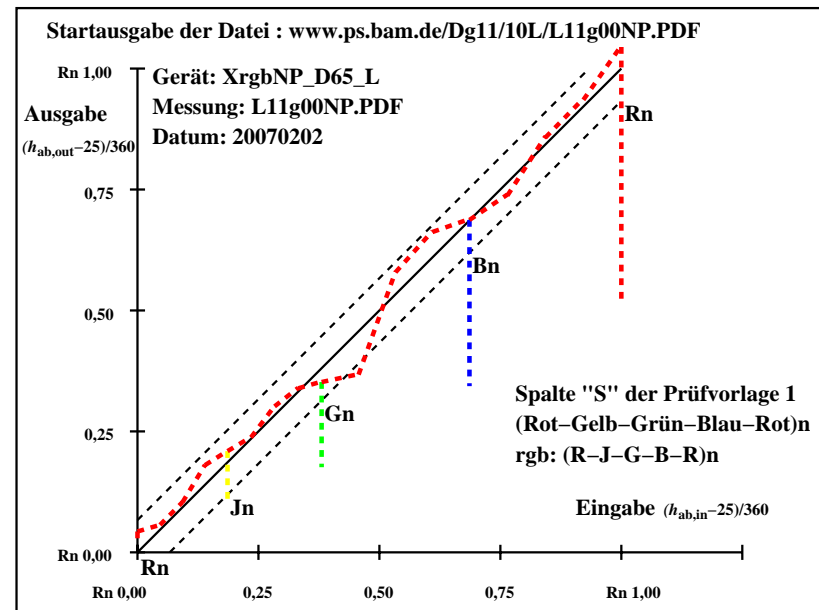

IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH^*	ΔE^*
Start-Ausgabe S1								
Kennzeichnung nach								
ISO/IEC 15775:1999 Anhang G								
und DIN 33866-1:2000 Anhang G								
R	1	64.5	32.1	14.9	25	70.6	25.0	11.9
	2	66.2	27.8	24.8	42	90.4	-7.3	39.2
	3	72.0	20.0	32.7	59	84.4	2.3	30.8
	4	78.7	11.0	41.8	75	77.7	13.1	22.0
J	5	88.3	-1.8	54.9	92	90.4	-7.8	39.8
	6	79.6	-14.6	41.6	109	90.1	-8.4	39.7
	7	73.2	-23.8	31.7	127	86.2	-16.9	34.7
	8	68.7	-29.5	21.1	145	80.7	-26.3	28.0
G	9	70.3	-24.1	7.9	162	74.9	-33.7	21.4
	10	71.7	-19.5	-3.2	190	77.6	-25.1	-5.3
C'	11	72.7	-15.9	-12.0	217	78.5	-20.5	-15.4
	12	70.3	-8.5	-17.9	245	73.2	-10.3	-21.1
B	13	65.8	0.7	-21.2	272	60.3	13.5	-32.8
	14	58.6	15.5	-26.4	300	68.1	29.4	-25.1
M'	15	61.8	35.2	-21.4	329	71.2	37.2	-21.4
	16	65.1	36.0	-1.9	357	70.5	33.8	-12.7
R	17	64.5	32.1	14.9	25	69.4	26.3	12.6
	18	64.5	32.1	14.9	25	70.6	25.0	11.9
J	19	88.3	-1.8	54.9	92	90.4	-7.8	39.8
G	20	70.3	-24.1	7.9	162	74.9	-33.7	21.4
B	21	65.8	0.7	-21.2	272	60.3	13.5	-32.8
R	22	64.5	32.1	14.9	25	69.4	26.3	12.6


(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)w
rgb: (R-J-G-B-R)w
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 11.6$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 15.2$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 11.6$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 13.5$

IG470-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH^*	ΔE^*
Start-Ausgabe S1								
Kennzeichnung nach								
ISO/IEC 15775:1999 Anhang G								
und DIN 33866-1:2000 Anhang G								
R	1	70.9	31.3	14.6	25	61.7	40.1	18.3
	2	73.0	26.4	23.6	42	70.5	23.3	29.4
	3	77.4	18.8	30.7	58	78.0	9.4	42.3
	4	82.4	10.2	38.7	75	86.6	-4.7	54.9
J	5	89.3	-1.6	49.9	92	92.1	-16.1	74.7
	6	86.5	-15.8	45.0	110	84.8	-23.4	64.8
	7	79.0	-24.2	32.3	127	72.7	-34.2	52.4
	8	73.0	-31.0	22.2	145	61.7	-46.1	41.5
G	9	71.1	-28.5	9.3	162	56.1	-53.3	38.6
	10	71.9	-21.1	-3.4	190	59.5	-43.4	12.4
C'	11	72.4	-16.0	-12.1	217	60.8	-15.7	-38.9
	12	73.0	-10.4	-21.8	245	62.9	-8.2	-28.6
B	13	66.9	0.9	-24.5	272	58.8	-0.2	-35.4
	14	68.0	10.8	-18.4	300	54.8	23.8	-26.4
M'	15	69.1	20.5	-12.4	329	61.0	47.4	-11.6
	16	70.8	35.4	-1.9	357	59.0	43.8	-3.7
R	17	70.9	31.3	14.6	25	63.0	38.0	17.6
	18	70.9	31.3	14.6	25	61.7	40.1	18.3
J	19	89.3	-1.6	49.9	92	92.1	-16.1	74.7
G	20	71.1	-28.5	9.3	162	56.1	-53.3	38.6
B	21	66.9	0.9	-24.5	272	58.8	-0.2	-35.4
R	22	70.9	31.3	14.6	25	63.0	38.0	17.6

(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)w
rgb: (R-J-G-B-R)w
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 18.3$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 21.1$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 17.5$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 19.5$

IG471-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

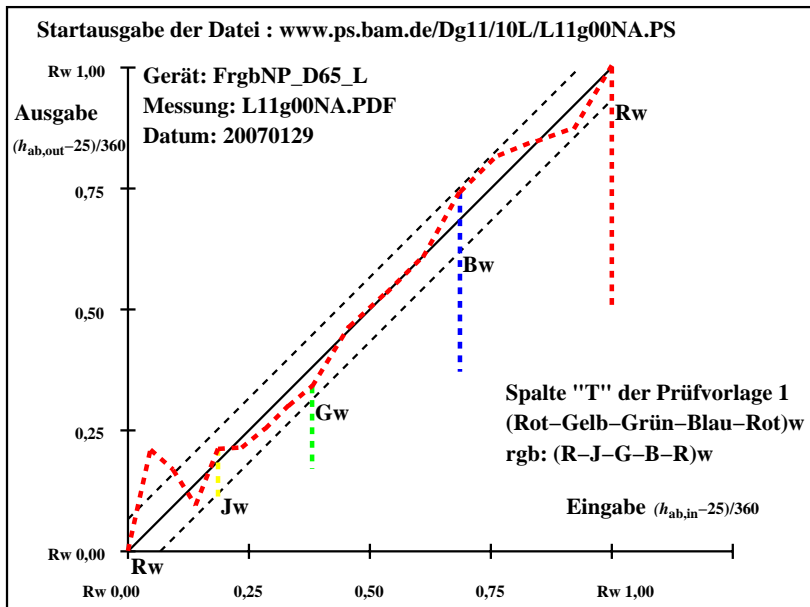

IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

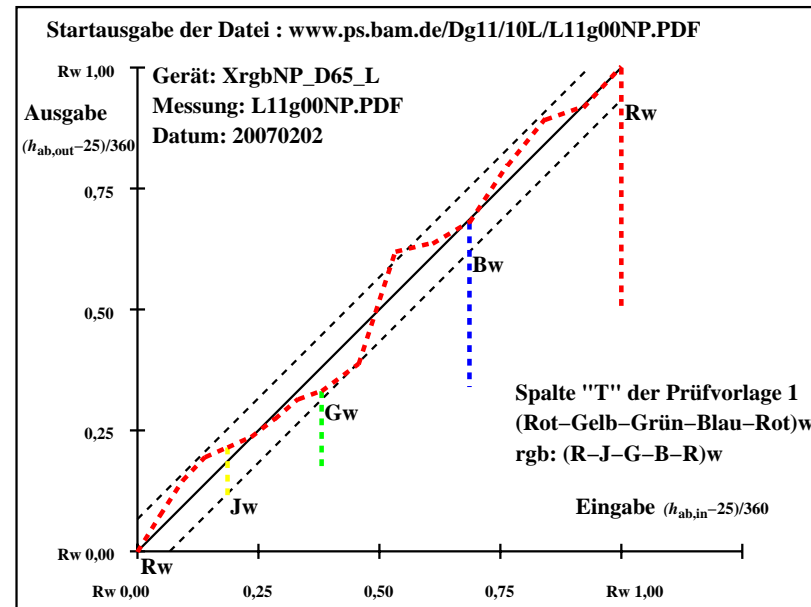


IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1	
N	1	9.1	0.0	0.2	90	9.1	0.0	0.2	90	0.0
	2	14.4	0.0	0.2	90	14.6	0.3	-1.7	279	0.2
	3	19.6	0.0	0.2	90	21.7	-0.4	-2.7	260	2.1
	4	24.8	0.0	0.2	90	28.4	-1.8	-1.9	226	3.6
	5	30.0	0.0	0.2	90	35.5	-2.1	-2.3	227	5.5
	6	35.3	0.0	0.1	90	41.3	-2.6	-0.4	190	6.1
	7	40.5	0.0	0.1	90	46.8	-2.6	-0.7	197	6.3
	8	45.7	0.0	0.1	90	52.9	-3.7	-0.2	185	7.2
Z	9	51.0	0.0	0.1	90	58.3	-3.7	-0.8	193	7.3
	10	56.2	0.0	0.1	90	63.8	-3.2	-1.2	202	7.6
	11	61.4	0.0	0.1	90	69.8	-1.8	-1.5	220	8.4
	12	66.7	0.0	0.1	90	75.6	-0.8	-1.6	242	9.0
	13	71.9	0.0	0.1	90	81.6	0.0	-1.1	270	9.7
	14	77.1	0.0	0.0	90	87.1	0.0	0.0	270	10.0
	15	82.3	0.0	0.0	90	92.1	-0.6	1.1	122	9.8
	16	87.6	0.0	0.0	90	92.9	0.0	0.0	0	5.3
W	17	92.8	0.0	0.0	0	92.8	0.0	0.0	0	0.0
N	18	9.1	0.0	0.2	90	9.1	0.0	0.2	90	0.0
	19	30.0	0.0	0.2	90	35.5	-2.1	-2.3	227	5.5
Z	20	51.0	0.0	0.1	90	58.3	-3.7	-0.8	193	7.3
	21	71.9	0.0	0.1	90	81.6	0.0	-1.1	270	9.7
W	22	92.8	0.0	0.0	0	92.8	0.0	0.0	0	0.0
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:									$R^*_{ab,m} = 72$	


IG470-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1	
N	1	22.6	0.2	7.1	88	22.6	0.2	7.1	88	0.0
	2	27.2	0.2	6.7	88	25.1	0.3	7.2	88	-2.0
	3	31.7	0.2	6.2	88	28.1	0.3	6.9	88	-3.5
	4	36.3	0.2	5.8	88	33.3	0.2	6.3	88	-2.9
	5	40.8	0.2	5.4	88	37.9	0.2	5.9	88	-2.8
	6	45.4	0.1	4.9	88	43.2	0.1	5.3	89	-2.0
	7	49.9	0.1	4.5	88	47.2	0.1	4.8	89	-2.6
	8	54.5	0.1	4.1	88	52.6	0.1	4.4	89	-1.8
Z	9	59.0	0.1	3.7	88	58.4	0.0	3.9	90	-0.5
	10	63.6	0.1	3.2	88	63.4	0.1	3.2	88	0.0
	11	68.1	0.1	2.8	88	68.8	0.0	2.7	90	0.7
	12	72.7	0.1	2.4	88	73.5	0.0	2.5	90	0.8
	13	77.2	0.1	1.9	89	76.9	0.1	1.9	87	-0.3
	14	81.8	0.0	1.5	89	81.7	0.0	1.6	90	0.0
	15	86.3	0.0	1.1	89	85.4	0.0	1.0	90	-0.9
	16	90.9	0.0	0.6	89	88.9	0.0	0.7	90	-1.9
W	17	95.4	0.0	0.2	90	95.4	0.0	0.2	90	0.0
N	18	22.6	0.2	7.1	88	22.6	0.2	7.1	88	0.0
	19	40.8	0.2	5.4	88	37.9	0.2	5.9	88	-2.8
Z	20	59.0	0.1	3.7	88	58.4	0.0	3.9	90	-0.5
	21	77.2	0.1	1.9	89	76.9	0.1	1.9	87	-0.3
W	22	95.4	0.0	0.2	90	95.4	0.0	0.2	90	0.0
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:									$R^*_{ab,m} = 94$	

IG471-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

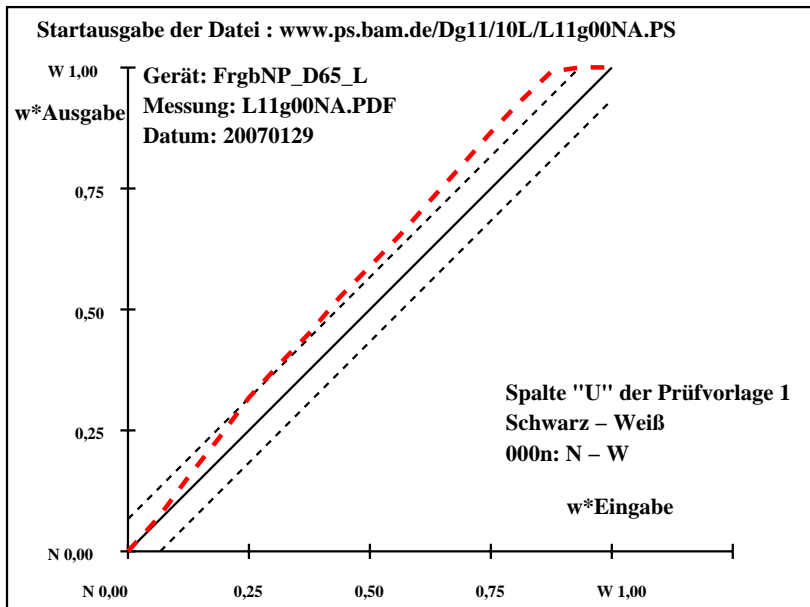

IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

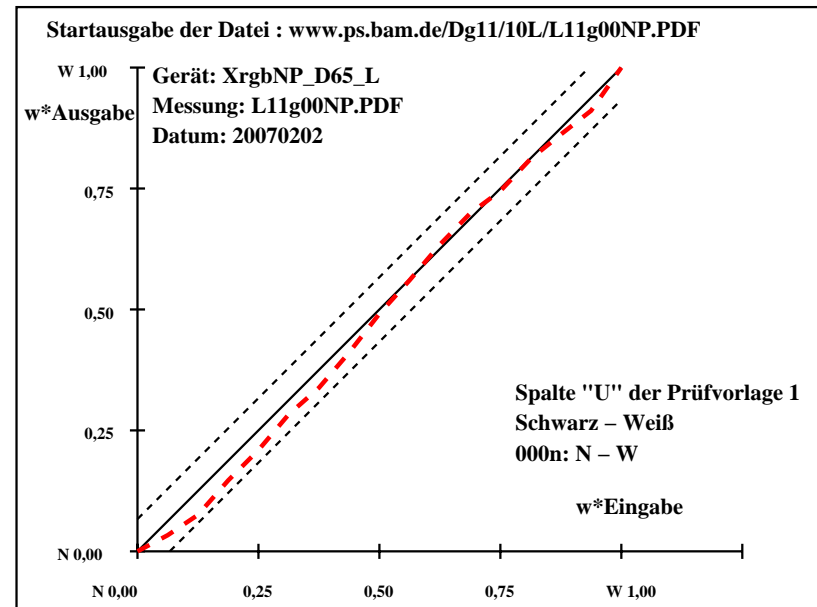


IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1											
N	1	8.7	0.0	0.0	0	8.7	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach					
	2	13.9	0.0	0.0	0	13.9	0.7	-2.5	285	0.0	0.7	-2.5	2.7	2.7	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G					
	3	19.1	0.0	0.0	0	20.8	-0.2	-3.9	266	1.6	-0.2	-3.9	4.0	4.3	und DIN 33866-1:2000 Anhang C					
	4	24.4	0.0	0.0	0	27.4	-1.8	-3.0	238	3.0	-1.8	-3.0	3.6	4.7	relative CIELAB Daten für "aus"					
	5	29.6	0.0	0.0	0	34.4	-2.2	-3.4	237	4.7	-2.2	-3.4	4.2	6.3	$\Delta L^* = 92.63 - 8.65$					
	6	34.9	0.0	0.0	0	40.2	-2.7	-1.7	213	5.3	-2.7	-1.7	3.3	6.2	Gleichmäßigkeit					
	7	40.1	0.0	0.0	0	45.9	-3.1	-1.5	207	5.7	-3.1	-1.5	3.6	6.7	$g^* = 44.4$					
	8	45.4	0.0	0.0	0	52.0	-3.9	-1.1	197	6.6	-3.9	-1.1	4.2	7.8						
Z	9	50.6	0.0	0.0	0	57.5	-3.9	-1.5	202	6.9	-3.9	-1.5	4.3	8.1	Helligkeitsumfang relativ zu Offset					
	10	55.9	0.0	0.0	0	63.4	-3.1	-1.9	212	7.5	-3.1	-1.9	3.8	8.4	$j^* = 108.5$					
	11	61.1	0.0	0.0	0	69.1	-1.8	-2.1	229	8.0	-1.8	-2.1	2.9	8.5						
	12	66.4	0.0	0.0	0	75.2	-0.6	-2.1	252	8.9	-0.6	-2.1	2.3	9.1	Schwarz – Weiß					
	13	71.6	0.0	0.0	0	81.2	0.1	-1.4	274	9.6	0.1	-1.4	1.5	9.7	w: N – W					
	14	76.9	0.0	0.0	0	86.9	0.0	-0.1	270	10.0	0.0	-0.1	0.2	10.0						
	15	82.1	0.0	0.0	0	92.0	-0.7	1.1	126	9.9	-0.7	1.1	1.4	10.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)					
	16	87.4	0.0	0.0	0	92.7	0.0	0.0	0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	$\Delta H^*_{CIELAB} = 2.5$					
W	17	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 6.3$					
	18	8.7	0.0	0.0	0	8.7	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
Z	19	29.6	0.0	0.0	0	34.4	-2.2	-3.4	237	4.7	-2.2	-3.4	4.2	6.3						
	20	50.6	0.0	0.0	0	57.5	-3.9	-1.5	202	6.9	-3.9	-1.5	4.3	8.1	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)					
W	21	71.6	0.0	0.0	0	81.2	0.1	-1.4	274	9.6	0.1	-1.4	1.5	9.7	$\Delta H^*_{CIELAB} = 2.0$					
	22	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 4.8$					
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 72$										


IG470-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out/c-ref		ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1									
N	1	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0	-0.1	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach						
	2	25.9	0.0	-0.1	242	24.0	0.0	0.0	270	-1.8	0.1	0.1	0.1	1.9	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G						
	3	30.6	0.0	-0.1	240	26.6	0.0	0.0	0	-3.9	0.1	0.2	0.2	4.0	und DIN 33866-1:2000 Anhang G						
	4	35.2	0.0	-0.1	238	32.1	0.0	0.0	0	-3.0	0.1	0.2	0.2	3.1	relative CIELAB Daten für "aus"						
	5	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0	0.1	90	-3.0	0.1	0.3	0.3	3.1	$\Delta L^* = 95.51 - 21.27$						
	6	44.5	0.0	0.0	234	42.6	0.0	0.0	270	-1.8	0.1	0.0	0.1	1.9	Gleichmäßigkeit						
	7	49.1	0.0	0.0	231	47.2	0.0	0.0	0	-1.8	0.1	0.1	0.2	1.9	$g^* = 77.3$						
	8	53.8	0.0	0.0	228	51.9	0.0	0.1	90	-1.8	0.1	0.2	0.2	1.9							
Z	9	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0	0.3	108	-1.5	0.0	0.4	0.4	1.6	Helligkeitsumfang relativ zu Offset						
	10	63.0	0.0	0.0	221	63.2	0.0	0.0	180	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	$f^* = 95.9$						
	11	67.7	0.0	0.0	217	67.4	0.0	0.0	0	-0.2	0.1	0.1	0.1	0.3							
	12	72.3	0.0	0.0	212	71.7	0.0	0.3	90	-0.5	0.1	0.4	0.4	0.7	Schwarz – Weiß						
	13	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0	0.1	90	-0.9	0.1	0.2	0.2	1.0	w: N – W						
	14	81.6	0.0	0.0	201	81.1	0.0	0.1	90	-0.4	0.1	0.1	0.2	0.5							
	15	86.2	0.0	0.0	194	85.1	0.0	0.1	90	-1.0	0.1	0.1	0.2	1.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)						
	16	90.9	0.0	0.0	187	89.1	0.0	0.0	0	-1.7	0.1	0.0	0.1	1.8	$\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$						
W	17	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 1.5$						
N	18	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0	-0.1	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	19	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0	0.1	90	-3.0	0.1	0.3	0.3	3.1							
Z	20	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0	0.3	108	-1.5	0.0	0.4	0.4	1.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)						
	21	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0	0.1	90	-0.9	0.1	0.2	0.2	1.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$						
W	22	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 1.1$						
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 94$											

IG471-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

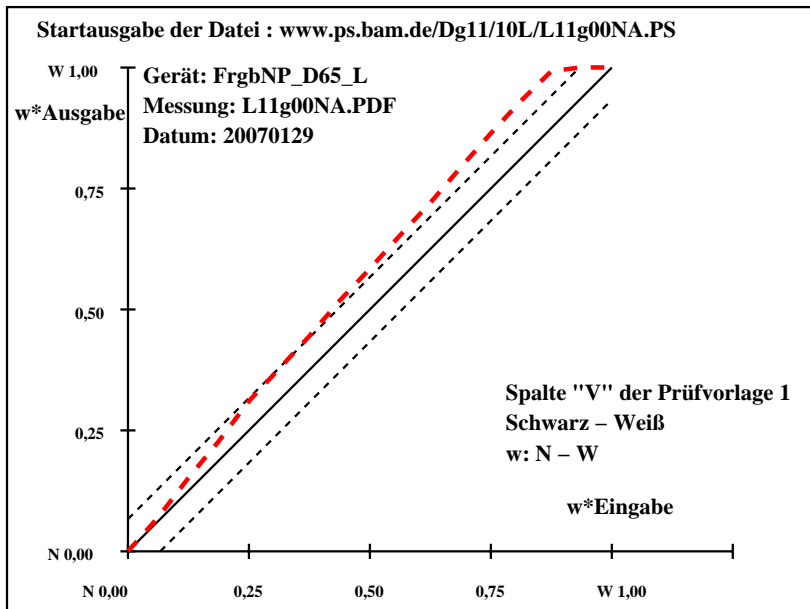

IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

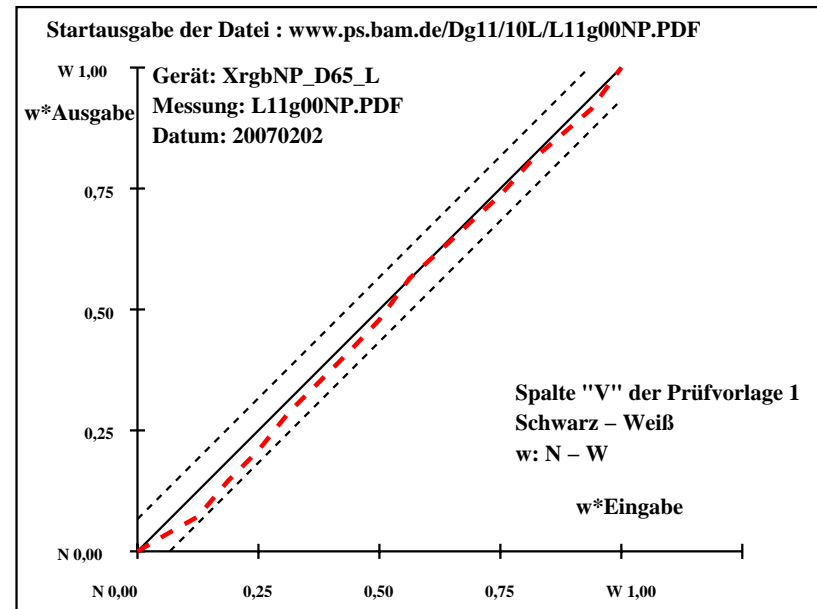


IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1										
N	1	9.1	0.0	0.2	90	9.1	0.0	0.2	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach		
	2	14.4	0.0	0.2	90	14.6	0.3	-1.7	279	0.2	0.3	-1.9	2.0	2.0	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G		
	3	19.6	0.0	0.2	90	21.7	-0.4	-2.7	260	2.1	-0.4	-2.9	3.0	3.7	und DIN 33866-1:2000 Anhang G		
	4	24.8	0.0	0.2	90	28.4	-1.8	-1.9	226	3.6	-1.8	-2.1	2.9	4.6	relative CIELAB Daten für "aus"		
	5	30.0	0.0	0.2	90	35.5	-2.1	-2.3	227	5.5	-2.1	-2.5	3.4	6.4	ΔL* = 92.81 – 9.12		
	6	35.3	0.0	0.1	90	41.3	-2.6	-0.4	190	6.1	-2.6	-0.5	2.8	6.7	Gleichmäßigkeit		
	7	40.5	0.0	0.1	90	46.8	-2.6	-0.7	197	6.3	-2.6	-0.8	2.9	6.9	g* = 42.5		
	8	45.7	0.0	0.1	90	52.9	-3.7	-0.2	185	7.2	-3.7	-0.3	3.8	8.1			
Z	9	51.0	0.0	0.1	90	58.3	-3.7	-0.8	193	7.3	-3.7	-0.9	3.9	8.3	Helligkeitsumfang relativ zu Offset		
	10	56.2	0.0	0.1	90	63.8	-3.2	-1.2	202	7.6	-3.2	-1.3	3.6	8.4	f* = 108.1		
	11	61.4	0.0	0.1	90	69.8	-1.8	-1.5	220	8.4	-1.8	-1.6	2.5	8.7			
	12	66.7	0.0	0.1	90	75.6	-0.8	-1.6	242	9.0	-0.8	-1.7	2.0	9.2	Schwarz – Weiß		
	13	71.9	0.0	0.1	90	81.6	0.0	-1.1	270	9.7	0.0	-1.2	1.3	9.8	cmy0: N – W		
	14	77.1	0.0	0.0	90	87.1	0.0	0.0	270	10.0	0.0	0.0	0.1	10.0			
	15	82.3	0.0	0.0	90	92.1	-0.6	1.1	122	9.8	-0.6	1.1	1.3	9.8	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)		
	16	87.6	0.0	0.0	90	92.9	0.0	0.0	0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	ΔH*CIELAB = 2.1		
	17	92.8	0.0	0.0	0	92.8	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 6.3		
N	18	9.1	0.0	0.2	90	9.1	0.0	0.2	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	19	30.0	0.0	0.2	90	35.5	-2.1	-2.3	227	5.5	-2.1	-2.5	3.4	6.4			
Z	20	51.0	0.0	0.1	90	58.3	-3.7	-0.8	193	7.3	-3.7	-0.9	3.9	8.3	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)		
	21	71.9	0.0	0.1	90	81.6	0.0	-1.1	270	9.7	0.0	-1.2	1.3	9.8	ΔH*CIELAB = 1.7		
W	22	92.8	0.0	0.0	0	92.8	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 4.9		
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: R* _{ab,m} = 72																	


IG470-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1									
N	1	26.9	0.0	0.0	0	26.9	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach		
	2	31.2	0.0	0.0	0	29.2	-0.6	1.1	122	-1.9	-0.6	1.1	1.3	2.4	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G		
	3	35.5	0.0	0.0	0	31.4	-1.5	1.0	148	-4.0	-1.5	1.0	1.9	4.5	und DIN 33866-1:2000 Anhang G		
	4	39.8	0.0	0.0	0	34.1	-1.7	0.5	164	-5.6	-1.7	0.5	1.9	6.0	relative CIELAB Daten für "aus"		
	5	44.1	0.0	0.0	0	36.2	-1.9	2.0	135	-7.7	-1.9	2.0	2.8	8.3	ΔL* = 95.41 - 26.94		
	6	48.3	0.0	0.0	0	38.8	-1.7	2.1	131	-9.4	-1.7	2.1	2.8	9.9	Gleichmäßigkeit		
	7	52.6	0.0	0.0	0	42.6	-1.3	3.0	115	-9.9	-1.3	3.0	3.3	10.6	g* = 36.6		
	8	56.9	0.0	0.0	0	47.3	-2.5	4.6	119	-9.5	-2.5	4.6	5.3	11.0			
Z	9	61.2	0.0	0.0	0	51.9	-1.7	6.1	106	-9.2	-1.7	6.1	6.4	11.3	Helligkeitsumfang relativ zu Offset		
	10	65.5	0.0	0.0	0	56.7	-1.3	7.2	101	-8.6	-1.3	7.2	7.3	11.4	f* = 88.5		
	11	69.7	0.0	0.0	0	61.3	-0.7	7.2	96	-8.3	-0.7	7.2	7.2	11.1			
	12	74.0	0.0	0.0	0	65.4	-0.8	6.5	98	-8.6	-0.8	6.5	6.6	10.9	Schwarz - Weiß		
	13	78.3	0.0	0.0	0	70.0	-0.3	6.3	94	-8.2	-0.3	6.3	6.3	10.4	cmy0: N - W		
	14	82.6	0.0	0.0	0	75.3	-0.1	5.9	92	-7.2	-0.1	5.9	5.9	9.4			
	15	86.9	0.0	0.0	0	80.8	-1.2	5.2	104	-6.0	-1.2	5.2	5.4	8.1	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)		
	16	91.1	0.0	0.0	0	85.1	0.3	1.9	81	-5.9	0.3	1.9	1.9	6.3	ΔH*CIELAB = 3.9		
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 7.7		
N	18	26.9	0.0	0.0	0	26.9	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	19	44.1	0.0	0.0	0	36.2	-1.9	2.0	135	-7.7	-1.9	2.0	2.8	8.3			
Z	20	61.2	0.0	0.0	0	51.9	-1.7	6.1	106	-9.2	-1.7	6.1	6.4	11.3	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)		
	21	78.3	0.0	0.0	0	70.0	-0.3	6.3	94	-8.2	-0.3	6.3	6.3	10.4	ΔH*CIELAB = 3.1		
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 6.0		
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: R* _{ab,m} = 66																	

IG471-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

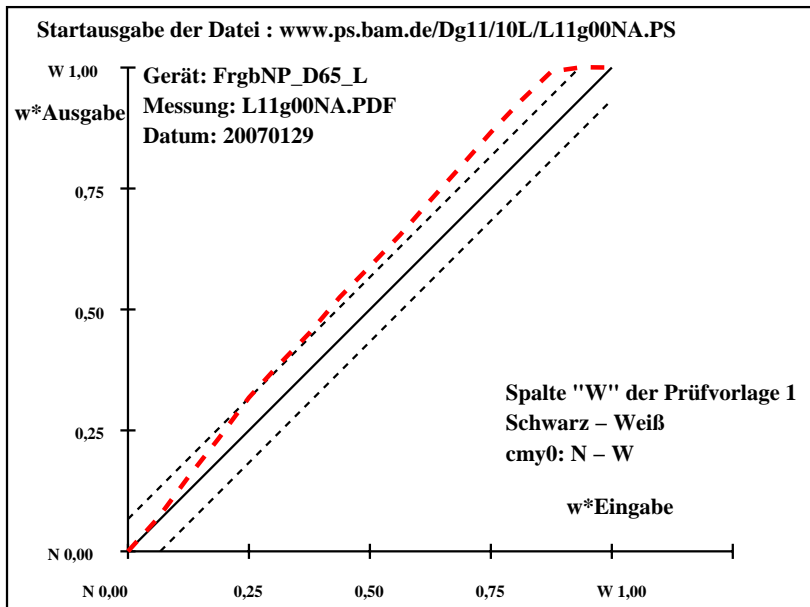

IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

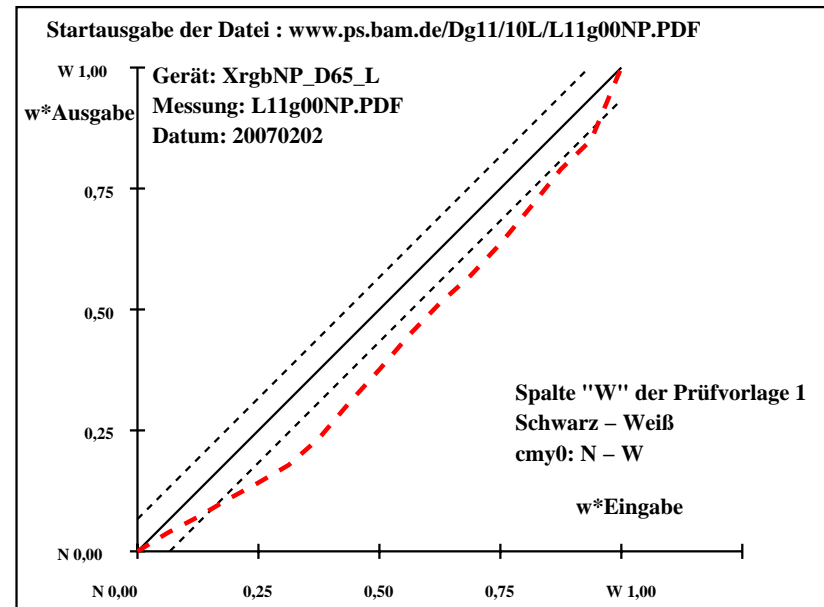


IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1									
N	1	8.7	0.0	0.0	0	8.7	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	13.9	0.0	0.0	0	13.9	0.7	-2.5	285	0.0	0.7	-2.5	2.7	2.7				
	3	19.1	0.0	0.0	0	20.8	-0.2	-3.9	266	1.6	-0.2	-3.9	4.0	4.3				
	4	24.4	0.0	0.0	0	27.4	-1.8	-3.0	238	3.0	-1.8	-3.0	3.6	4.7				
	5	29.6	0.0	0.0	0	34.4	-2.2	-3.4	237	4.7	-2.2	-3.4	4.2	6.3				
	6	34.9	0.0	0.0	0	40.2	-2.7	-1.7	213	5.3	-2.7	-1.7	3.3	6.2				
	7	40.1	0.0	0.0	0	45.9	-3.1	-1.5	207	5.7	-3.1	-1.5	3.6	6.7				
	8	45.4	0.0	0.0	0	52.0	-3.9	-1.1	197	6.6	-3.9	-1.1	4.2	7.8				
Z	9	50.6	0.0	0.0	0	57.5	-3.9	-1.5	202	6.9	-3.9	-1.5	4.3	8.1				
	10	55.9	0.0	0.0	0	63.4	-3.1	-1.9	212	7.5	-3.1	-1.9	3.8	8.4				
	11	61.1	0.0	0.0	0	69.1	-1.8	-2.1	229	8.0	-1.8	-2.1	2.9	8.5				
	12	66.4	0.0	0.0	0	75.2	-0.6	-2.1	252	8.9	-0.6	-2.1	2.3	9.1				
	13	71.6	0.0	0.0	0	81.2	0.1	-1.4	274	9.6	0.1	-1.4	1.5	9.7				
	14	76.9	0.0	0.0	0	86.9	0.0	-0.1	270	10.0	0.0	-0.1	0.2	10.0				
	15	82.1	0.0	0.0	0	92.0	-0.7	1.1	126	9.9	-0.7	1.1	1.4	10.0				
	16	87.4	0.0	0.0	0	92.7	0.0	0.0	0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3				
	17	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
W	18	8.7	0.0	0.0	0	8.7	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	19	29.6	0.0	0.0	0	34.4	-2.2	-3.4	237	4.7	-2.2	-3.4	4.2	6.3				
Z	20	50.6	0.0	0.0	0	57.5	-3.9	-1.5	202	6.9	-3.9	-1.5	4.3	8.1				
	21	71.6	0.0	0.0	0	81.2	0.1	-1.4	274	9.6	0.1	-1.4	1.5	9.7				
W	22	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 72$								


IG470-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1									
N	1	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	26.3	0.0	0.0	0	22.6	0.0	0.0	0	-3.5	0.0	0.0	0.0	3.6				
	3	30.9	0.0	0.0	0	24.8	0.0	0.1	90	-5.9	0.0	0.1	0.1	6.0				
	4	35.5	0.0	0.0	0	29.1	0.0	0.0	0	-6.3	0.0	0.0	0.0	6.4				
	5	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0	0	-5.3	0.0	0.0	0.0	5.4				
	6	44.7	0.0	0.0	0	40.8	0.0	0.0	0	-3.8	0.0	0.0	0.0	3.9				
	7	49.3	0.0	0.0	0	45.6	0.0	0.2	90	-3.6	0.0	0.2	0.2	3.7				
	8	53.9	0.0	0.0	0	52.5	0.0	0.1	90	-1.3	0.0	0.1	0.1	1.4				
Z	9	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.0	0.2	90	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2				
	10	63.2	0.0	0.0	0	64.5	0.0	0.2	90	1.3	0.0	0.2	0.2	1.3				
	11	67.8	0.0	0.0	0	69.4	0.0	0.2	90	1.6	0.0	0.2	0.2	1.6				
	12	72.4	0.0	0.0	0	74.3	0.0	0.2	90	1.9	0.0	0.2	0.2	1.9				
	13	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.0	0.1	90	2.1	0.0	0.1	0.1	2.1				
	14	81.6	0.0	0.0	0	83.0	0.0	0.0	0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4				
	15	86.2	0.0	0.0	0	86.4	0.0	0.1	90	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2				
	16	90.8	0.0	0.0	0	89.7	0.0	0.2	90	-1.1	0.0	0.2	0.2	1.2				
	17	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
W	18	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	19	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0	0	-5.3	0.0	0.0	0.0	5.4				
Z	20	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.0	0.2	90	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2				
	21	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.0	0.1	90	2.1	0.0	0.1	0.1	2.1				
W	22	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 90$								

IG471-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202

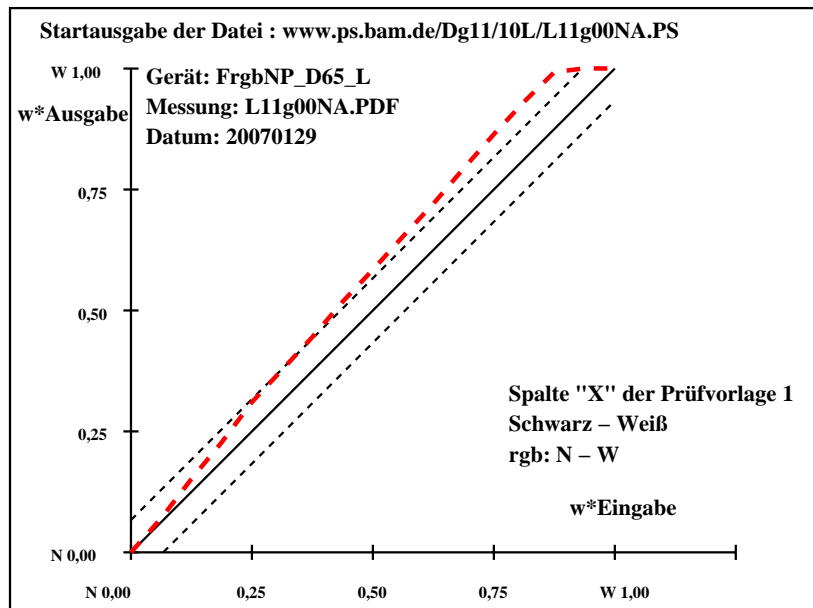

IG470-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NA.PDF; Datum: 20070129

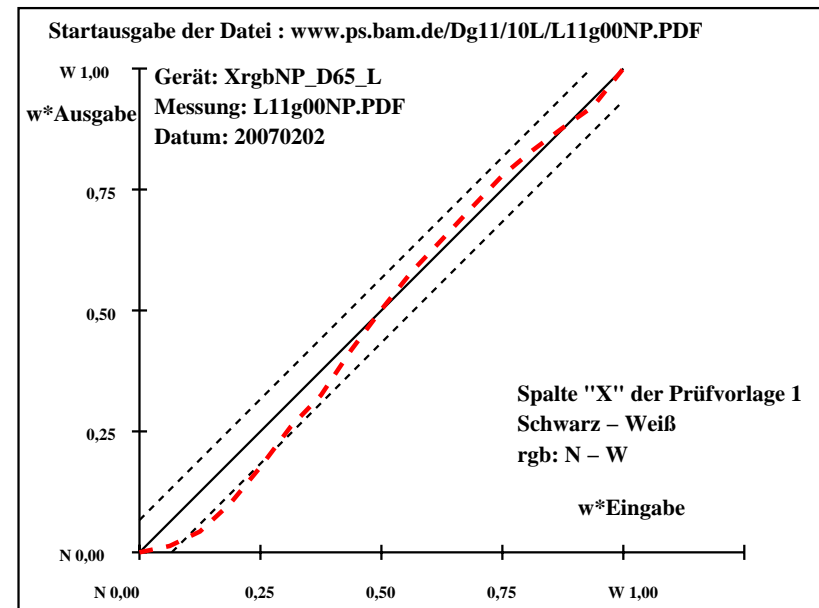

IG471-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L11g00NP.PDF; Datum: 20070202