


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF40/PF40.PDF> /[PF40L0NP.PDF](http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF40/PF40L0NP.PDF) /[.PS](http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF40/PF40L0NP.PDF)
 informations techniques: <http://www.ps.bann.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

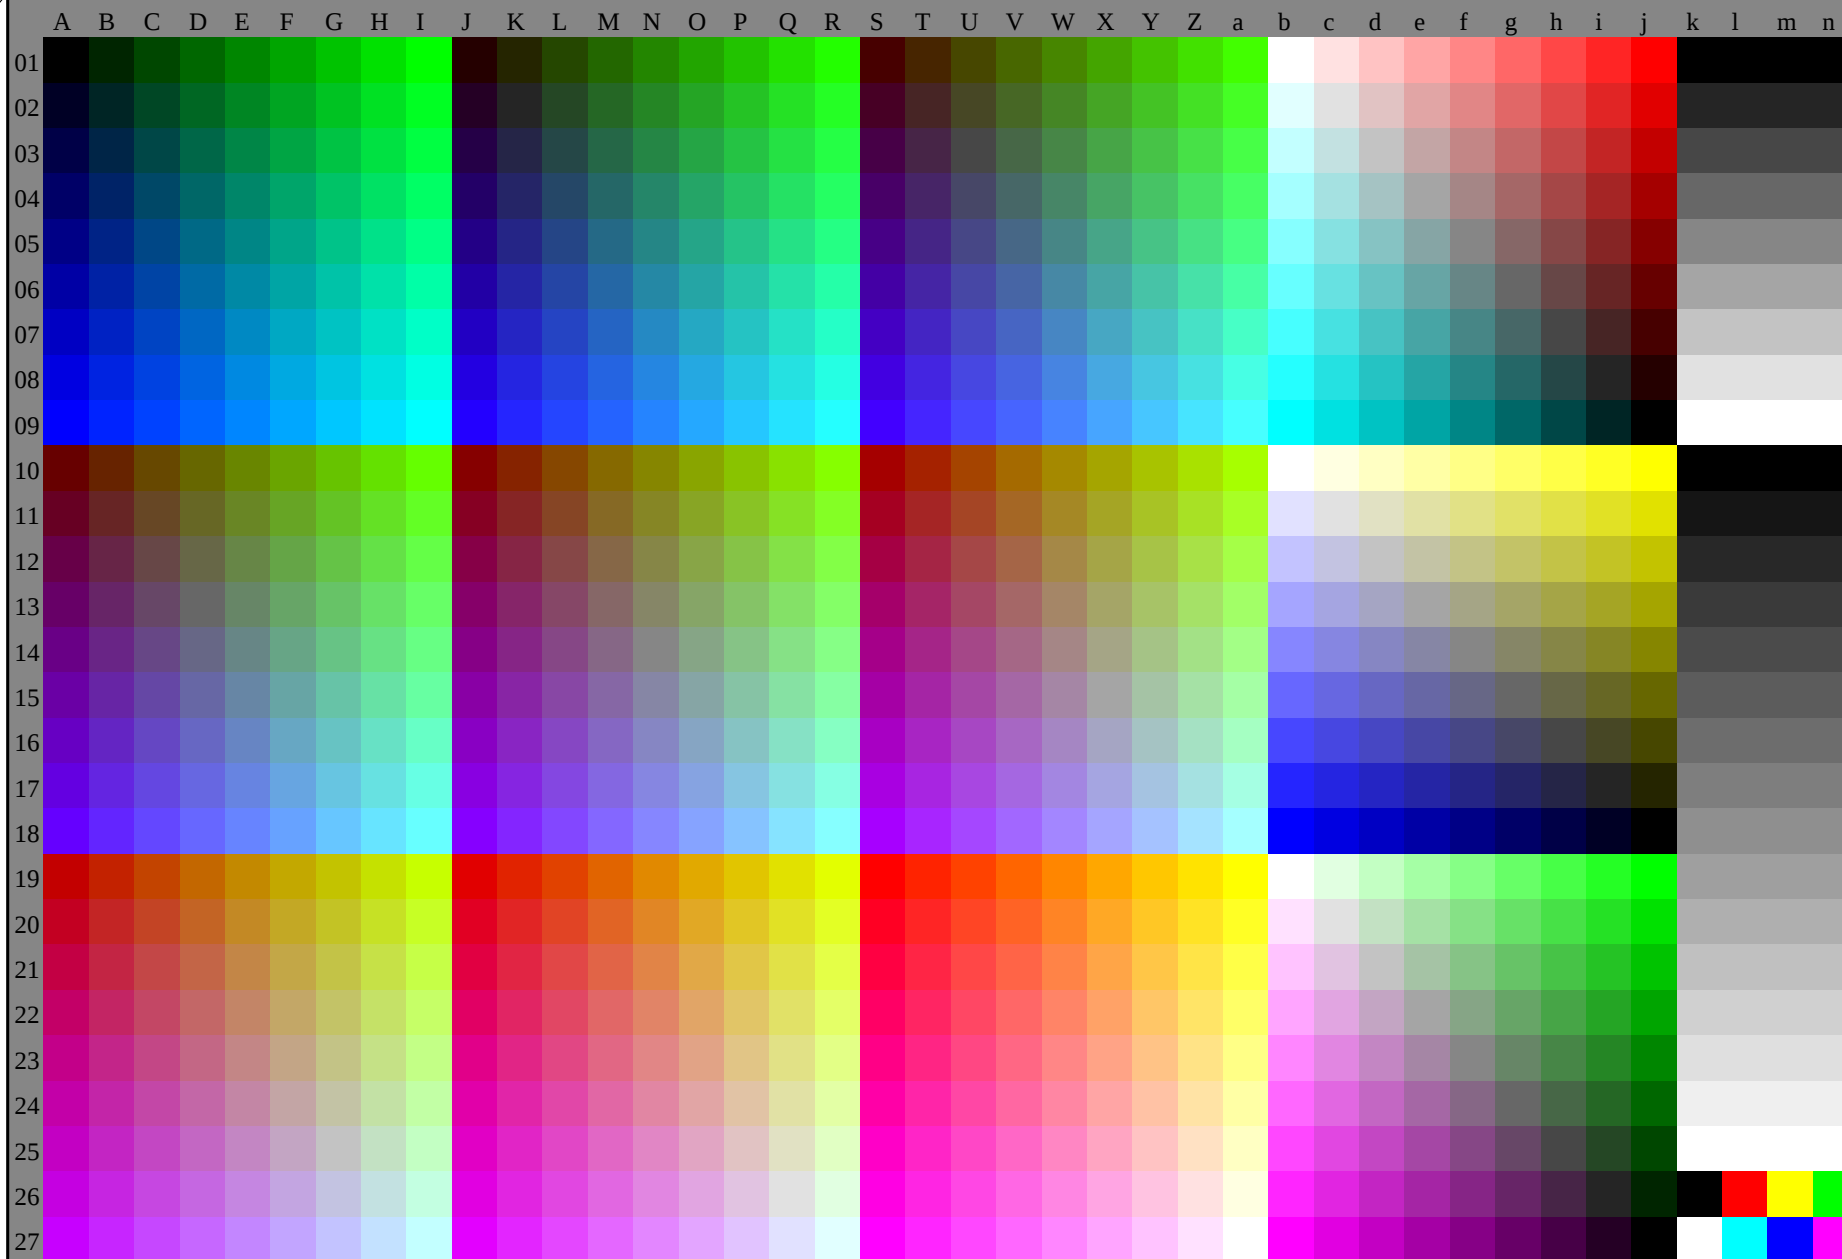

TUB enregistrement: 20130201-PF40/PF40L0NP.PDF /.PS
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=th4ta

3-003130-L0

PF400-70

Test chart G with 40x27=1080 colours; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; Colour data in column (A-n): $rgb(A_n)$, 3D = 0

graphique TUB-PF40; échantillon pour le test
 1080 couleur de norme, 3D=0, de=0, sRGB

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 sortie : transférer à rgb_d

3-003130-F0

C

M

Y

O

L

V

C