


TUB enregistrement: 20130201-PF40/PF40L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran


TUB matériel: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF40/PF40L0NP.PDF /.PS; sortie de production

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 1/2

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF40/PF40.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

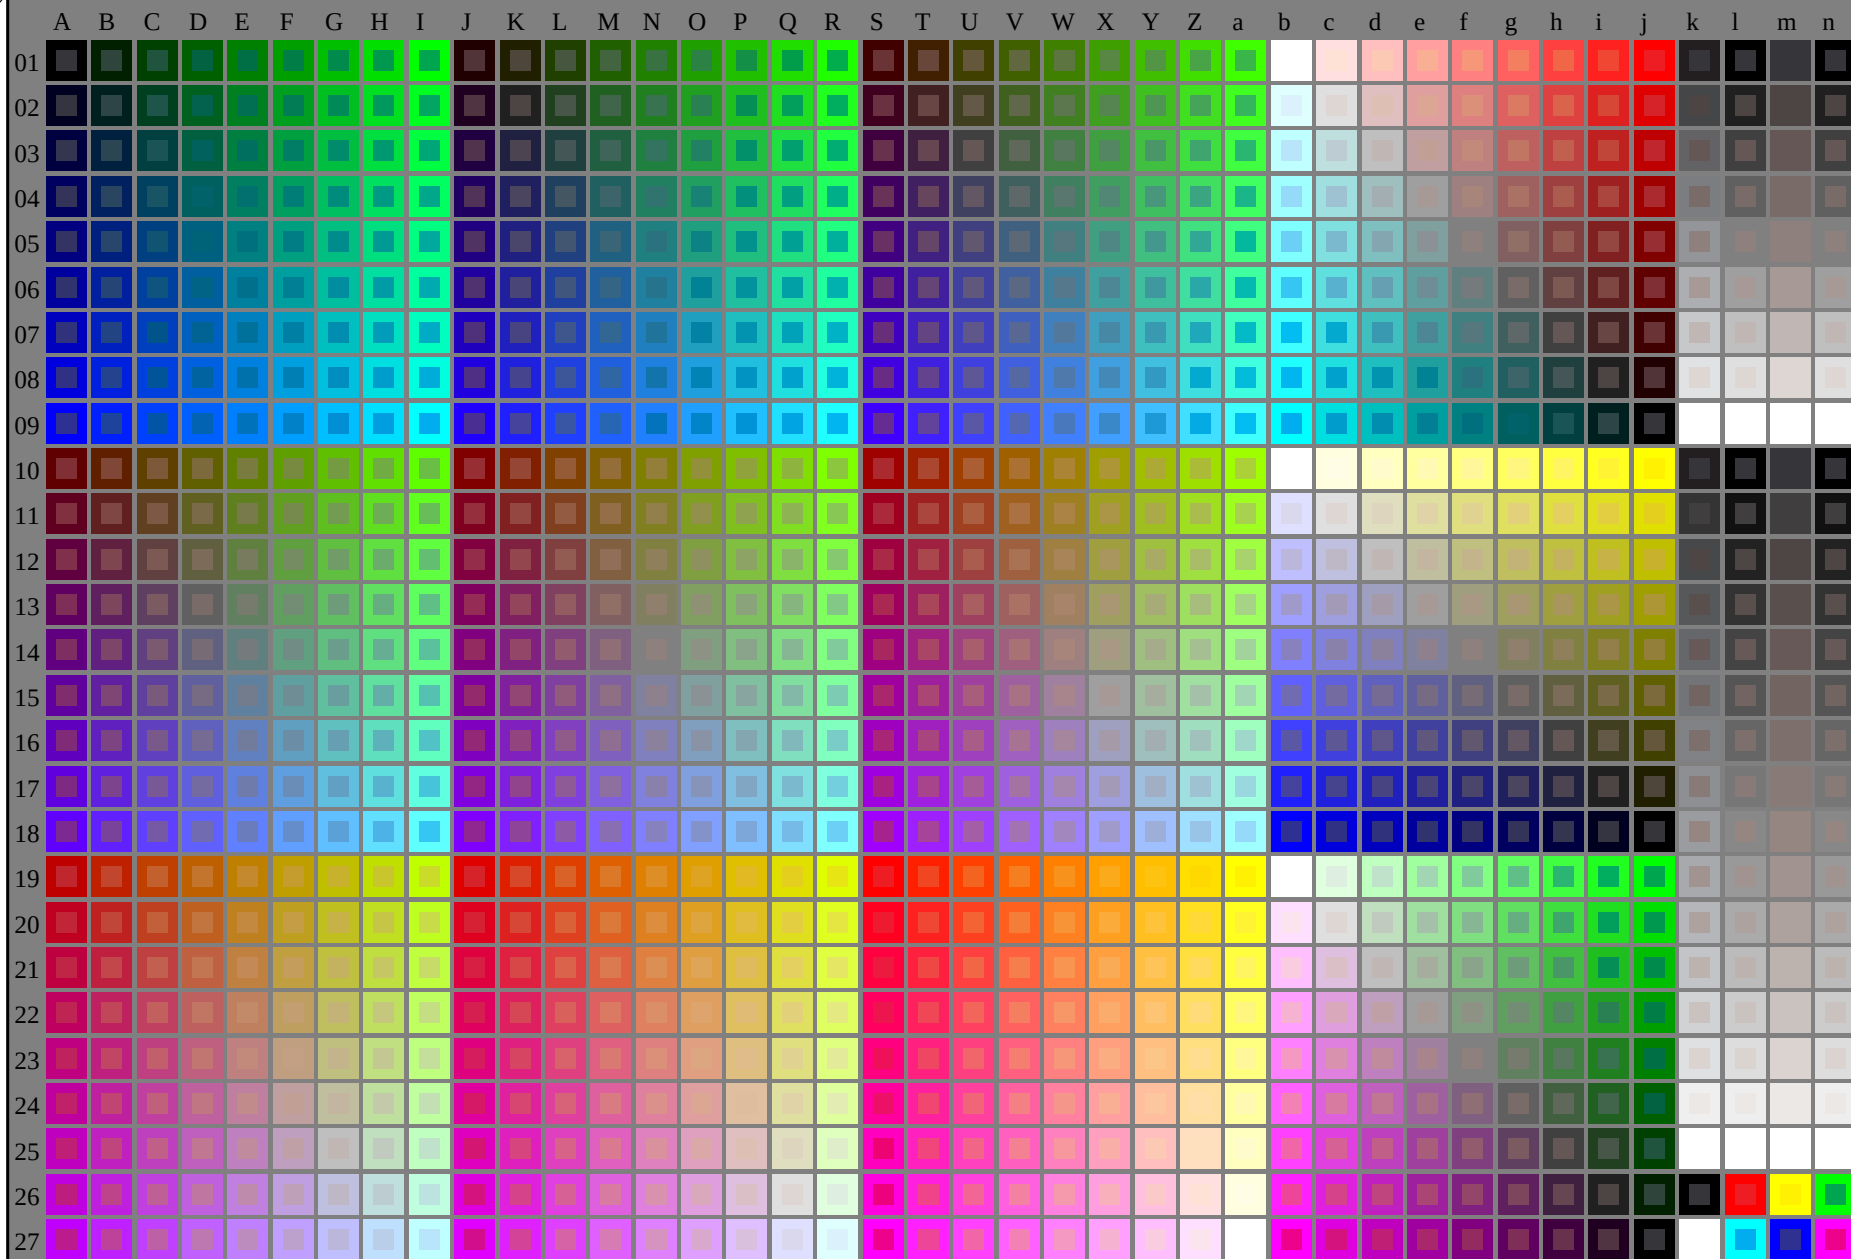

3-003030-L0

PF400-7N

Test chart G with 40x27=1080 colours; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; Colour data in column (A-n): rgb + cmy0 (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

graphique TUB-PF40; échantillon pour le test
1080 couleur de norme; image informatique

entrée : rgb/cmyk -> rgb/cmyk
sortie : aucun changement

C

M

Y

O

L

V

V

L

O

Y

M

C