


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF43/PF43.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

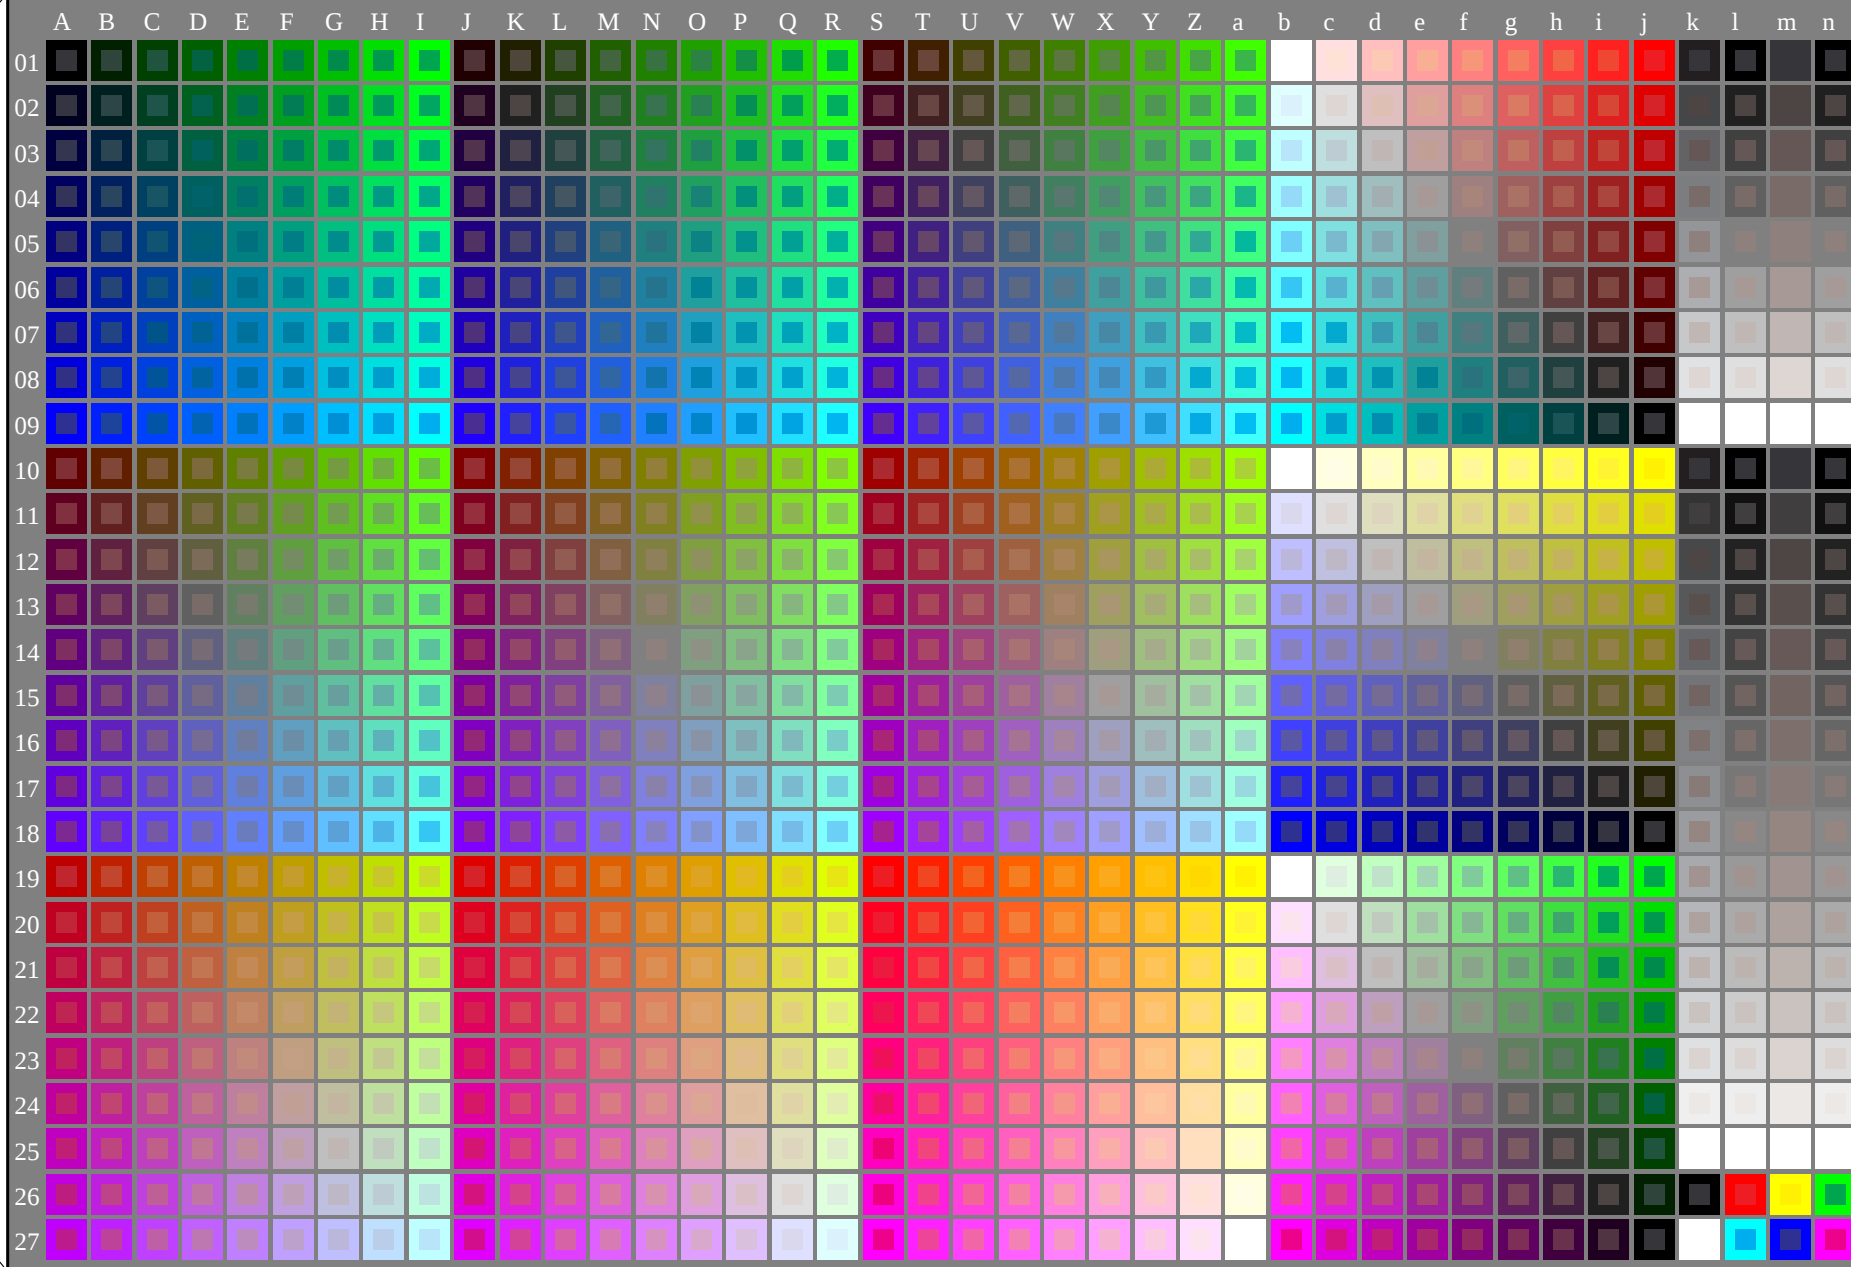

TUB enregistrement: 20130201-PF43/PF43L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rha4ta

3-003030-L0

PF430-7N

Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): **rgb** (A_j+k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n) + cmy0(all)

graphique TUB-PF43; échantillon pour le test
1080 couleur de norme; image informatique

entrée : **rgb/cmyk** -> **rgb/cmyk**
sortie : aucun changement