


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF46/PF46L0FA.TXT>

informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

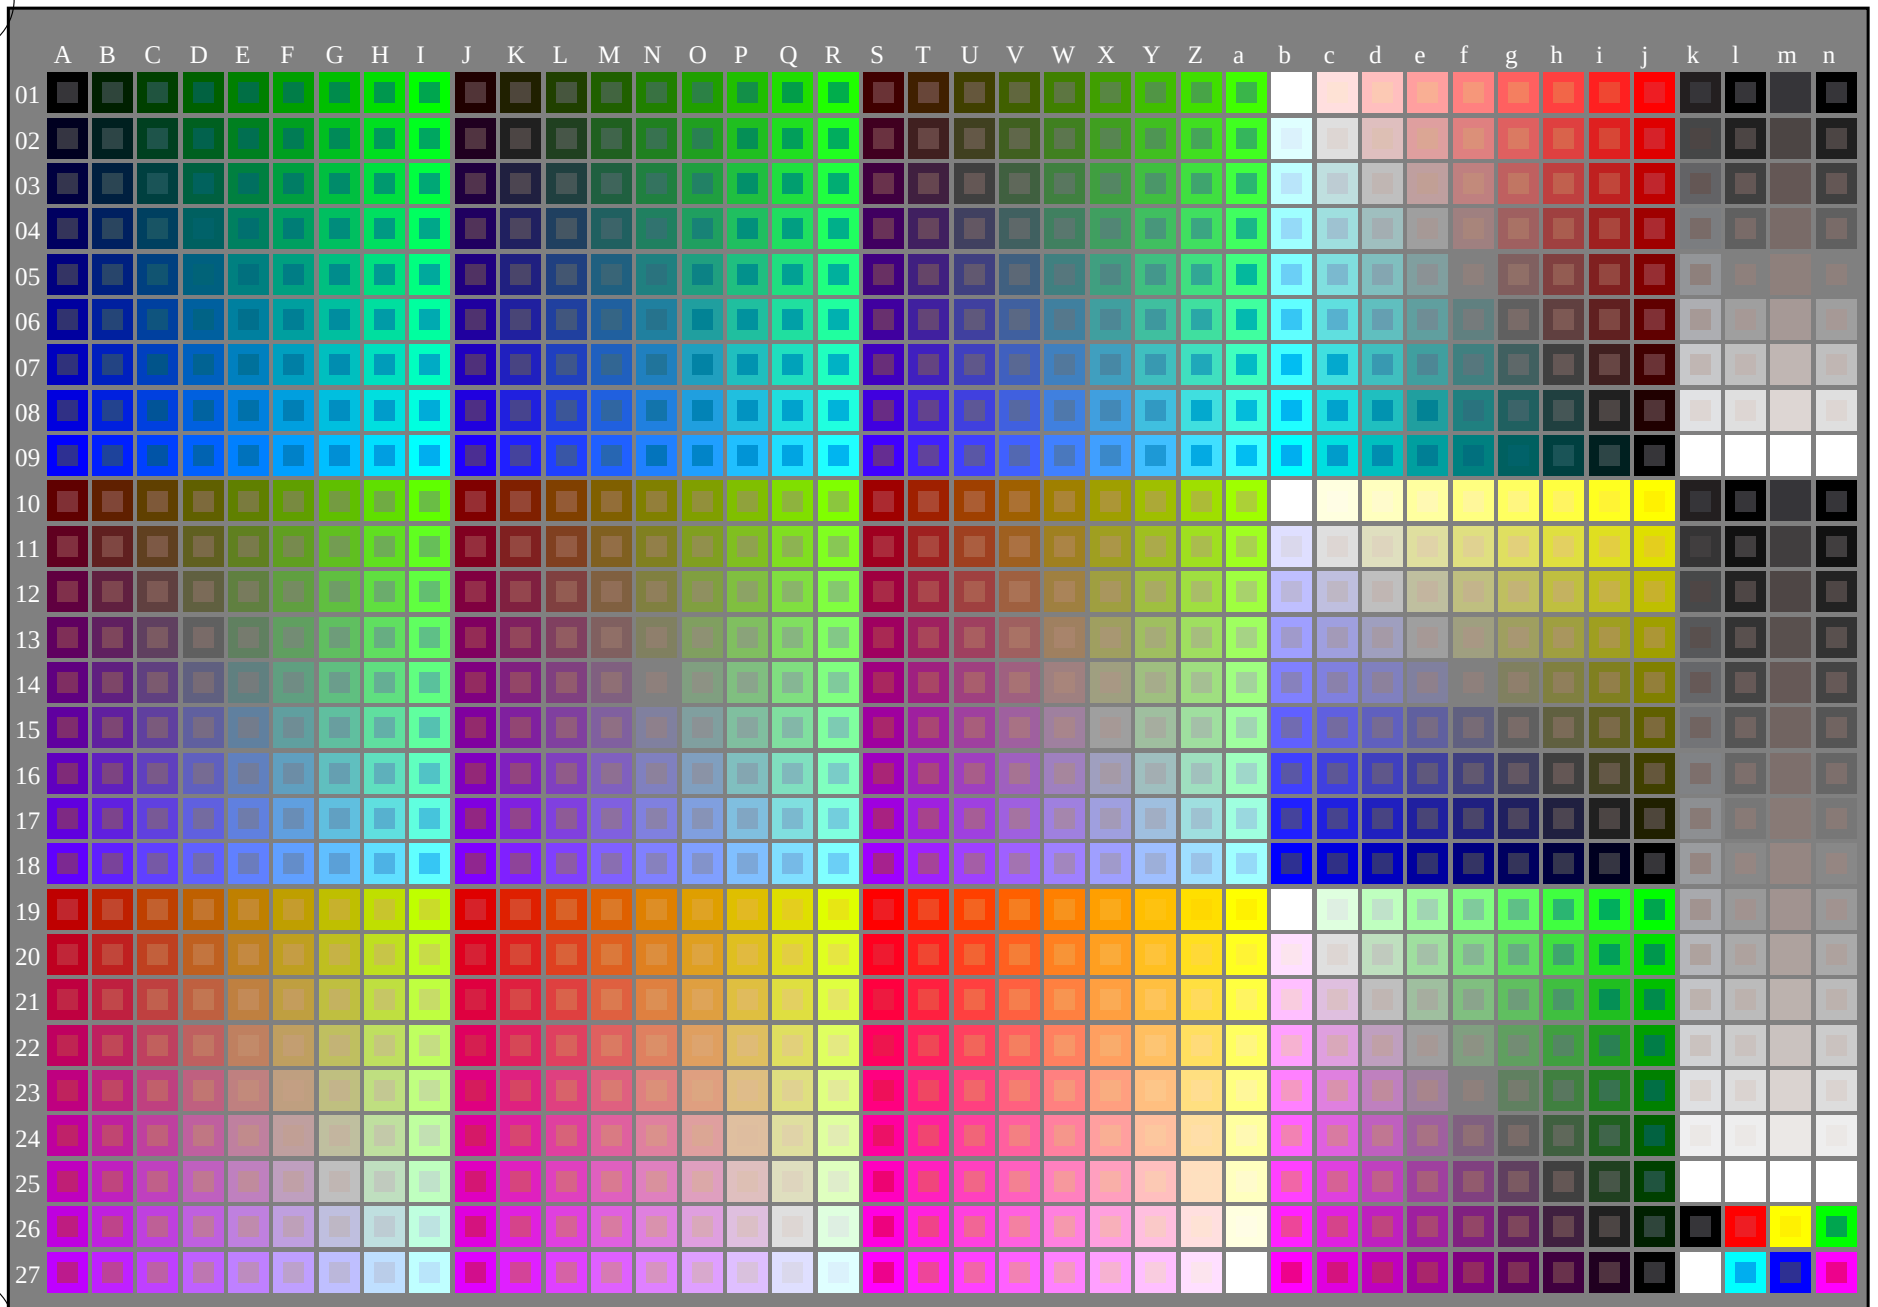

3-103031-L0

PF460-7N

Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): **rgb** (A_j+k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n) + cmy0(all)

graphique TUB-PF46; échantillon pour le test

1080 couleur de norme; image informatique



entrée : **rgb/cmyk** -> **rgb/cmyk**

sortie : aucun changement



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF46/PF46L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF46/PF46L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

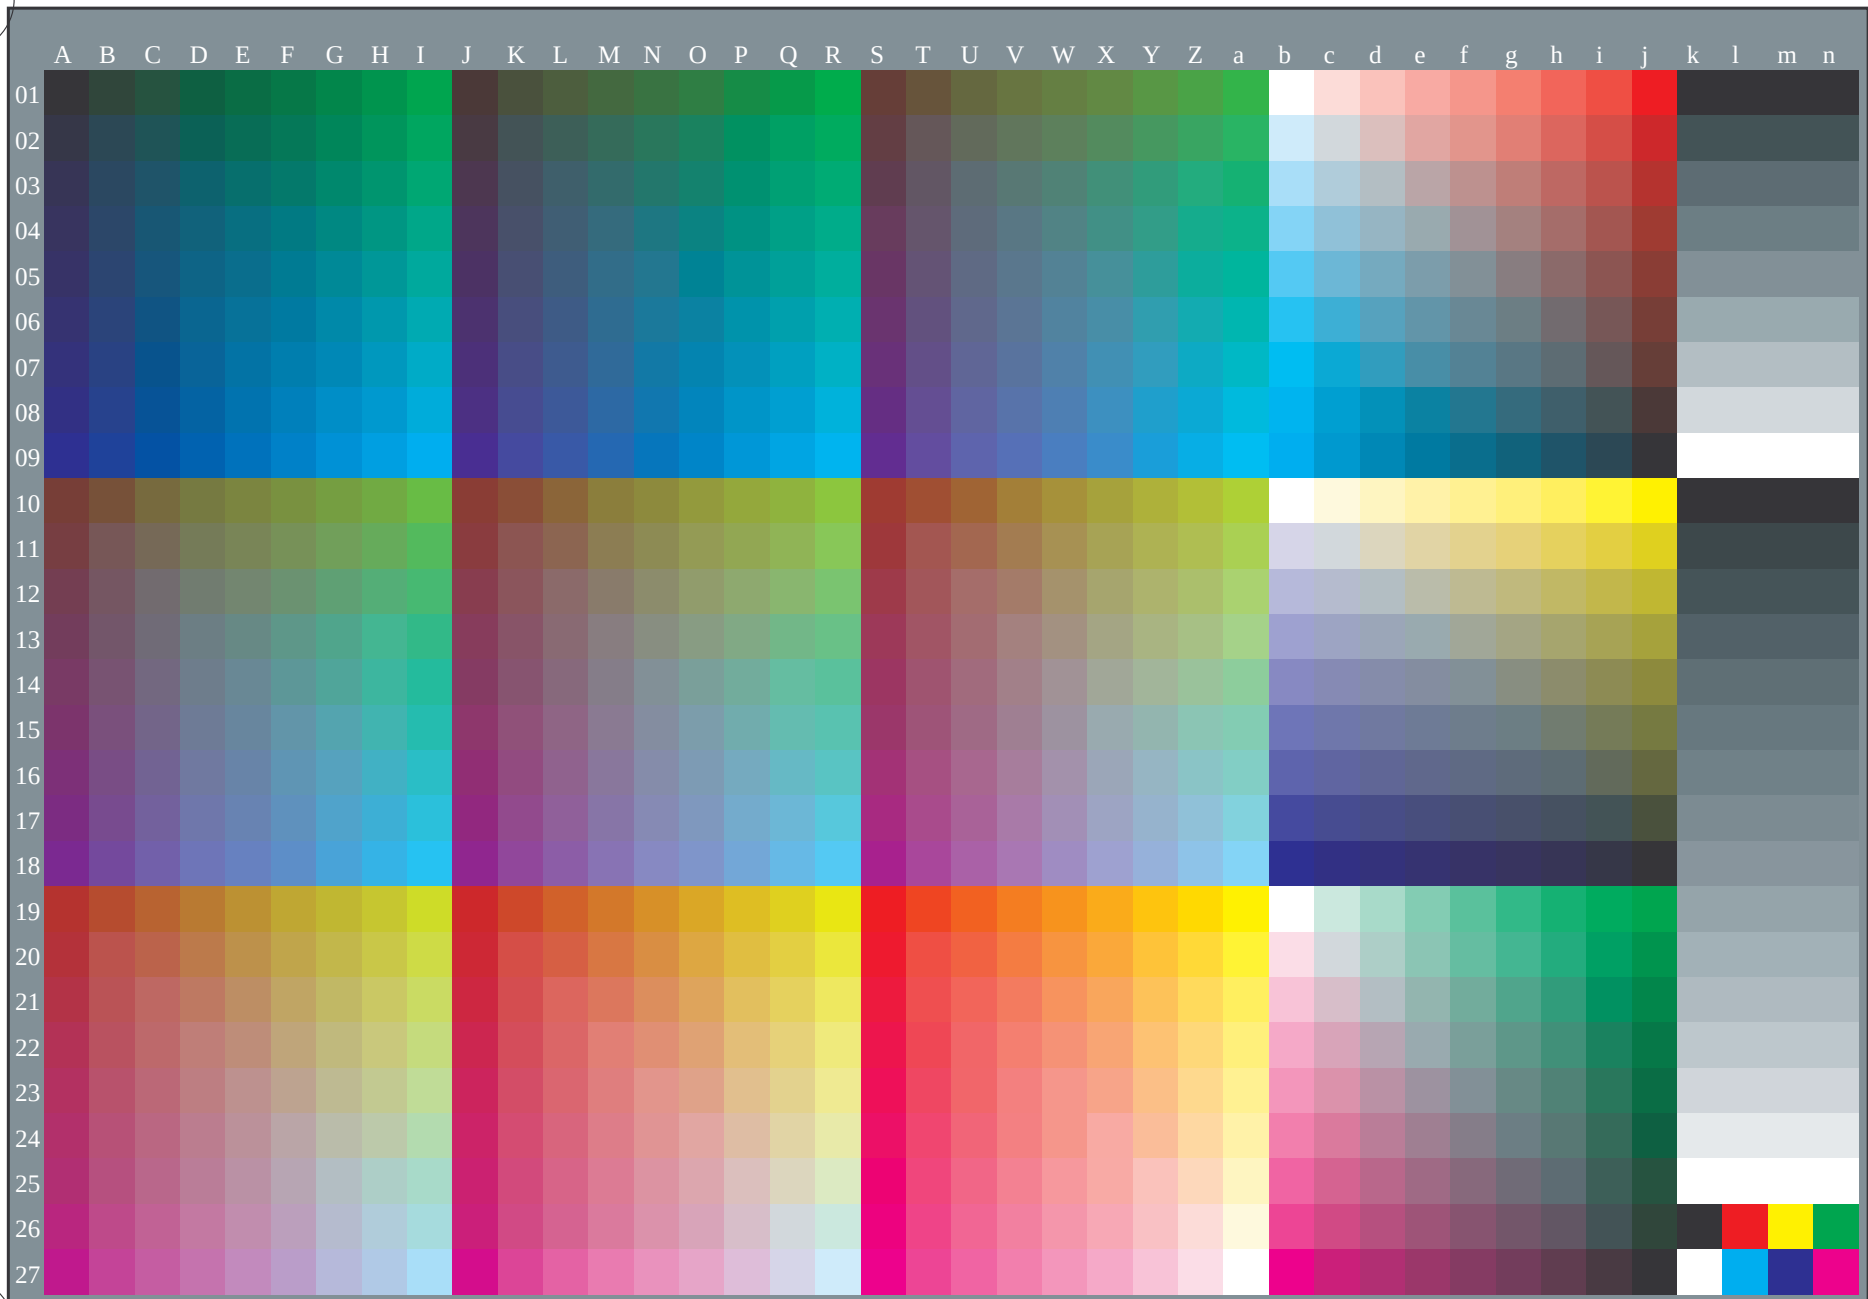

3-103131-L0

PF460-72

graphique TUB-PF46; échantillon pour le test
1080 couleur de norme, 3D=1, de=0, cmy0*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmy0*_{dd}*

3-103131-F0

C

M


Y

O

L




V

C



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF46/PF46L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF46/PF46L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset
TUB matériel: code=rha4ta

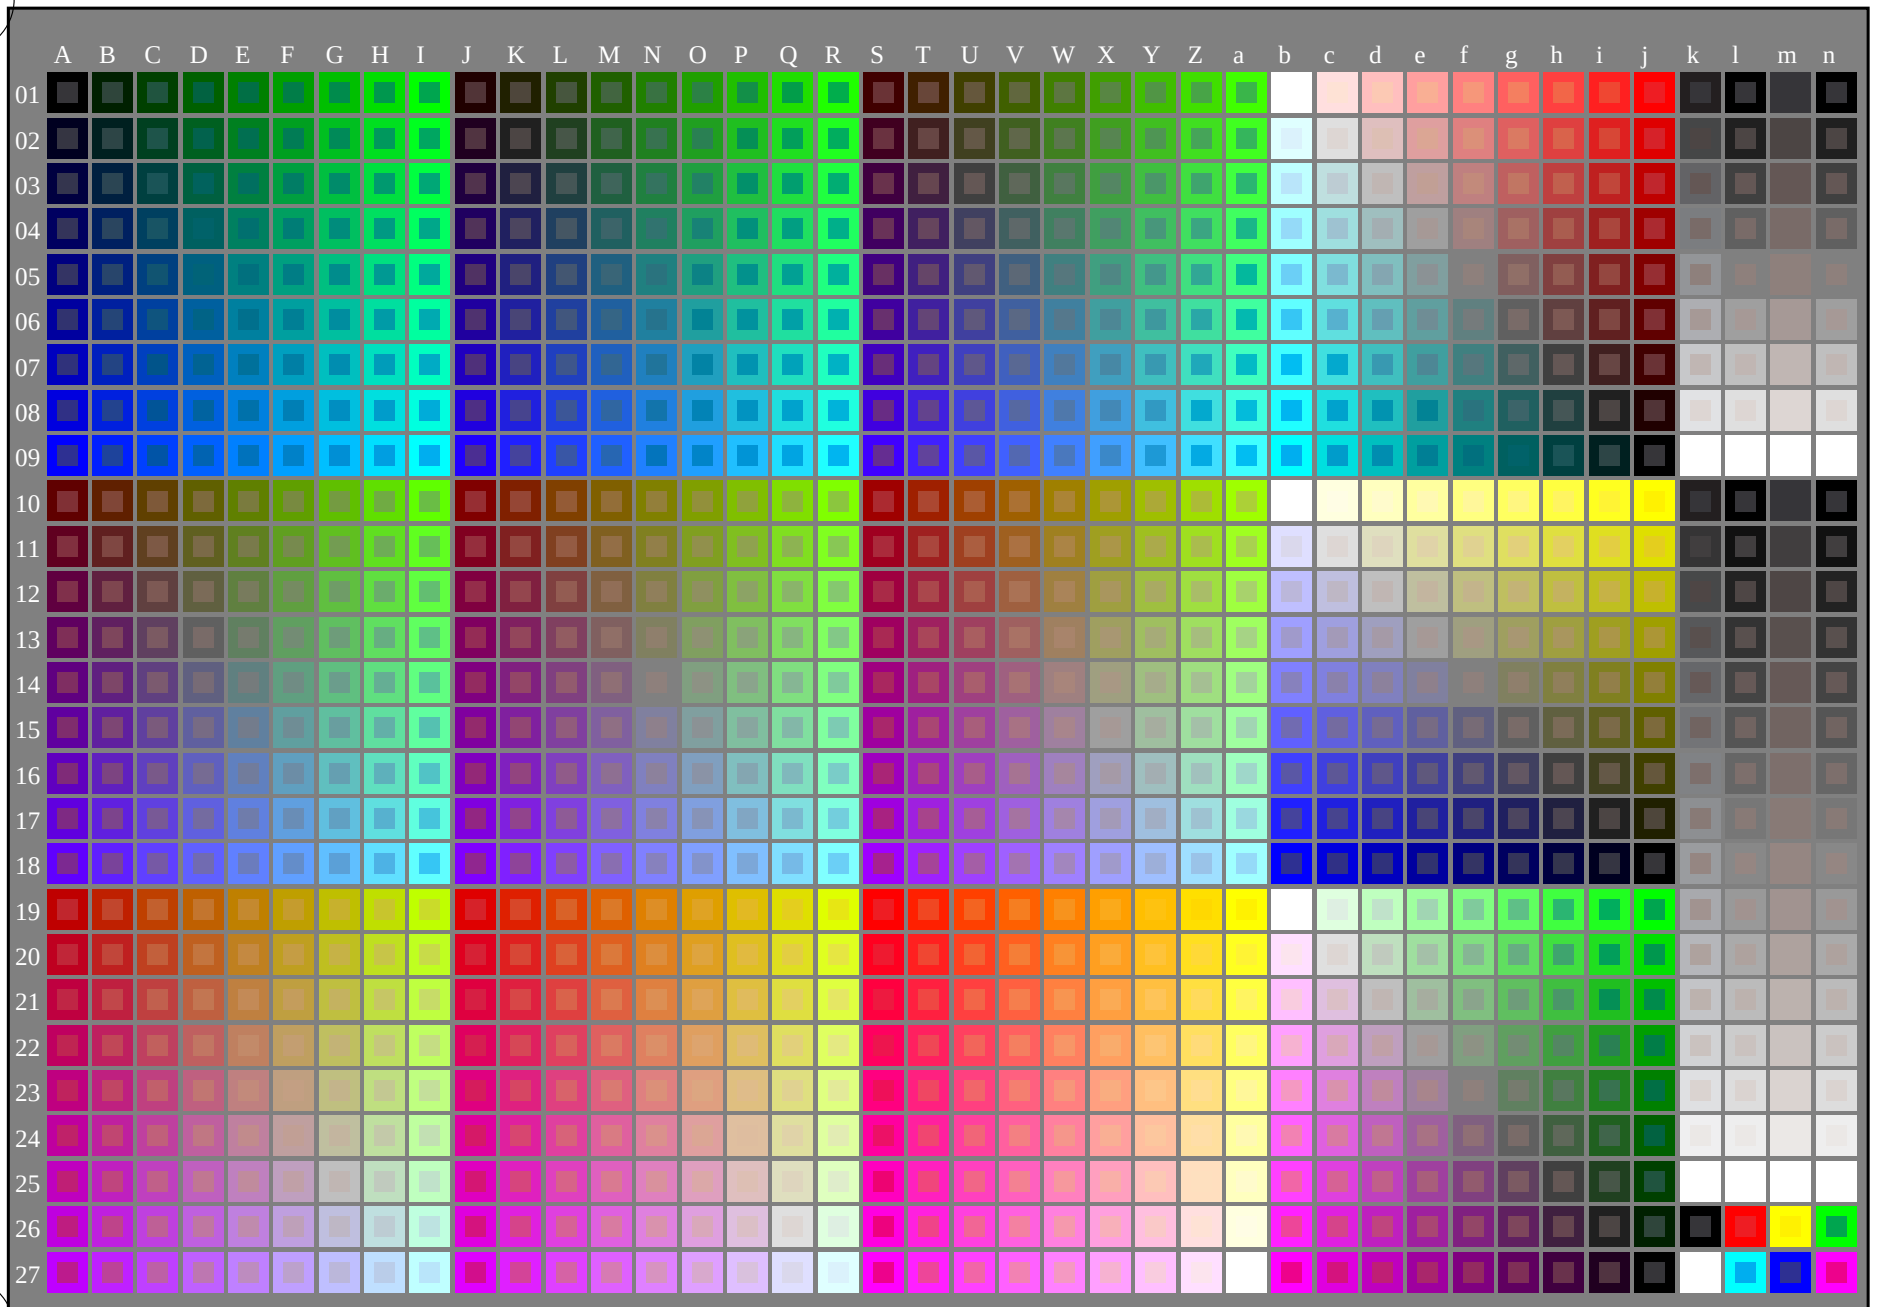

3-113031-L0

PF460-7N

Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): **rgb** (A_j+k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n) + cmy0(all)


graphique TUB-PF46; échantillon pour le test
1080 couleur de norme; image informatique

entrée : **rgb/cmyk** -> **rgb/cmyk**
sortie : aucun changement

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF46/PF46L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF46/PF46LF30FA.DAT dans fichier (F), page 2/2

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF46/PF46L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF46/PF46L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

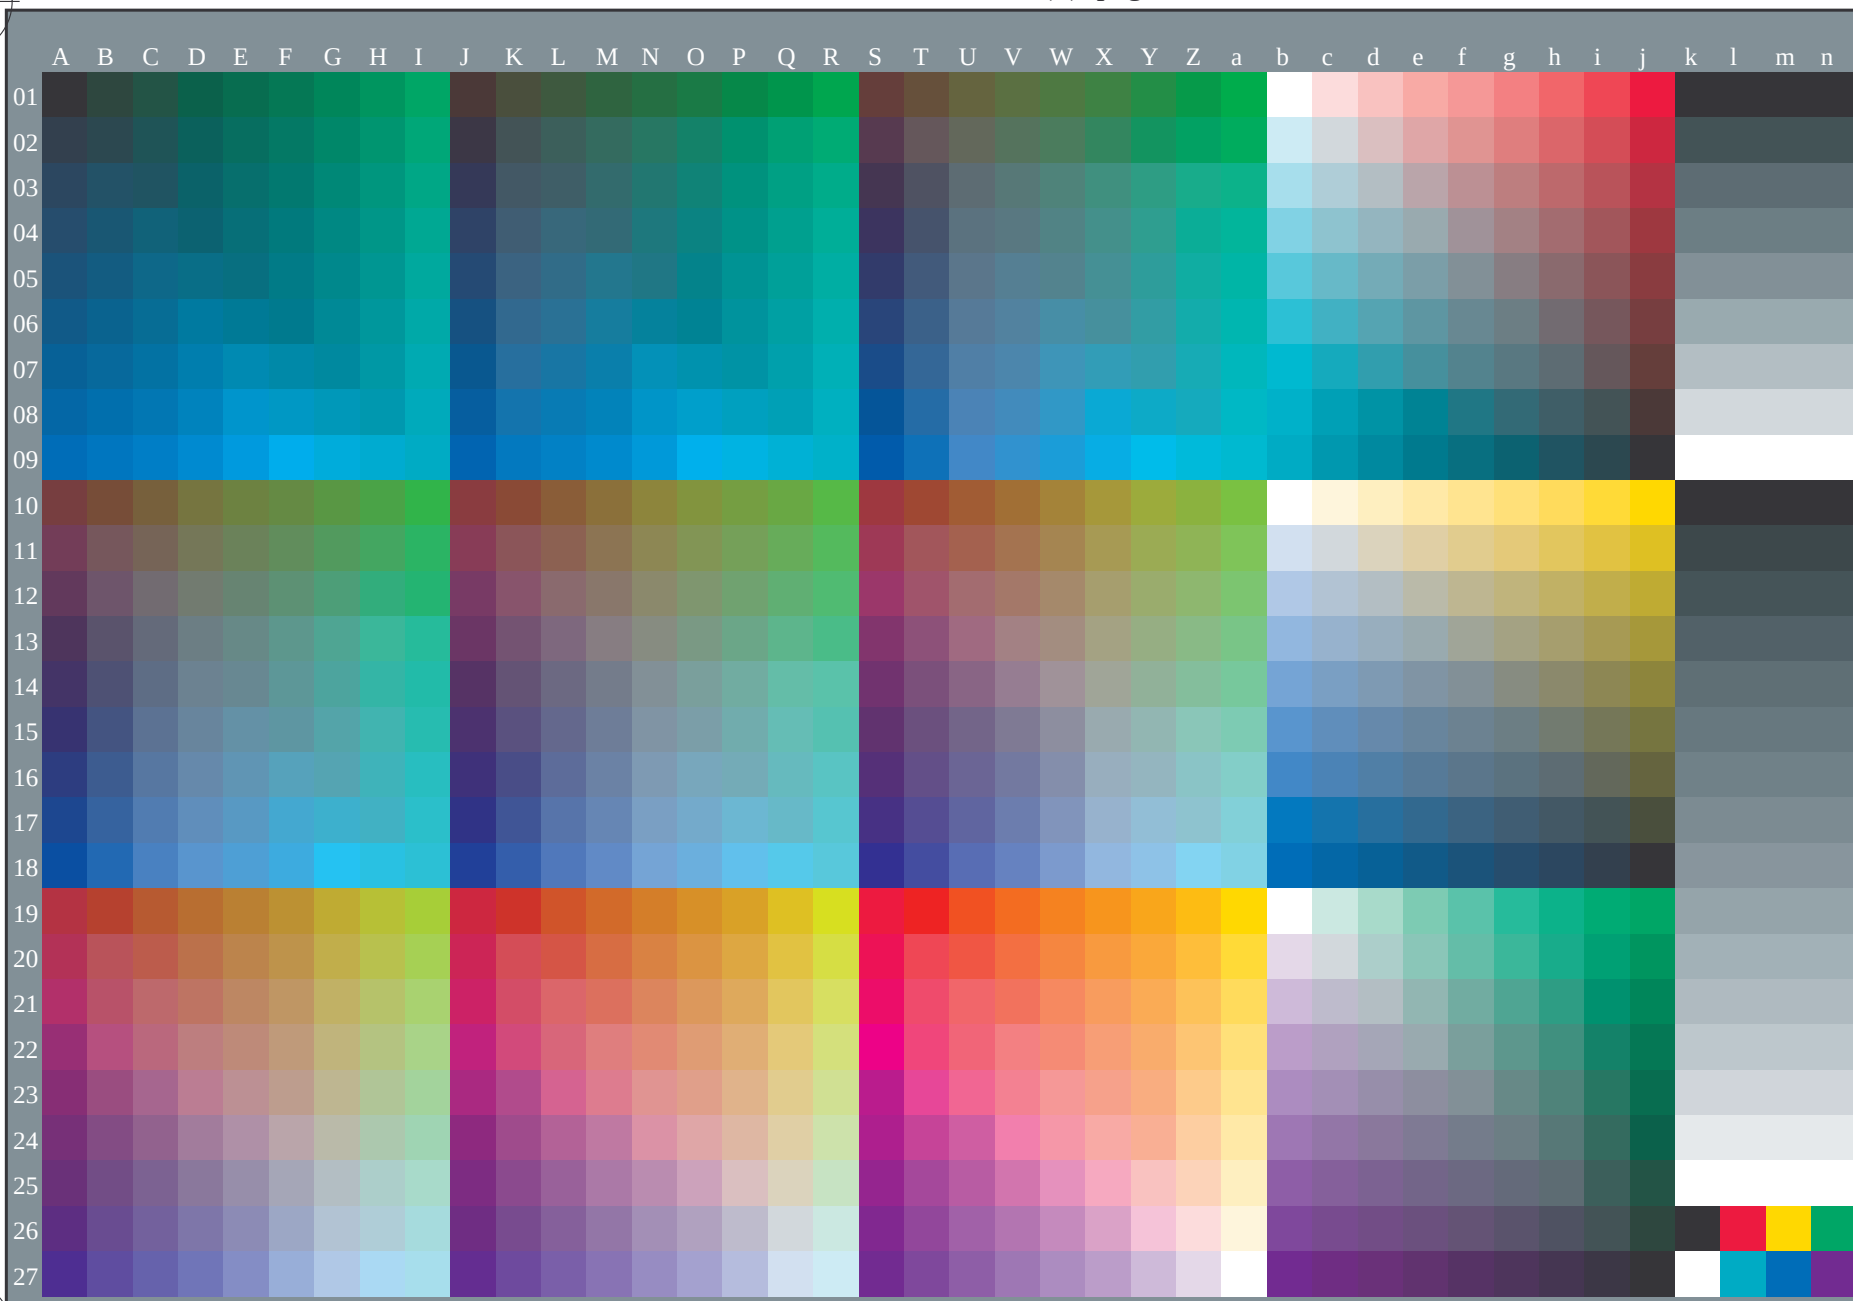

3-113131-L0

PF460-73

graphique TUB-PF46; échantillon pour le test
1080 couleur de norme, 3D=1, de=1, cmy0*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmy0*_{de}*

3-113131-F0

C

M

Y

O

L

V

C