




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF46/PF46.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF46/PF46L0NP.PDF /.PS
 application pour la mesure des sorties sur offset
 TUB matériel: code=rha4ta

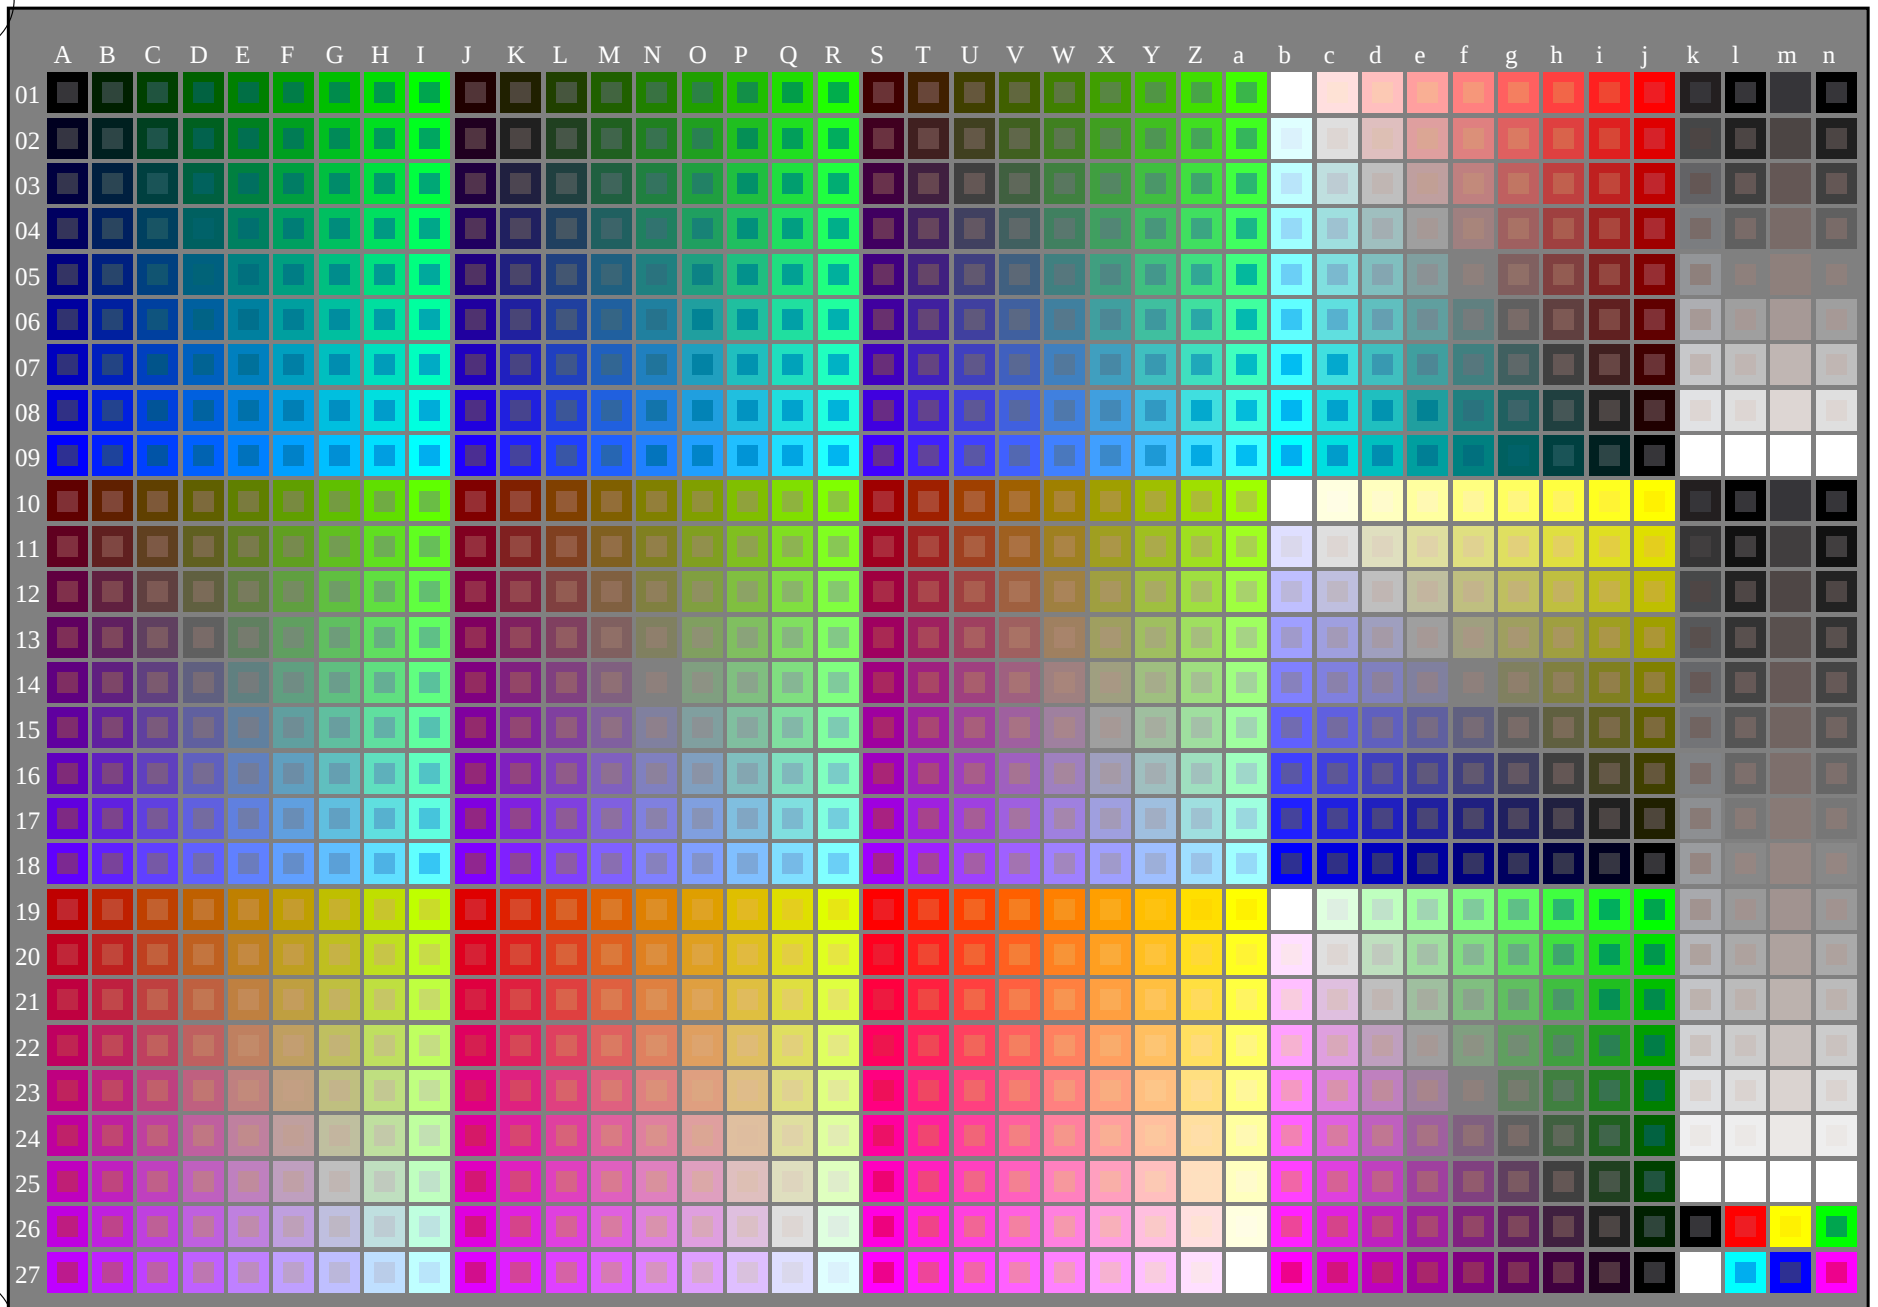

3-003031-L0

PF460-7N


Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): **rgb (A_j+k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n) + cmy0(all)**

graphique TUB-PF46; échantillon pour le test
 1080 couleur de norme; image informatique

entrée : **rgb/cmyk** -> **rgb/cmyk**
 sortie : aucun changement

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF46/PF46.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF46/PF46L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

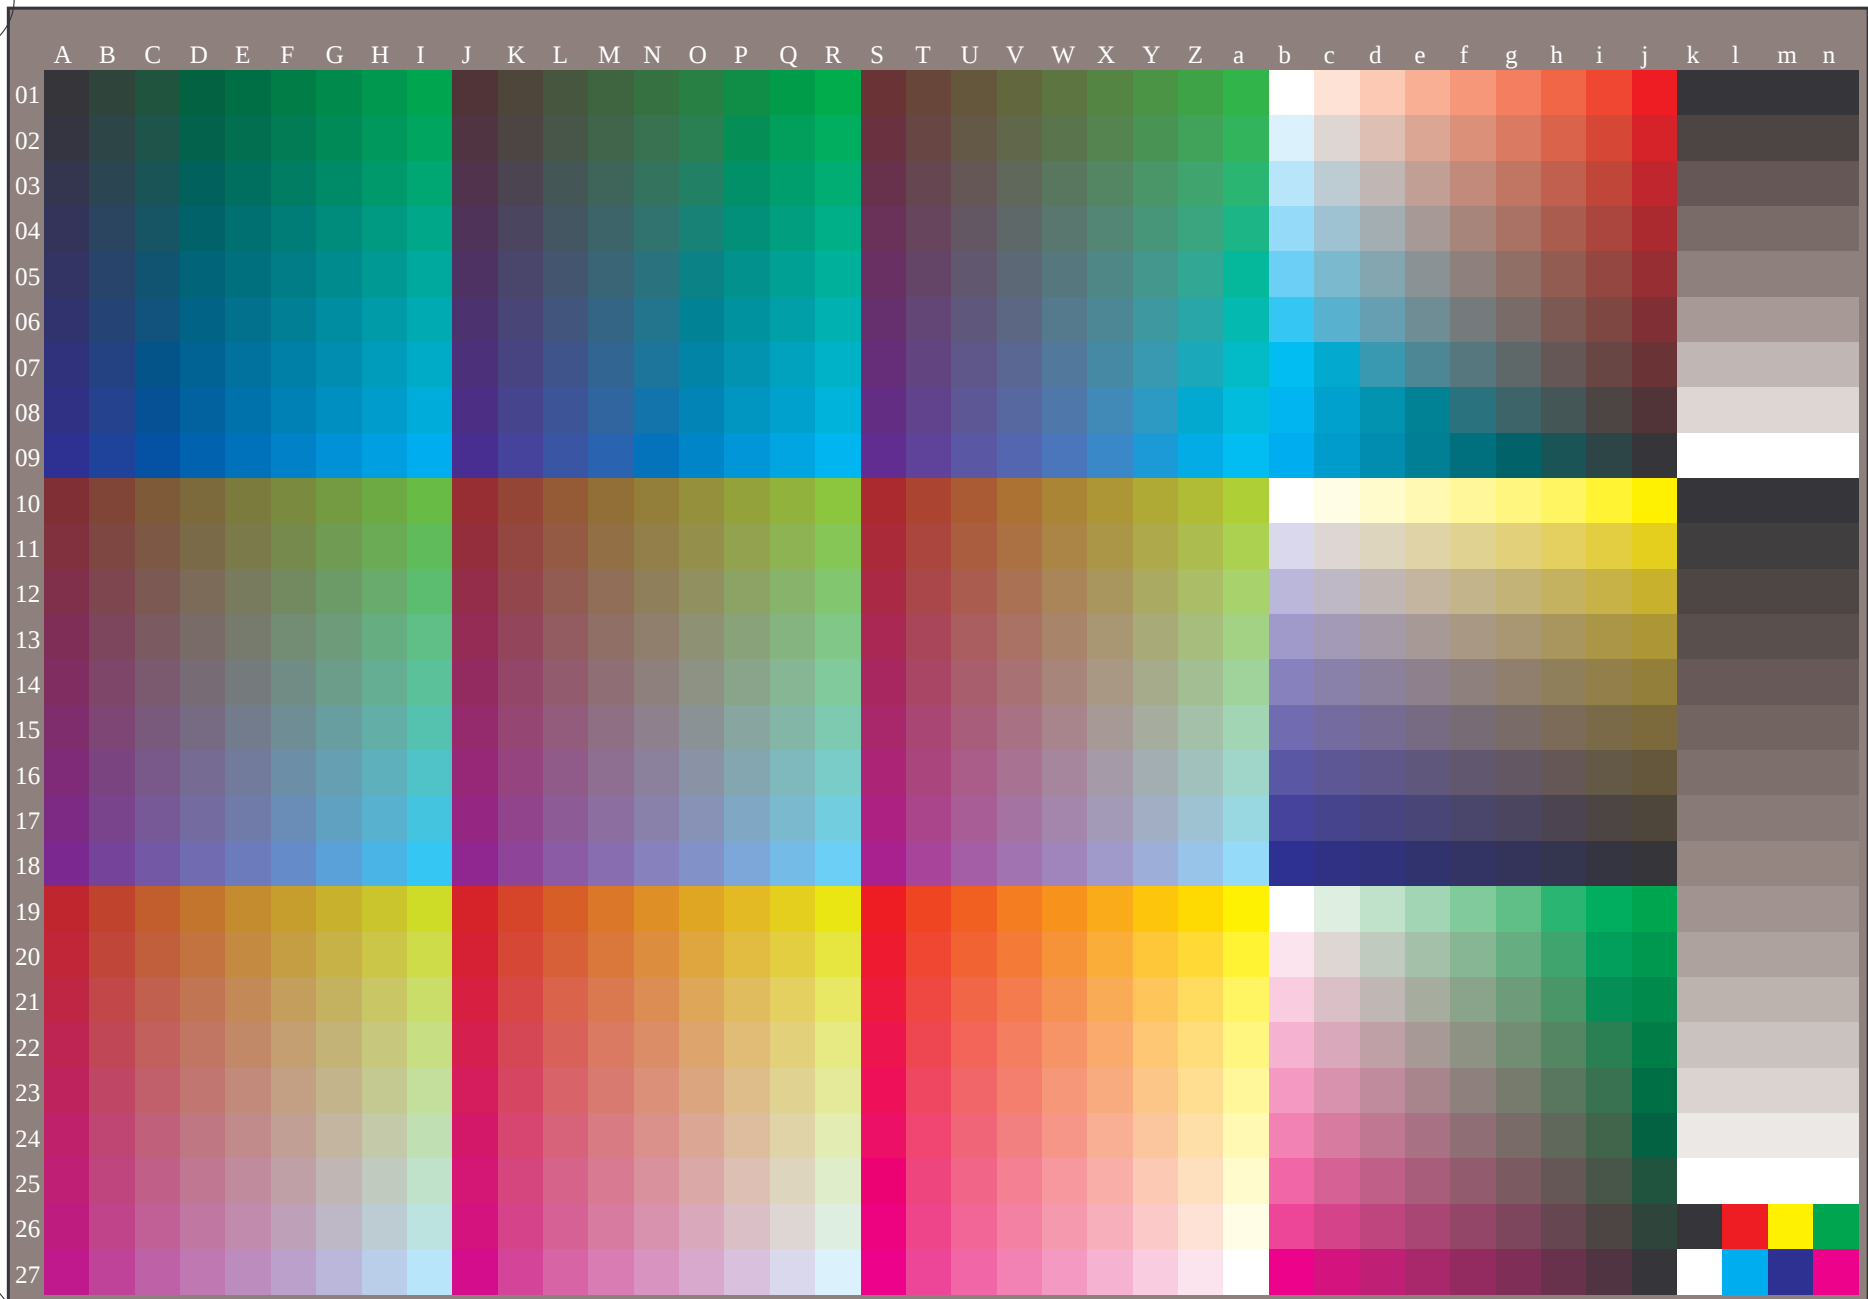

3-003131-L0

PF460-70


graphique TUB-PF46; échantillon pour le test
 1080 couleur de norme, 3D=0, de=0, cmy0

entrée : rgb/cmyk -> rgb_d
 sortie : transférer à cmy0_d

3-003131-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF46/PF46.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF46/PF46L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset
TUB matériel: code=rha4ta

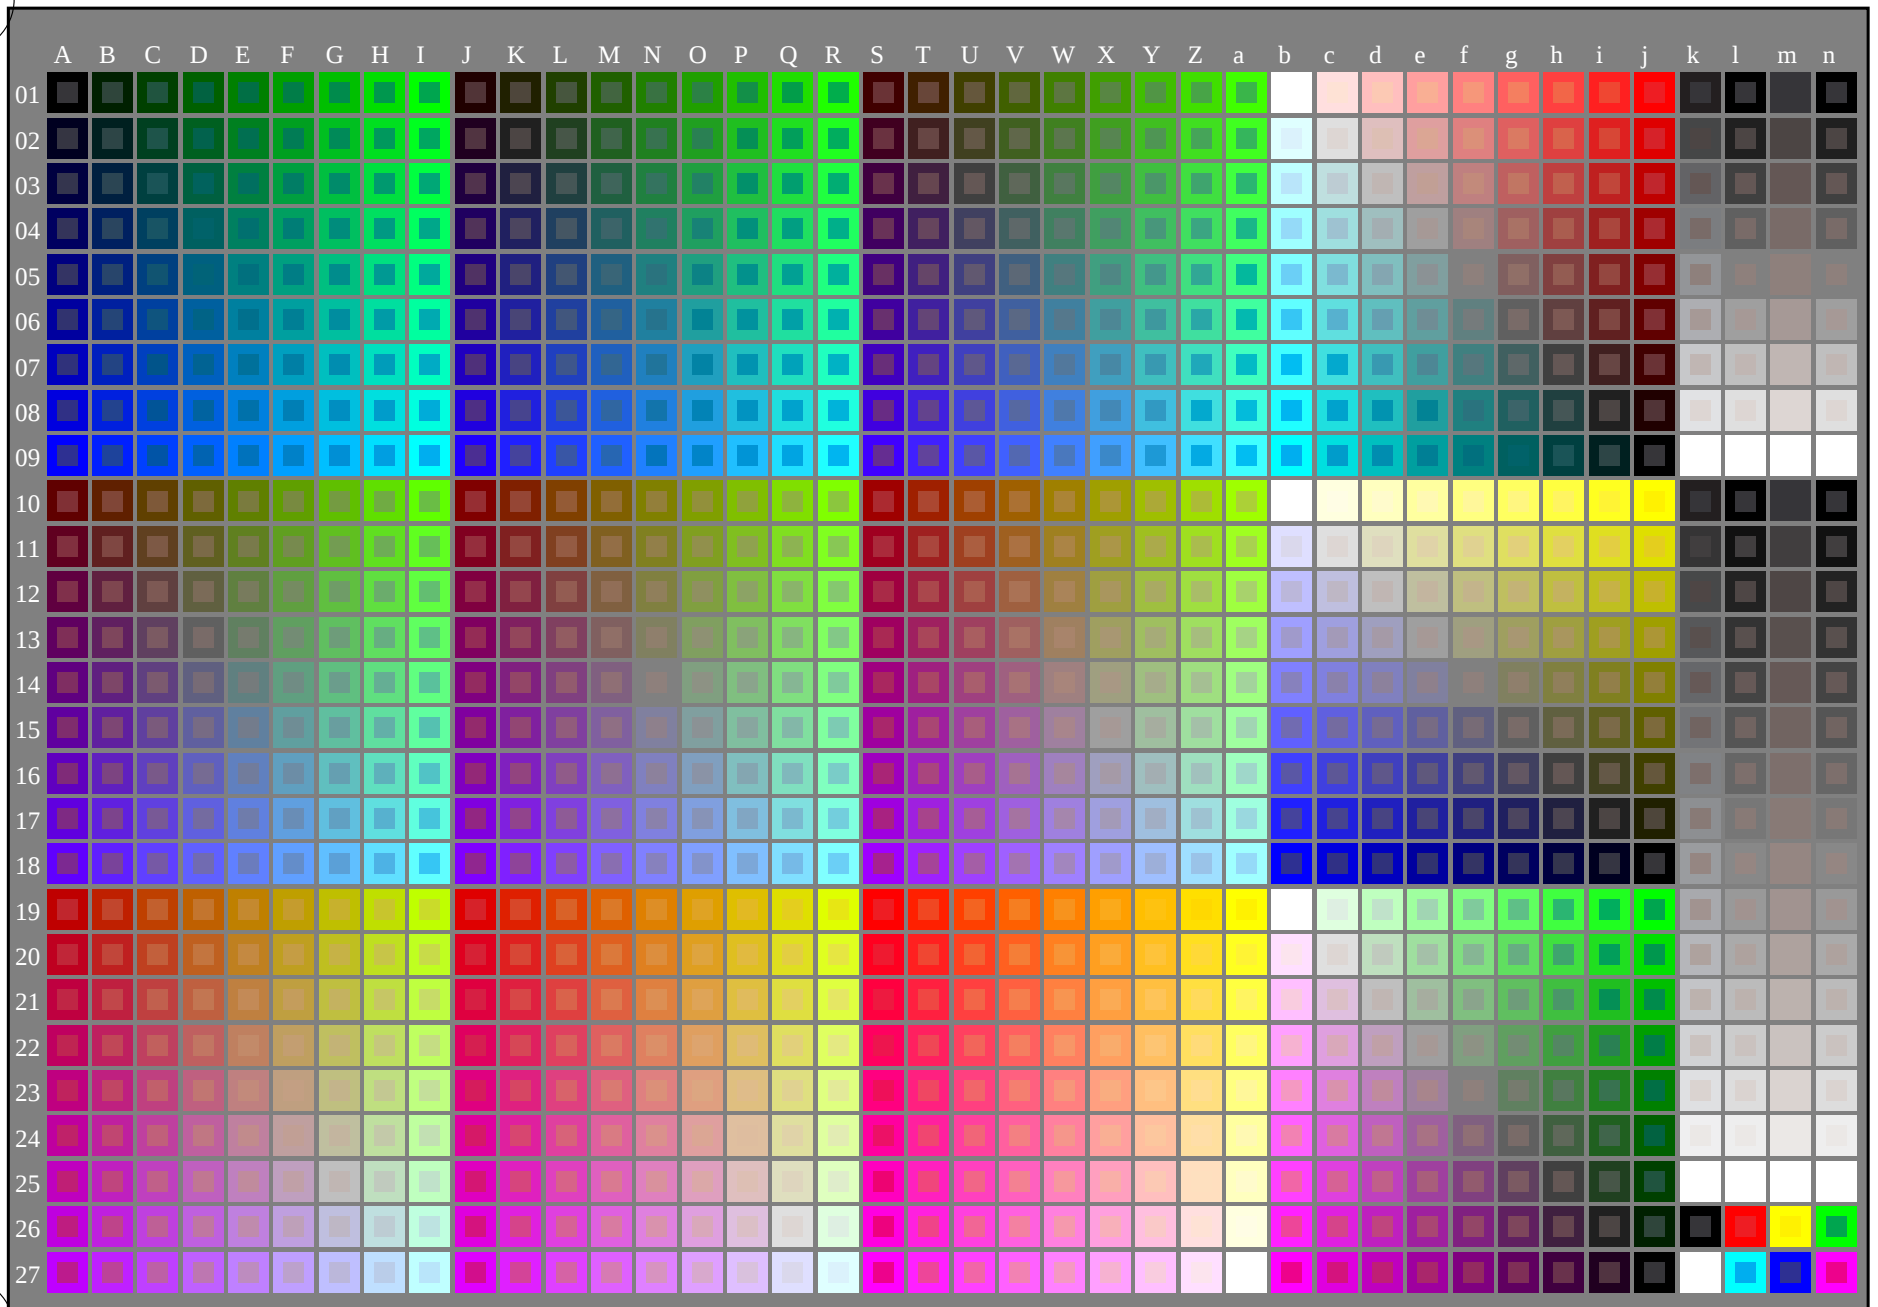

3-013031-L0

PF460-7N


Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): **rgb** (A_j+k26_n27), **000n** (k), **w** (l), **nnn0** (m), **www** (n) + **cmY0**(all)

graphique TUB-PF46; échantillon pour le test
1080 couleur de norme; image informatique

entrée : **rgb/cmyk** -> **rgb/cmyk**
sortie : aucun changement

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF46/PF46.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF46/PF46L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

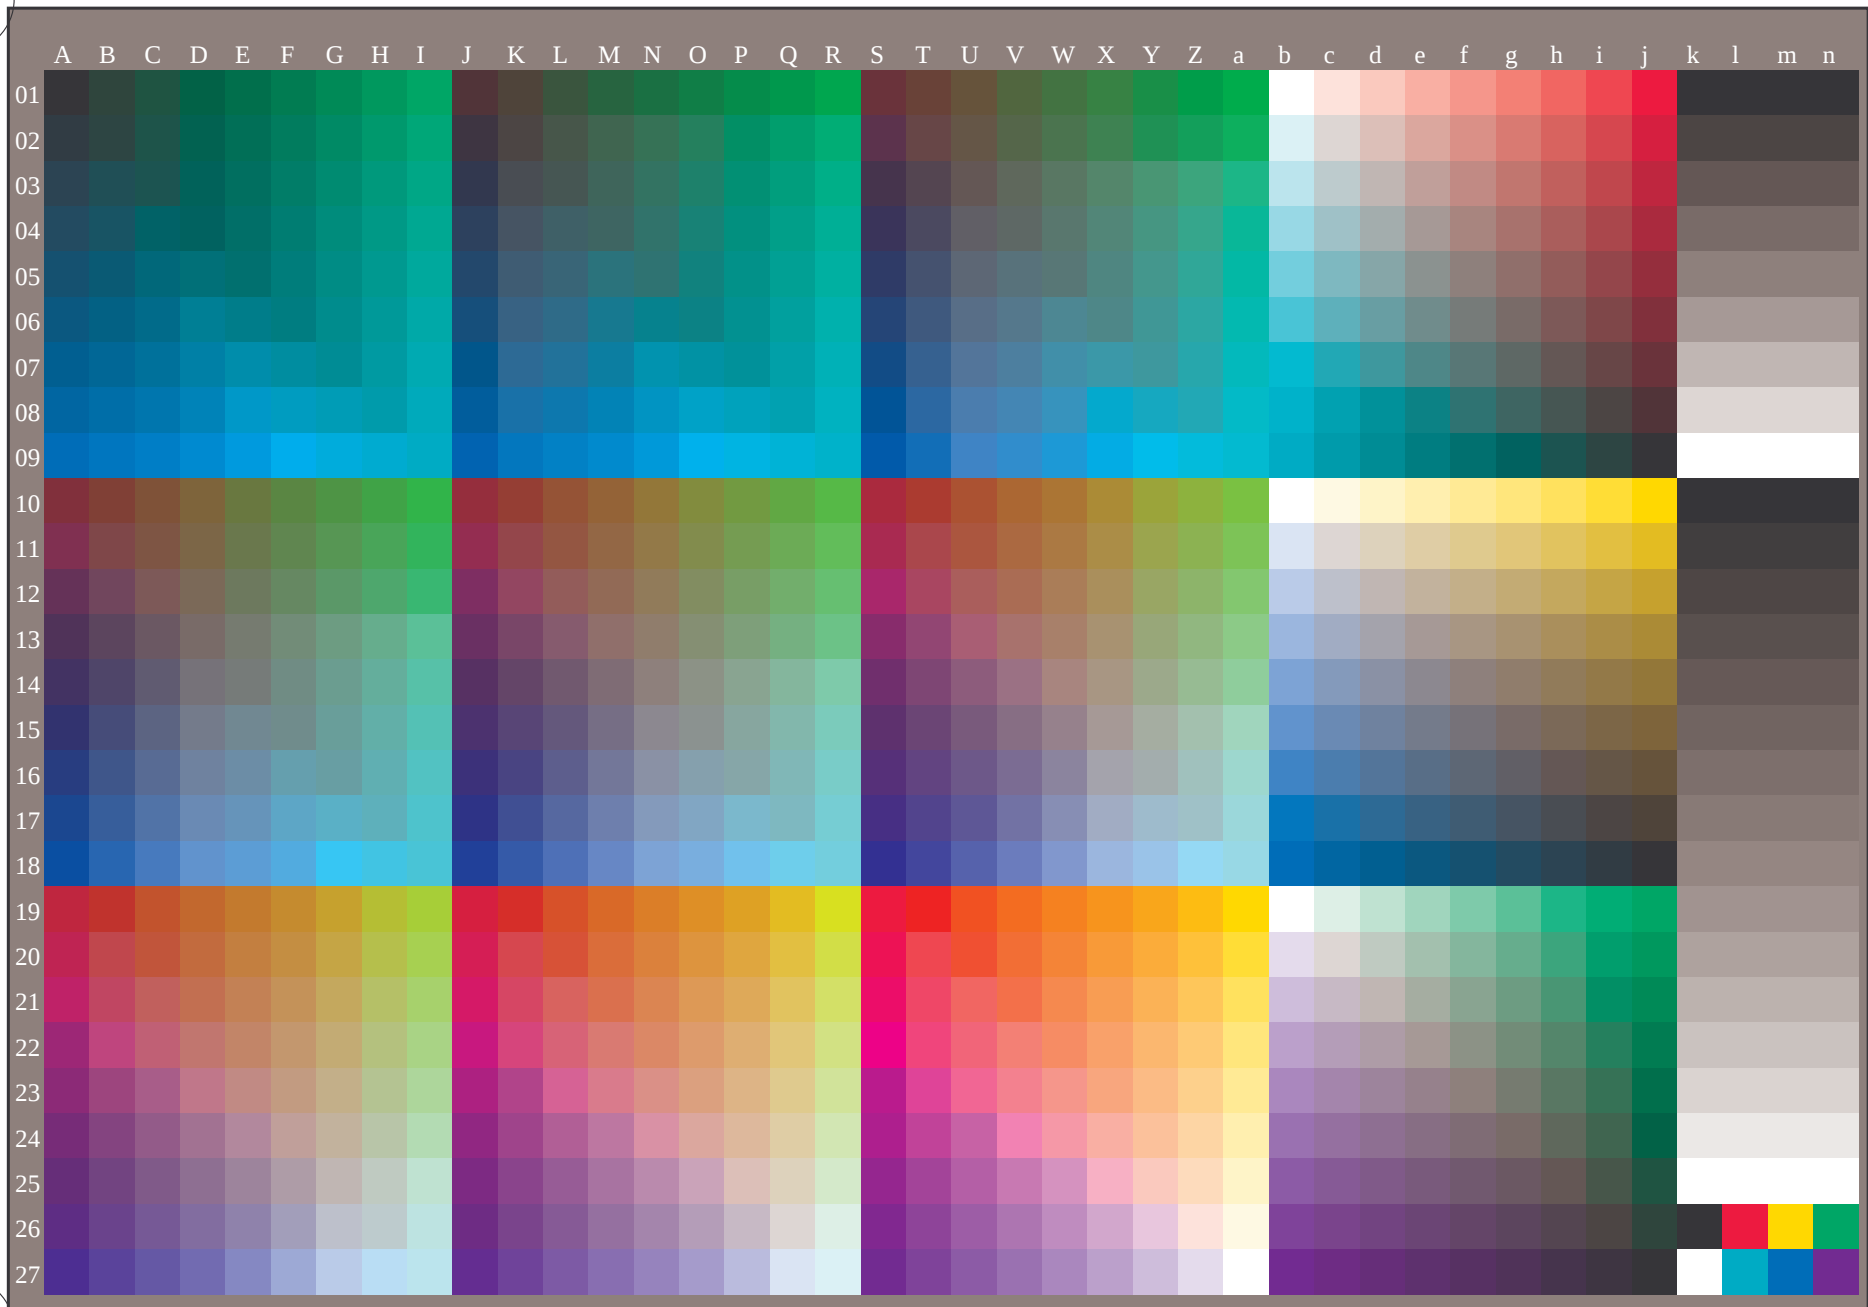

3-013131-L0

PF460-71

graphique TUB-PF46; échantillon pour le test
1080 couleur de norme, 3D=0, de=1, cmy0

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
sortie : transférer à *cmy0_e*

3-013131-F0

C

M

Y

O

L

V

C