

Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Normdisplay (sRGB); $rgb \rightarrow rgb^*_{de}$

Serie:
metamer
m
A



central
z
A/P4000

metamer
m
P4000



metamer
m
A
 $Lab^*N=0.0, 0.0, 0.0$
 $Lab^*W=95.4, 0.0, 0.0$

grau
g
A/P4000

metamer
m
P4000

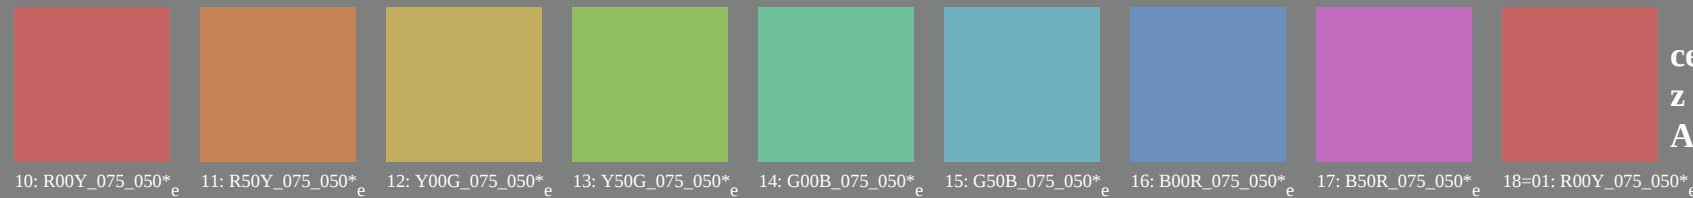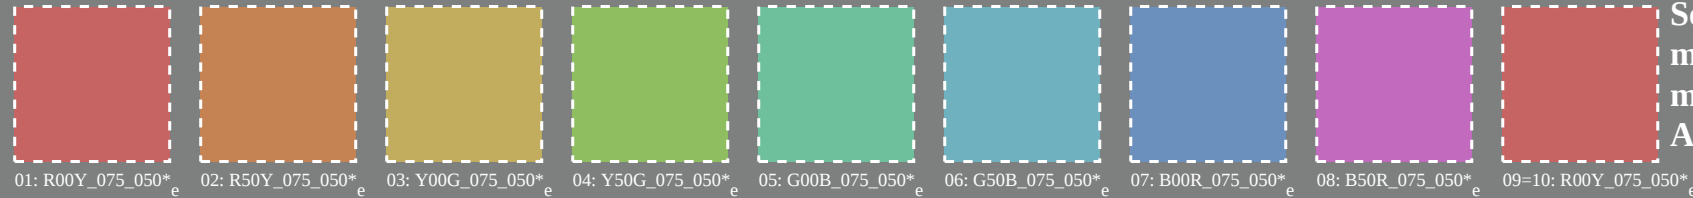

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

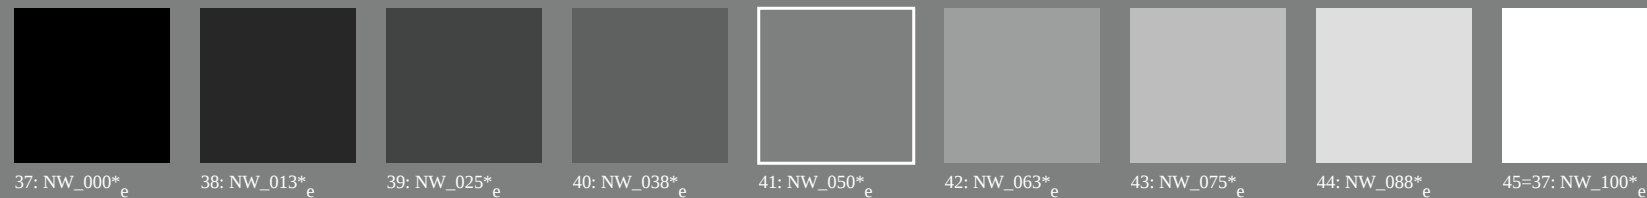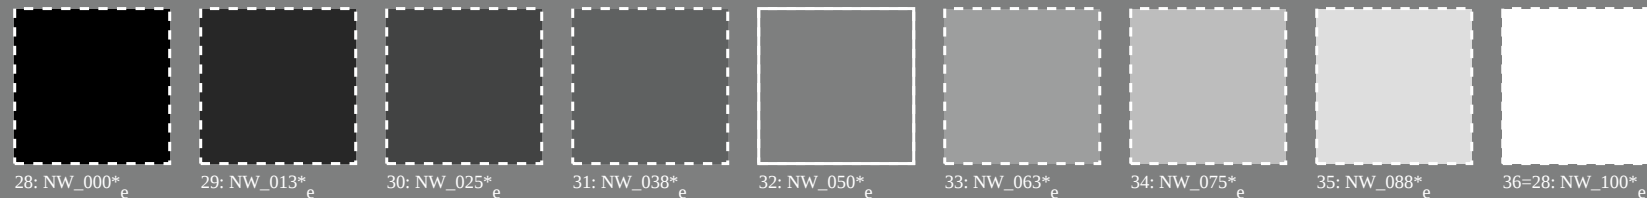

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG30/PG30L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG30/PG30L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

0-113130-L0 PG300-73

TUB-Prüfvorlage PG30; Farbwiedergabe; sRGB
54 Farben; metamer für A&P4000, 3D=1, de=1, sRGB*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb^*_{de}

0-113130-F0