


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF44/PF44.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF44/PF44L0N1.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rhata

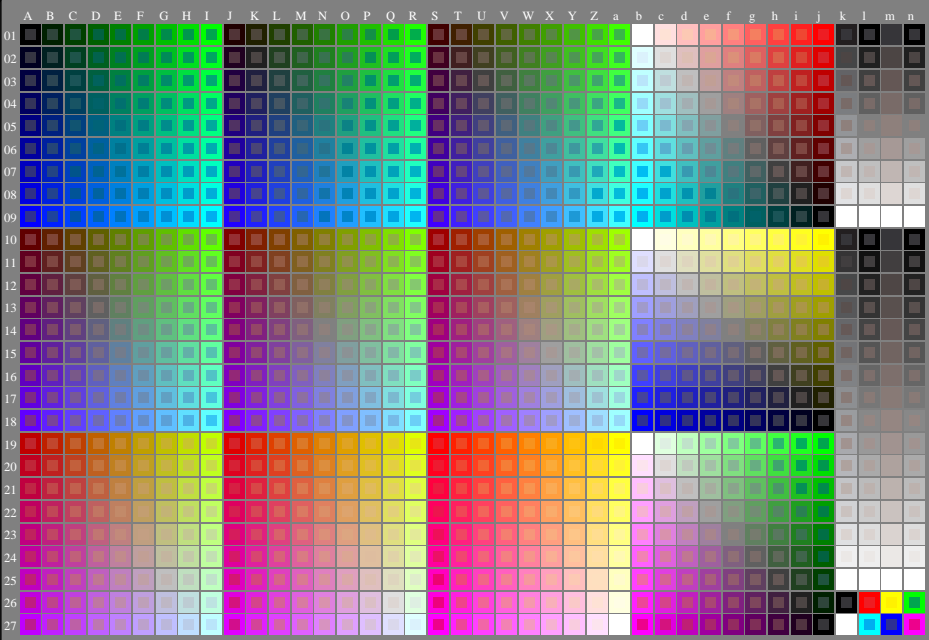

3-003030-L0

PF440-7N

Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n); data in column (A-n)

graphique TUB-PF44; échantillon pour le test
1080 couleur de norme; image informatique

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
sortie : aucun changement

